
UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAS
SANTIAGO – CHILE

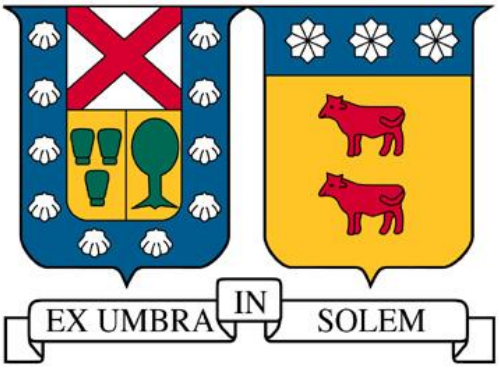


# Propuesta Operacional de Servicio de Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico, Caso Modelo Hospitalario Concesionado.

Daniel Emilio Alberto Moraga Oyarce.

TRABAJO FINAL PARA OPTAR AL GRADO DE
MAGÍSTER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL

PROFESOR GUÍA : SR. Raúl Stegmaier

Septiembre 2025

# CONSTANCIA DE VALIDACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD DE MONOGRAFÍA A REPOSITORIO ACADÉMICO

## 1.- IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO

**Tipo de monografía (marcar una opción):** ☐ Memoria o trabajo de título; ☒ Tesis de Postgrado;

**Título del trabajo:** Propuesta Operacional de Servicio de Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico, Caso Modelo Hospitalario Concesionado.

**Nombre del candidato(a):** Daniel Moraga Oyarce

**Carrera / Grado:** Magíster en Ingeniería Industrial

**Campus:** Santiago Vitacura **;** **Departamento**: Industrias

## 2.- VALIDACIÓN DEL PROFESOR GUÍA/DIRECTOR DE TESIS

Yo, Raúl Stegmaier Bravo, en mi calidad de profesor(a) guía/director(a) del trabajo académico mencionado anteriormente **DEJO CONSTANCIA** que:

- He revisado esta versión del documento y corresponde a la versión final aprobada del trabajo.
- El trabajo cumple con los requisitos académicos y de formato establecidos por la institución

## 3.- EVALUACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD POR PROPIEDAD INDUSTRIAL

☒ El trabajo **NO contiene información que amerite confidencialidad** y puede ser publicado de inmediato en repositorio con acceso abierto.

☐ El trabajo **CONTIENE** información con potenciales implicancias de propiedad industrial o intelectual y requiere un periodo de confidencialidad (embargo) por:

☐ 6 meses; ☐ 12 meses; ☐ 2 años; ☐ 3 años; ☐ 5 años; ☐ 10 años

Fundamentación de la necesidad de confidencialidad (obligatorio si se solicita embargo):

## 4.- FIRMAS

**Profesor(a) guía o director(a) de memoria o tesis:**

**Fecha: 4-9-2025** ; **Firma:** _____

**Estudiante o Candidato(a):**

**Fecha:** 4-9-2025 ; **Firma:** _____

*Este formulario debe ser insertado como página 2 de la memoria o tesis, completado y firmado por estudiante y profesor(a) antes de la entrega en portal PRISMA de Biblioteca USM.*

# Agradecimientos

Agradezco a mi familia, Paola y Josefina por el apoyo, ayuda, compresión, sacrificio y amor entregado durante estos años de formación académica y elaboración del presente trabajo. Su presencia, motivación y apoyo fue fundamental para poder cumplir este objetivo y sin duda este logro no es solamente de mi persona, si no que es para ellas también, las amo y cada día son mi motivación para continuar esta travesía llamada vida. También quiero agradecer a mis Padres por su apoyo y ayuda ya que fueron un pilar fundamental para poder iniciar este proceso.

Agradezco al equipo de docentes de la UTFSM por todos los conocimientos y experiencias entregadas durante el Magister, los cuales sin duda nutrieron y expandieron mi mirada tanto personal como profesional. En particular agradezco a mi profesor Guía Raúl Steigmaier, por las retroalimentaciones durante este proceso y por la entrega de su conocimiento y cercanía como profesor, además agradezco a Simón Gómez por su gran apoyo durante el programa, sus palabras de ánimo, su preocupación y su dedicación para poder responder cada inquietud.

## Resumen Ejecutivo

El presente trabajo tiene como objetivo diseñar una propuesta operacional para el servicio de Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico, aplicado al modelo de Concesiones hospitalarias, enfocado principalmente en la administración y el mantenimiento preventivo de los diferentes equipos.

Para la elaboración de la propuesta se analizan y determinan las exigencias que deben ser consideradas para brindar el servicio de Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico expuesto en el contrato de Concesiones, junto con las exigencias regulatorias nacionales determinadas por el Ministerio de Salud. Se analiza el listado de equipos de los Establecimientos Hospitalarios involucrados para determinar los equipos que serán incluidos en el programa de mantenimiento, mediante el cálculo del Número de Gestión de Equipos recomendado por la OMS, junto con el análisis de juicio experto, a su vez se determinan las frecuencias de mantenimiento preventivo, en base a las normativas nacionales y las recomendaciones por la OMS.

Definidos los equipos y las frecuencias de mantenimiento se desarrollan dos estrategias de mantenimiento, la primera estrategia consiste en la externalización completa de mantenimiento, mediante proveedores, la segunda estrategia consiste en la ejecución del mantenimiento preventivo hibrido, considerando personal interno y externalizando. Para esta segunda estrategia se realiza una clasificación de los equipos en base al nivel tecnológico, nivel de conocimiento del personal y la función o complejidad del equipo. Para ambas estrategias se determinan los recursos requeridos a nivel de recurso humano, equipos de oficina, equipos para ejecución de mantenimiento y sus calibraciones, dispositivos tag, equipos backups, costo directo de mantenimiento preventivo y costos de agencias, a su vez se elaboran los procesos e indicadores de dichas estrategias.

Se efectúa un análisis financiero de ambas estrategias en un periodo de 15 años, mediante el Valor actual de costos (VAC), para comparar ambas alternativas, tomando en consideración el resultado financiero y las ventajas y desventajas de cada estrategia y determinar la mejor estrategia para la ejecución del servicio.

# Contenido

**1. INTRODUCCIÓN. ..... 6**

**2. OBJETIVOS. ..... 9**

**2.1 OBJETIVO GENERAL. ..... 9**

**2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. ..... 9**

**3. ALCANCE. ..... 10**

**4. METODOLOGÍA PROPUESTA. ..... 11**

**5. DESARROLLO DEL TEMA. ..... 13**

**5.1 MARCO TEÓRICO. ..... 13**

**5.1.1 CONTEXTO CONTRATO CONCESIONES. ..... 13**

**5.1.2 CONTEXTO EXIGENCIAS NORMATIVAS NACIONALES Y RECOMENDACIONES NACIONALES/INTERNACIONALES. ..... 18**

**5.1.3 COSTOS MANTENIMIENTO ..... 24**

**5.2 DIAGNOSTICO. ..... 26**

**5.3 ANÁLISIS. ..... 28**

**5.3.1 CLASIFICACIÓN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS. ..... 28**

**5.3.2 DETERMINACIÓN FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO. ..... 32**

**5.3.3 RECURSO HUMANO. ..... 33**

**5.3.4 EQUIPOS NECESARIOS PARA BRINDAR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO. ..... 37**

**5.3.5 ESTRATEGIAS Y COSTOS DE MANTENIMIENTO. ..... 39**

**5.3.5.1 ESTRATEGIA N°1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO EXTERNALIZADO. ..... 40**

**5.3.5.1.1 COSTOS DE MANTENIMIENTO. ..... 40**

**5.3.5.1.2 DOTACIÓN DE PERSONAL. ..... 41**

**5.3.5.1.3 EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO. ..... 42**

**5.3.5.1.4 EVALUACIÓN FINANCIERA ESTRATEGIA N°1. ..... 44**

**5.3.5.2 ESTRATEGIA 2: ESTRATEGIA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MIXTA. ..... 44**

**5.3.5.2.1 COSTOS DE MANTENIMIENTO. ..... 45**

**5.3.5.2.2 DOTACIÓN DE PERSONAL.** ..... 46
**5.3.5.2.3 EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO.** ..... 47
**5.3.5.2.4 EVALUACIÓN FINANCIERA ESTRATEGIA N°2.** ..... 51
**5.3.6 ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO... 51**
**5.3.7 PROCESOS ..... 53**
**5.3.8 INDICADORES ..... 56**
**5.3.9 COMPARACIÓN DE ESTRATEGIAS. ..... 57**
**6. CONCLUSIONES. ..... 59**
**7. BIBLIOGRAFIA. ..... 61**
**8. ANEXOS. ..... 62**
**ANEXO 1. LISTADO EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO CLÍNICO. ..... 62**
**ANEXO 2. PROPUESTA TAG ..... 423**
**ANEXO 3. LISTADO EQUIPOS BACKUP ..... 427**
**ANEXO 4. ESTRATEGIAS MANTENIMIENTO ..... 430**
**ANEXO 5. ANÁLISIS FINANCIERO ..... 469**

# 1. Introducción.

El modelo de salud chileno está compuesto por un sistema mixto de atención integrado, mediante un seguro público (Fonasa) y un seguro privado (Isapre). Los pacientes que pertenecen a Fonasa pueden recibir atención en los establecimientos del Sistema Nacional de Servicios de Salud o por prestadores privados que posean convenio con Fonasa.

El sistema Nacional de Servicios de Salud cuenta en la actualidad con 29 servicios de salud territoriales, los cuales son responsables de articular, gestionar y desarrollar la red asistencial dentro de un territorio geográfico determinado.

La red asistencial de cada Servicio de Salud se constituye en un conjunto de establecimientos asistenciales que pueden depender directamente del Servicio de salud, municipalidades o bien corresponder a otros establecimientos públicos o privados que suscriben convenio con el Servicio de Salud para prestar servicios delegados.

Entre los establecimientos asistenciales que son parte de la red asistencial se encuentran los Hospitales, los cuales brindan atención cerrada. A partir del año 2007, el Ministerio de Salud dio inicio al Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria, programa por el cual el Ministerio de Salud delega al Ministerio de Obras Públicas el desarrollo de establecimientos Hospitalarios, permitiendo a este último entregar dichas obras a concesión por un periodo de 15 años, con el objetivo de que un ente privado sea el responsable de la ejecución, conservación y explotación de servicios de operación.

El modelo de concesiones de Establecimientos Hospitalarios se ha propagado a nivel nacional durante los últimos años. Al año 2025 existen 20 Establecimientos Hospitalarios en etapa de construcción y 4 establecimientos concesionados en operación.

Los contratos del modelo de concesiones de Infraestructura Hospitalaria pueden ser de construcción, operación y transferencia o de diseño, construcción operación y transferencia, a su vez, a su vez cada proyecto es diferente, ya que dependerá de la cartera de prestaciones del establecimiento, número de camas, servicios de explotación a cargo del ente privado, etc.

Los ingresos del ente privado son realizados mediante subsidios que cancela el Estado, siendo, siendo estos, los Subsidios Fijos a la Construcción (SFC), Subsidios Fijos a la Operación (SFO) y Pago variable asociado a la variabilidad de la demanda (PV). Los primeros Hospitales Concesionados corresponden al Hospital de La Florida y al Hospital de Maipú. El SFC corresponde a un subsidio de 8 cuotas anuales, los cuales son pagados una vez que la construcción del Establecimiento Hospitalario es finalizada y es aprobada su puesta en servicio definitiva. El SFO corresponde a un subsidio semestral (Durante los 15 años de explotación) para ejecutar los servicios de operación definidos en el contrato de concesión, el cual comienza a ser pagado una vez aprobada la Puesta en Servicio Definitiva, además este subsidio se encuentra supeditado al cumplimiento de los niveles de servicios establecidos en el contrato de concesión. El Pago variable, es un ingreso que depende de cada establecimiento concesionado, y este se activa, cuando la demanda sobrepasa los niveles establecidos en el contrato de concesión, este ingreso es utilizado como mecanismo de compensación hacia el ente privado, dado que una mayor demanda implica una mayor tasa de uso de los diferentes activos, en comparación del nivel proyectado.

Dado que los ingresos del concesionario están relacionados a los montos de subsidios, es sumamente importante que los diferentes servicios de operación sean diseñados de manera correcta, de lo contrario la rentabilidad operacional del proyecto se verá afectada negativamente. Es por esto, que es fundamental tener en consideración los niveles de servicios comprometidos, las responsabilidades asociadas a los servicios de operación y diseñar los servicios para que estos sean ejecutados de la manera más eficiente. Uno de los servicios que se analizará en el presente trabajo consiste en el servicio de Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico, cuyo objetivo es administrar y mantener los activos que se utilizarán para la atención de pacientes, ya sea de manera directa o indirecta. Considerando que el SFO debe ser administrado de manera correcta, es sumamente importante poder responder las siguientes inquietudes:

¿Se puede aplicar una clasificación para determinar que equipos se mantendrán preventivamente y cuáles no?

¿Qué estrategias de mantenimiento se pueden aplicar para que el servicio pueda ser realizado de manera eficiente, sin sacrificar calidad de atención y seguridad al paciente?

¿Qué recursos deben estar involucrados para la ejecución del servicio de Administración y Mantenimiento?

# 2. Objetivos.

## 2.1 Objetivo general.

Desarrollo de modelo de servicio operacional de mantenimiento para el equipamiento médico y mobiliario clínico, focalizado en las responsabilidades asociadas al mantenimiento preventivo, asociado a un modelo de hospital concesionado.

## 2.2 Objetivos específicos.

- Clasificar el equipamiento médico y mobiliario clínico, para determinar los equipos y el volumen que deberá ser sometido a mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo.
- Definir la frecuencia de mantenimiento preventivo con la que se proyectará la ejecución del servicio de mantenimiento.
- Desarrollar y comparar estrategias de mantenimiento externa y mixta, para determinar la estrategia a recomendar.
- Determinar y cuantificar el personal y el equipamiento de análisis necesario para ejecutar el programa de mantenimiento.
- Diseñar los procesos involucrados para la ejecución del programa y servicio de mantenimiento.
- Definir indicadores para evaluación de resultados financieros y operativos.

# 3. Alcance.

La presente propuesta de modelo de servicio operacional de Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico es desarrollada para un Hospital de la Región Metropolitana, el cual se encuentra en etapa de construcción.


La presente propuesta permite establecer lineamientos asociados al Servicio de Administración de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico, determinando los equipos que serán gestionados por mantenimiento preventivo, RRHH, equipos requeridos para la ejecución del mantenimiento y sus procesos.

Para el caso de la gestión por mantenimiento preventivo, se considerarán estimaciones de costos referenciales de mantenimiento declarados por los proveedores durante los procesos de licitación. A su vez, el diseño de la propuesta toma en consideración las exigencias normativas a nivel nacional, con el propósito de que el Establecimiento de Salud pueda cumplir con el proceso de Acreditación Nacional de Establecimientos de Salud, en particular para el 7° Ámbito: Seguridad del Equipamiento (EQ), en particular con los componentes EQ 2.1 y EQ 2.2, junto con el cumplimiento normativo de la Resolución Exenta N° 1341.

Se excluyen de esta propuesta los costos o estimaciones asociados a la gestión del mantenimiento correctivo de los equipos, dado que se desconoce el comportamiento de los usuarios y la tasa de fallas histórica.

# 4. Metodología propuesta.

Considerando los objetivos definidos, la metodología propuesta consiste en las siguientes fases:

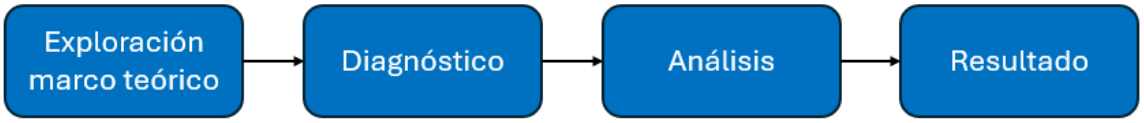


- Exploración marco teórico: La exploración de marco teórico consistirá en la revisión y verificación de las exigencias contractuales contenidas para el servicio Administración y Mantenimiento del equipamiento médico y mobiliario clínico de un proyecto concesionado, junto con la verificación de las exigencias a nivel de mantenimiento de acuerdo con el marco normativo vigente nacional.
- Diagnóstico: El diagnóstico consiste comprender la realidad actual y poder determinar los alcances asociados al servicio de Administración y Mantenimiento del equipamiento médico, para lo cual se levantará el listado completo asociado al servicio de Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico, junto con las actividades y los perfiles de personal mínimos que deben ser considerados para ejecutar el servicio.
- Análisis: El análisis considerará las siguientes etapas:
  - Clasificar el equipamiento y determinar si su enfoque de servicio será de mantenimiento preventivo o correctivo, para lo cual se calculará el número GE estipulado en el manual de mantenimiento de equipamiento médico de la OMS.
  - Determinar la frecuencia de mantenimiento preventivo tomando en consideración las exigencias normativas, número GE o referencias de frecuencias históricas de mantenimiento.
  - Se desarrollará una estrategia de mantenimiento preventivo considerando externalización de mantenimiento preventivo total y una estrategia considerando internalización de mantenciones preventivas para un seleccionado pool de equipos, para lo cual se realizará levantamiento de costos para cada estrategia. Las estrategias serán comparadas y evaluadas financieramente mediante el Valor actual de los costos (VAC).

- Levantamiento de los flujos de las actividades involucradas para la ejecución del servicio de Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico.

- Resultados: En la fase de resultados se determinará cual opción de estrategia será la recomendada, junto con los aspectos críticos que deben ser considerados a futuro para la ejecución adecuada del servicio de Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico.

# 5. Desarrollo del tema.

## 5.1 Marco teórico.

### 5.1.1 Contexto contrato Concesiones.

El modelo de Concesiones Hospitalarias a nivel nacional se subdivide en dos etapas contractuales. Por un lado, se encuentra la etapa de construcción o año 0, la cual consiste en la ejecución de las obras civiles asociadas a la construcción del establecimiento hospitalarios durante un periodo aproximado de 4 años. En cambio, el periodo de explotación comienza una vez es recepcionado el Hospital por parte del MOP y su duración es de 15 años. En ambas etapas el Concesionario debe brindar ciertos servicios, los cuales poseen diferentes exigencias, siendo uno de ellos el servicio de Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico.

El servicio de Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico corresponde a uno de los servicios especiales obligatorios que debe brindar el concesionario, siendo su objetivo administrar técnicamente los bienes, como la gestión del mantenimiento de estos, con el fin de asegurar su administración, disponibilidad y operación confiable y segura. Es por esto que dicho servicio posee diferentes enfoques, siendo uno la administración y la otra parte el mantenimiento.

Respecto a la Administración, las exigencias contenidas en el contrato de concesiones son las siguientes:

- La Administración debe ser realizada para todo equipo que ingrese al establecimiento Hospitalario, pudiendo estos ingresar por medio de compras efectuadas por el Concesionario, Hospital, préstamos de terceros, comodatos, arriendos, etc.
- Registrar, monitorear y resolver las solicitudes presentadas por los usuarios, relativas a alteraciones o fallas detectadas en la operación del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico. Notificar en un lapso no superior a 30 minutos el tiempo estimativo de reparaciones.

- Monitorear todas las actividades que se efectúen sobre el Equipamiento Médico y Mobiliario de cada Establecimiento de Salud, coordinar las planificaciones de Mantenimiento Preventivo, Correctivo, Técnico-Legal y Reparativo, registrando las mismas de manera digital.
- Gestionar el Inventario, correspondiente al registro de las incorporaciones y bajas del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico disponible en cada Establecimiento de Salud. Mantener el inventario actualizado.
- Monitorear el rendimiento del Equipamiento Médico conforme a la disponibilidad del mismo, informar rendimientos de manera mensual.
- Mantener un sistema de alertas para la reposición del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico que considere vida útil.
- En caso de bajas, se deberá efectuar la desinstalación, traslado y disposición final de los equipos, incluyendo los costos asociados a dicha actividad. Gestionar garantías con los proveedores y gestionar la tramitación de liquidación de siniestros en caso de que corresponda.

En relación con el mantenimiento, el contrato de concesiones determina las siguientes exigencias, exclusivamente para los equipos que hayan sido provistos por el Concesionario:

- Efectuar las actividades de mantenimiento programado y no programado del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico, incluyendo el recambio de sus respectivas partes y accesorios.
- Cumplir con el nivel de disponibilidad del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico.
- Asegurar que todo el Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico esté calibrado permanentemente conforme las recomendaciones otorgadas por el respectivo fabricante.
- Capacitar a los funcionarios usuarios de cada Establecimiento de Salud en la operación y limpieza del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico según corresponda.

El contrato de Concesiones aborda los siguientes tipos de mantenimiento:

1- Mantenimiento Preventivo: Corresponde al conjunto de actividades programadas, tales como: limpieza interior y exterior, mediciones, calibraciones, chequeos y ajustes y, en general, todas aquellas destinadas a asegurar un estado óptimo del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico.

   Las actividades deberán ser programadas preferentemente en horarios de menor utilización.

   Los equipos pertenecientes a las Familiar: Apoyo Diagnóstico, Apoyo Endoscópico, Apoyo Terapéutico y de Monitoreo que sean instalados en zonificaciones clasificadas como “Muy Crítica”, deben ser sometidos a un programa de mantenimiento preventivo de frecuencia anual como mínimo.

2- Mantenimiento Técnico – Legal: Corresponde a aquel exigido por la legislación vigente. Es responsabilidad del Concesionario elaborar los informes sobre mantenimiento de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico exigidos por la Autoridad Sanitaria en los procesos de autorización y acreditación sanitaria que correspondan.

3- Mantenimiento Correctivo: Corresponde al conjunto de actividades programadas sobre el Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico, conducentes a reparar o sustituir piezas, repuestos y/o accesorios, permitiendo la plena operación y funcionalidad del mismo en óptimas condiciones, conforme a las recomendaciones del fabricante. Las actividades correctivas pueden ser realizadas presencial o remotamente.

4- Mantenimiento Reparativo: Comprende al conjunto de actividades no programadas tendientes a corregir las causas y/o los efectos de las fallas y averías que dejan al Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico fuera de servicio total o parcial, o bien funcionando defectuosamente. Las actividades reparativas podrán ser realizadas de manera remota o presencial.

Toda actividad de mantenimiento debe ser autorizada por el Inspector Fiscal, previo a su ejecución.

La Disponibilidad en los contratos de Concesiones se define como la probabilidad de que un Equipamiento Médico o Mobiliario Clínico se encuentre apto para operar en el momento que sea requerido. Es responsabilidad del Concesionario efectuar todas las acciones para garantizar el nivel de disponibilidad mínima para el Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico. Cada nivel mínimo de Disponibilidad puede diferir dependiendo del contrato de Concesión, sin embargo, su cálculo debe ser realizado de manera semestral.

$$Nivel\ de\ Disponibilidad = \frac{Disponibilidad\ Real}{Disponibilidad\ Programada\ Semestral}\%$$

Donde:

Disponibilidad Real: Corresponde al número de horas (aproximadas a un decimal) en el cual el Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico estuvo operativo con todas sus funcionalidades en el semestre de medición, dentro del periodo de disponibilidad programada.

Las actividades de mantenimiento preventivo se deducirán de la Disponibilidad Real.

El Concesionario posee la responsabilidad de que todo Equipamiento ingresado por procesos de compra efectuados por el mismo, esté disponible por sobre los niveles de Disponibilidad Mínima establecidos en el contrato de Concesiones. Si un Equipamiento Médico o Mobiliario Clínico está detenido por encontrarse en mantenimiento correctivo o reparativo, programado o no, y el nivel de disponibilidad resultante fuese inferior al nivel de Disponibilidad Mínima, el Concesionario deberá actuar en base a lo siguiente:

- Si se trata de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico que corresponda a alguna de las siguientes Familias: Apoyo Diagnóstico, Apoyo Endoscópico, Apoyo Terapéutico o Monitoreo, que se hayan instalado en la zonificación Muy Crítica, y que sea exigible una disponibilidad mínima o “up time” de un 97% o superior, el Concesionario deberá reemplazar el ítem en falla, con otra unidad de similares características que preste las mismas funcionalidades al interior de cada Establecimiento de Salud, a su entero cargo, costo y responsabilidad, previa autorización del Inspector Fiscal.
- En caso de que los niveles de disponibilidad sean inferiores a lo establecido en el contrato de Concesiones, en particular para el Resonador Nuclear

Magnético, el Concesionario deberá activar la suplencia asistencial, contemplando un máximo de 5 procedimientos diarios.

Para efectuar las actividades de mantenimiento el Concesionario deberá contemplar al menos el siguiente equipo:

- Analizador de seguridad eléctrica (según norma IEC 60601 o equivalente)
- Multímetros de parámetros eléctricos.
- Osciloscopios.
- Generadores de señales eléctricas.
- Frecuenciómetro.
- Simuladores de señales.
- Calibradores de respiradores.
- Calibradores de oxímetros de pulso.
- Calibradores de desfibriladores.
- Calibradores de electrocardiógrafos.
- Calibradores de bombas de infusión.
- Analizadores de espectros.
- Fuentes de alimentación.
- Sonómetro.
- Contadores Geiger.
- Dosímetros Registradores.

El Concesionario cada 12 meses deberá realizar la certificación de calibración de los equipos que lo requieran.

Todo el personal clínico usuario del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico deberá ser capacitado, siendo responsabilidad del Concesionario la ejecución de dicha actividad, la cual debe ajustarse a las necesidades de los funcionarios usuarios de los diferentes equipos adheridos al contrato. Una vez ejecutada las capacitaciones estás deberán ser formalizadas hacia el Inspector Fiscal, que considere la siguiente información: Nombre del funcionario capacitado, título profesional o técnico, fecha de capacitación, número de

horas de capacitación, alcances de la capacitación e identificación de la documentación entregada por el capacitador.

Respecto al personal las exigencias que se establecen en el contrato de Concesiones son las siguientes:

- Encargado del servicio debe poseer título de Ingeniero Civil o Mecánico o Eléctrico o Electrónico o Biomédico con una experiencia laboral de 10 años y experiencia de 5 años en cargos similares en establecimientos de Salud.
- Cobertura de personal en sistema de turno.
- Personal Técnico debe acreditar nivel técnico profesional en las áreas de la electrónico. Se deben acreditar 3 años de experiencia en el rubro de Mantenimiento de Equipamiento Médico.
- Personal Profesionales deberán ser Ingeniero Civiles o Ingenieros Biomédicos. Se deben acreditar 3 años de experiencia en el rubro de Mantenimiento de Equipamiento Médico.
- Personal debe ser capacitado al menos 40 horas en temas relacionados con: Aseo en recintos asistenciales, Infecciones Asociadas a la Atención de Salud, vectores, barreras efectivas, evaluación y manejo de insumos, y residuos hospitalarios.

### 5.1.2 Contexto exigencias normativas nacionales y recomendaciones nacionales/internacionales.

La Acreditación Nacional de Establecimientos de Salud, es un proceso voluntario periódico de evaluación, por el cual una entidad acreditadora autorizada y fiscalizada por la Superintendencia de Salud, se encarga de evaluar el cumplimiento de estándares de calidad definidos por el Ministerio de Salud. Mediante la Acreditación los prestadores institucionales pueden brindar prestaciones GES, dichas prestaciones contribuyen a un alto porcentaje de los ingresos de un Hospital.

Uno de los ámbitos exigidos por el proceso de Acreditación de Establecimientos de Salud, asociados al mantenimiento del Equipamiento Médico de un Establecimiento Hospitalario

corresponde 7° Ámbito: Seguridad del Equipamiento. El presente ámbito posee los componentes EQ 2.1 y EQ 2.2, para lo cual elaborar y ejecutar un programa de mantenimiento preventivo para los equipos críticos y equipos relevantes, siendo estos:

EQ 2.1 Equipamiento Crítico:

- Equipos de monitorización hemodinámica.
- Monitores Desfibriladores.
- Ventiladores fijos y de transporte.
- Máquinas de anestesia.
- Incubadoras.

EQ 2.2 Equipamiento relevante:

- Equipos generadores de vapor: Autoclaves.
- Campanas de flujo laminar.
- Equipos de laboratorio y Unidad de medicina transfusional, siendo estos:

- Contadores hematológicos.
- Equipos para determinación de electrolitos y gases.
- Analizadores automatizados de Química Clínica.
- Equipos Automatizados para microbiología, hormonas e inmunología.
- Lectores de Elisa.
- Refrigeradores y congeladores para sangre y hemoderivados.

- Equipos de imagenología (Todos).
- Equipos de diálisis y tratamiento de agua.
- Equipos de radioterapia.

El 24 de noviembre del año 2017 la Subsecretaria de Redes Asistenciales aprueba la Resolución exenta N° 1341, “Norma de seguridad del paciente y calidad en la atención respecto a: Mantenimiento preventivo de equipamiento médico crítico”, aplicando para los siguientes equipos:

- Equipos de monitorización hemodinámica invasiva.
- Monitores desfibriladores.
- Ventiladores mecánicos (fijos y transporte)
- Incubadoras.

- Máquinas de diálisis.
- Máquinas de anestesia.

Entre las exigencias más importantes de esta resolución se destaca:

- Determinar el programa de mantención preventiva a más tardar en el mes de marzo de cada año.
- El mantenimiento preventivo debe ser ejecutado con una frecuencia de al menos 2 veces al año, o en su defecto, considerar la periodicidad definida por el fabricante en el caso de los equipos nuevos en garantía.
- En caso de que no se ejecute para una unidad el mantenimiento preventivo, según lo programado, se deberá justificar los motivos en un documento, además su actividad debe ser programada en un plazo máximo de 30 días de la fecha programada inicialmente.
- Si la mantención preventiva reprogramada no puede ser realizada, el equipo médico debe ser retirado de uso y físicamente del servicio. Quedando en evidencia por escrito.
- La información relativa a la mantención preventiva debe ser conocida por los servicios clínicos que posean el equipamiento médico crítico, para maximizar la disponibilidad de estos para su mantención.
- Se debe reportar mediante informe los siguientes indicadores:
  1- N° de equipos críticos con mantenimiento preventivo ejecutado en el periodo (t) / N° total de equipos críticos con mantenimiento preventivo programado en el periodo (t) x 100. Esto debe ser reportado en periodos semestrales considerando de enero a junio y de enero a diciembre de cada año.
  2- Señalar las reprogramaciones efectuadas durante el periodo (t) y sus causas.

El 29 de diciembre del año 2017 se aprueba a nivel nacional el Decreto Exento N° 290 “Aprueba Normas Técnicas De Mantenimiento Hospitalario, De Infraestructura Y de Equipos Técnicos”, la cual entre sus detalles más importantes se puede encontrar el RRHH que debería ser considerado para la gestión del mantenimiento de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico, siendo esta la siguiente:

**Tabla 1.** N° RRHH según cantidad de equipos médicos.

| N° de Equipos Médicos | N° de integrantes de la Unidad Técnica (horas efectivas) |
|---|---|
| < 267 | 1 técnico 44 horas |
| 267 a 559 | 1 profesional de la Ingeniería 44 horas<br>1 técnico 44 horas |
| 560 a 1679 | 2 profesionales de la Ingeniería 44 horas<br>3 técnicos 44 horas<br>1 administrativo 44 horas |
| 1680 a 2799 | 3 profesionales de la Ingeniería 44 horas<br>5 técnicos 44 horas<br>1 administrativo 44 horas |
| 2800 a 3919 | 4 profesionales de la Ingeniería 44 horas<br>7 técnicos 44 horas<br>1 administrativo 44 horas |
| 3920 a 5039 | 5 profesionales de la Ingeniería 44 horas<br>9 técnicos 44 horas<br>2 administrativos 44 horas |
| 5040 a 6159 | 6 profesionales de la Ingeniería 44 horas<br>12 técnicos 44 horas<br>2 administrativos 44 horas |
| 6160 o mas | 7 profesionales de la Ingeniería 44 horas<br>14 técnicos 44 horas<br>3 administrativo 44 horas |

Nota: Ministerio de Salud (29 de Diciembre 2017). Decreto Exento N° 290 (Ministerio de Salud).

A nivel internacional existen ciertas recomendaciones para la gestión de mantenimiento de Equipamiento, siendo una de ellas lo expuesto en el documento de la OMS “Introducción al programa de mantenimiento de equipos médicos”, publicado en el año 2014, donde se menciona un algoritmo que puede ser utilizado como una recomendación para determinar el tipo de gestión deberían tener los diferentes equipos de un Establecimiento Hospitalario, mediante el cálculo del número de Gestión del Equipo (GE), ponderando la función del equipo, riesgo físico asociado con la aplicación clínica, requisitos de mantenimiento y antecedentes de problemas del equipo, mediante la siguiente ecuación:

$$Número\ GE = \#Función + \#Aplicación + \#Mantenimiento + \#Antecedentes$$

**Tabla 2.** Clasificación función del equipo OMS.

| Función del equipo | | |
|---|---|---|
| Categoría | Descripción de la función | Puntuación |
| Terapéutico | Apoyo vital | 10 |
| | Cirugía y cuidados intensivos | 9 |
| | Fisioterapia y tratamiento | 8 |
| Diagnóstico | Control de cirugía y cuidados intensivos | 7 |
| | Control fisiológico adicional y diagnostico | 6 |
| Analítico | Análisis del laboratorio | 5 |
| | Accesorios del laboratorio | 4 |
| | Computadoras y afines | 3 |
| Otros | Relacionado con el paciente y otros | 2 |

Nota: Organización Mundial de la Salud. (2012). *Introducción al programa de mantenimiento de equipos médicos* (Serie de documentos técnicos de la OMS sobre dispositivos médicos).

**Tabla 3.** Clasificación riesgo del equipo OMS.

| Riesgo del equipo | |
|---|---|
| Descripción del riesgo durante el uso | Puntuación |
| Riesgo de muerte del paciente | 5 |
| Posible lesión del paciente o el operador | 4 |
| Tratamiento inapropiado o error de diagnóstico | 3 |
| Daño al equipo | 2 |
| Sin riesgo significativo identificado | 1 |

Nota: Organización Mundial de la Salud. (2012). *Introducción al programa de mantenimiento de equipos médicos* (Serie de documentos técnicos de la OMS sobre dispositivos médicos).

**Tabla 4.** Clasificación requisitos de mantenimiento OMS.

| Mantenimiento | |
|---|---|
| Requisitos de mantenimiento | Puntuación |
| Importantes: exige calibración y reemplazo de piezas periódicas | 5 |
| Superiores al promedio | 4 |
| Usuales: verificación de funcionamiento y prueba de seguridad | 3 |
| Inferiores al promedio | 2 |
| Mínimos: inspección visual | 1 |

Nota: Organización Mundial de la Salud. (2012). *Introducción al programa de mantenimiento de equipos médicos* (Serie de documentos técnicos de la OMS sobre dispositivos médicos).

**Tabla 5.** Clasificación averías OMS.

| Averías | |
|---|---|
| Promedio de averías del equipo | Factor |
| Significativo: más de una cada seis meses | 2 |
| Moderado: una cada 6-9 meses | 1 |
| Usual: una cada 9-18 meses | 0 |
| Mínimo: una cada 18-30 meses | -1 |
| Insignificante: menos de una en los 30 meses anteriores | -2 |

Nota: Organización Mundial de la Salud. (2012). *Introducción al programa de mantenimiento de equipos médicos* (Serie de documentos técnicos de la OMS sobre dispositivos médicos).

En base a la recomendación de la OMS, todos los equipos cuyo valor GE sea igual o mayor a 12 deben ser incluidos en un programa de mantenimiento preventivo y la frecuencia de mantenimiento recomendada será la siguiente:

- Para todos los dispositivos cuyo requerimiento de mantenimiento tenga valores 4 o 5, deberán programarse las mantenciones preventivas cada seis meses. En cambio, para los dispositivos cuyo requerimiento de mantenimiento tenga valores 1,2 o 3, deberán programarse las mantenciones preventivas anuales.
- Para todos los dispositivos con un número GE entre 15 y 18, deberán programarse las mantenciones preventivas cada seis meses. Para dispositivos con número GE iguales o mayores a 19, deberán programarse las mantenciones preventivas cada cuatro meses.

Es importante destacar que el algoritmo recomendado por la OMS se basa del algoritmo de Fennigkoh y Smith, sin embargo, en su algoritmo la ponderación de las averías promedio del equipo históricas.

### 5.1.3 Costos mantenimiento

Los activos de equipamiento médico se caracterizan por poseer un alto nivel tecnológico y una rápida obsolescencia, dado las innovaciones tecnológicas de los diferentes fabricantes que permiten facilitar los diagnósticos como la incorporación de nuevos tratamientos frente a enfermedades, estas diferencias hacen que los costos de mantenimiento difieran en gran medida entre los diferentes equipos de un establecimiento hospitalario.

Normativas como la ISO 55000 proporcionan un marco para la gestión de activos y maximizar su valor a lo largo de su ciclo de vida.

Una de las formas de evaluar el costo de mantenimiento es mediante el ratio del costo de servicio, siendo este el resultado entre el costo de mantenimiento dividido por el costo de adquisición. Un estudio realizado por Cohen, el cual fue realizado considerando información de un total de 47 establecimientos, indica que el ratio de costo de servicio de estos establecimientos se encuentra entre 1,9% a 12,5%[1], sin embargo, dicho estudio indica que la información de los costos de mantenimiento de los establecimientos que participaron difiere de su cantidad de camas y sus equipos en uso. A nivel de costos se ha estimado que el costo de adquisición de un equipo médico representa solamente el 20% costo de poseer el equipamiento, el 80% corresponde a costos ocultos[2], siendo uno de ellos el mantenimiento, motivo por el cual el mantenimiento y otros aspectos como el entrenamiento de los técnicos, calibraciones, consumibles, repuestos y eliminación son aspectos importantes que considerar para la toma de decisiones al momento de adquirir un equipo.

Respecto a los costos de mantenimiento, estos podrán variar, dependiendo de la estrategia, proveedores, tecnología del equipo, etc. En particular las estrategias de

---

[1] Cohen T. AAMI's Benchmarking solution: analysis of cost of service ratio and other metrics. Biomedical Instrumentation & Technology, 2010, 4(4):346-349.

[2] OMNIA Partners, How to Drive MRO Savings with Total Cost of Ownership (TCO), 2021

mantenimiento pueden ser realizar el mantenimiento de manera externa, interna o hibrida, cada estrategia posee ventajas y desventajas siendo estos:

Mantenimiento externo:

- Ventajas:
  - Actividades se asocian a costo variable.
  - Acceso a profesionales con mayor nivel de especialización.
  - Menor inversión en equipos e infraestructura.
  - Menor costo de RRHH.
  - Posibilidad de transferir riesgos.
- Desventajas:
  - Mayor costo por actividad de mantenimiento, dado las exigencias contractuales.
  - Menor control directo del RRHH.
  - Menor flexibilidad para ejecutar mantenimiento.
  - Mayor riesgo operacional, debido a dependencia de proveedor.
  - Menor acumulación de conocimiento para el personal interno.

Mantenimiento interno:

- Ventajas:
  - Costos variables controlados.
  - Respuesta inmediata para agendamiento de mantenimiento.
  - Menor riesgo operacional, dado que solo depende del personal interno.
  - Mayor flexibilidad de agendamiento de mantenciones.
- Desventajas:
  - Costo fijo más alto (Sueldos, formación, equipos).
  - Mayor dotación y costo de RRHH.
  - Requiere capacitación continua al personal de mantenimiento.
  - Mayor inversión inicial, dado la necesidad de equipos para mantenimiento e infraestructura.

En particular para la externalización del mantenimiento es importante a considerar que los costos pueden ser mayores, dado que pueden existir costos de agencia, dado a que la empresa deberá incurrir en mayores costos aparte de la mano de obra y de los equipos

para realizar mantenimiento, tales como, administración del contrato, monitoreo del contrato, niveles de servicio, multas, transmisión de riesgos operativos, exclusividad de personal, expertis del personal, ejecución de mantenimiento en horarios no hábiles, etc.

## 5.2 Diagnostico.

Para la elaboración de la propuesta operacional para el servicio de Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico, focalizado principalmente en la administración y en el mantenimiento preventivo, es necesario en primera instancia conocer el volumen de equipos y en cuantos establecimientos de salud se debe brindar el servicio.

El diseño de la propuesta operacional debe ser efectuado para 2 establecimientos de salud simultáneos. El catastro de equipos de cada establecimiento se expone en la siguiente tabla:

**Tabla 6.** Distribución equipos por establecimiento hospitalario.

| | Establecimiento N°1 | Establecimiento N°2 |
|---|---|---|
| Tipos de equipos | 522 | 157 |
| Unidades de equipos | 8354 | 1281 |

Nota: Elaboración propia.

Dado que existen 2 establecimientos de salud involucrados y físicamente los establecimientos de salud comparten dependencias físicas se proyectará el servicio compartido para ambos establecimientos. Es importante considerar que ambos establecimientos poseen tipologías de equipos en común, siendo su global total 578 tipologías y 9.635 unidades.
El detalle del listado de equipos se encuentra expuesto en el Anexo N°1 “Listado Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico”.

Las disponibilidades contractuales para los diferentes equipos son las siguientes:

**Tabla 7.** Disponibilidades por establecimiento.

| Establecimiento N°1 | | |
|---|---|---|
| Disponibilidad | Tipos de equipos | Unidades |
| 95% | 311 | 6365 |
| 97% | 224 | 1731 |
| 99,5% | 4 | 258 |

| Establecimiento N°2 | | |
|---|---|---|
| Disponibilidad | Tipos de equipos | Unidades |
| 95% | 143 | 1176 |
| 97% | 16 | 104 |
| 99,5% | 1 | 1 |

Nota: Elaboración propia.

Los equipos pertenecientes a las familias Apoyo Diagnostico, Apoyo Endoscópico, Apoyo terapéutico y Monitoreo y que sean instalados en una zonificación Muy crítica, pertenecen exclusivamente al Establecimiento de Salud N°1 (Tabla 8).

**Tabla 8.** Equipos familia Apoyo Diagnostico, endoscópico, Terapéutico y Monitoreo

| | |
|---|---|
| Tipos de equipos | 66 |
| Unidades de equipos | 817 |

Nota: Elaboración propia.

De acuerdo con las exigencias contractuales, todos estos equipos deben ser sometidos a un programa de mantenimiento preventivo anual, sin embargo, al analizar el listado, se observa que existen equipos que no suelen requerir mantenimiento preventivo, dada su baja complejidad, tales como: Acelerador infusión 1000 cc, Acelerador infusión 500 cc, Caliper, Esfigmomanometro portátil de sobremesa, Férula de Brown, Flujómetro de Wright, Fonendoscopio, Medidor Cuff, Ventilador Manual. Para lo cual es recomendable y necesario evaluar con los proveedores el requerimiento de mantenimiento de la totalidad de los equipos una vez se concrete el proceso de compra.

La cantidad de equipos para los cuales serán necesarios considerar Backup, pertenecen al Establecimiento N°1 (Tabla 1).

**Tabla 9.** Equipos que optan a Backup.

| Establecimiento N°1 | |
|---|---|
| Tipos de equipos | 45 |
| Unidades de equipos | 494 |

Nota: Elaboración propia.

## 5.3 Análisis.

Para efectuar la propuesta de mantenimiento, determinar los equipos que requieren mantenimiento, determinar las frecuencias de mantenimiento, determinar los perfiles de cargos y su dotación y determinar costos de mantenimiento.

### 5.3.1 Clasificación mantenimiento de equipos.

Para determinar si una tipología debe ser incluida en un programa de mantenimiento preventivo, en primera instancia se debe tener en consideración las exigencias normativas nacionales, motivo por el cual, considerando los equipos del proceso de Acreditación Nacional asociados a los ámbitos EQ 2.1 y EQ 2.2, se clasificaron las 578 tipologías de equipos, obteniendo el catastro expuesto en la Tabla 10.

**Tabla 10.** Catastro equipos acreditación nacional.

| Clasificación de acuerdo con Acreditación nacional | Cantidad de tipologías de equipos | Unidades | Porcentaje en tipologías de equipos | Porcentaje de unidades |
|---|---|---|---|---|
| Equipos pertenecientes a componente EQ 2.1 | 13 | 589 | 35% | 88% |
| Equipos pertenecientes a componente EQ 2.2 | 24 | 79 | 65% | 12% |
| Total Equipos | 37 | 668 | 100% | 100% |

Nota: Elaboración propia.

Los equipos especificados en Resolución Exenta N°1341, se encuentran contenidos en la clasificación de los equipos de Acreditación Nacional EQ 2.1 y EQ 2.2.

Obtenida la clasificación de equipos a incluir en un programa de mantenimiento preventivo, en base a las normativas nacionales, se realiza el cálculo del Número de Gestión de Equipo, en base a la recomendación de la OMS. Obteniendo los resultados expuestos en la Tabla 11.

**Tabla 11** Categorización Número GE.

| Número GE | Tipos de equipo | Unidades | Porcentaje | Porcentaje acumulado | Debe incluirse en programa de mantenimiento (SI/NO) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 126 | 3317 | 34% | 34% | NO |
| 3 | 10 | 134 | 1% | 36% | NO |
| 4 | 20 | 557 | 6% | 42% | NO |
| 5 | 22 | 2814 | 29% | 71% | NO |
| 6 | 29 | 240 | 2% | 73% | NO |
| 7 | 22 | 93 | 1% | 74% | NO |
| 8 | 67 | 412 | 4% | 79% | NO |
| 9 | 20 | 71 | 1% | 79% | NO |
| 10 | 26 | 198 | 2% | 81% | NO |
| 11 | 52 | 327 | 3% | 85% | NO |
| 12 | 75 | 730 | 8% | 92% | SI |
| 13 | 27 | 123 | 1% | 94% | SI |
| 14 | 26 | 173 | 2% | 95% | SI |
| 15 | 7 | 58 | 1% | 96% | SI |
| 16 | 26 | 109 | 1% | 97% | SI |
| 17 | 7 | 17 | 0% | 97% | SI |
| 18 | 10 | 145 | 2% | 99% | SI |
| 19 | 0 | 0 | 0% | 99% | SI |
| 20 | 6 | 117 | 1% | 100% | SI |
| 21 | 0 | 0 | 0% | 100% | SI |
| 22 | 0 | 0 | 0% | 100% | SI |
| Total | 578 | 9635 | 100% | | |

Nota: Elaboración propia.

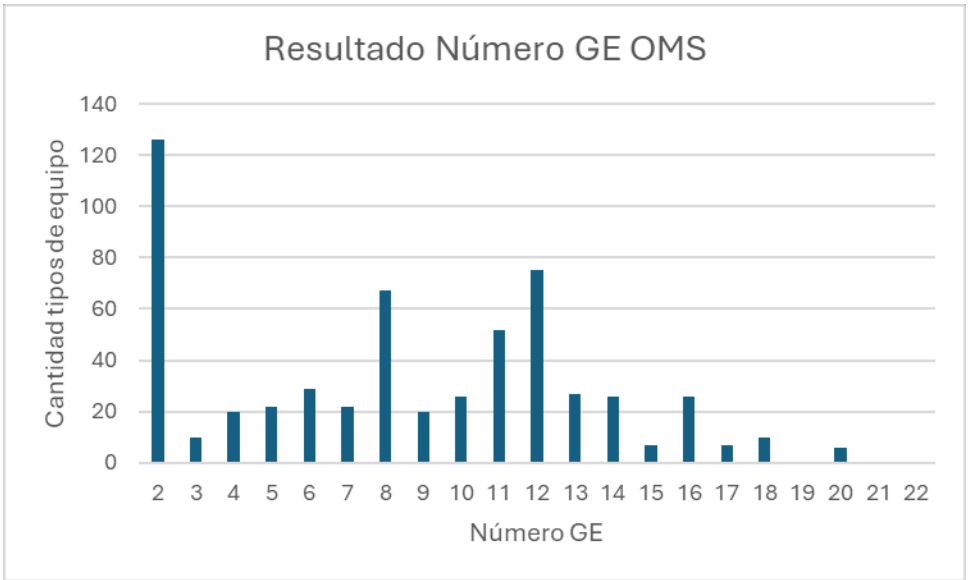



**Ilustración 1. Distribución equipos en base a Número GE.**

**Tabla 12.** Resultado Número GE por tipologías y volumen.

| Clasificación de acuerdo Número GE | Tipologías de equipos | Unidades | Porcentaje en tipologías de equipos | Porcentaje de unidades |
|---|---|---|---|---|
| Califica a mantención preventiva | 184 | 1472 | 32% | 15% |
| No califica a mantención preventiva | 394 | 8163 | 68% | 85% |
| Total | 578 | 9635 | 100% | 100% |

Nota: Elaboración propia.

La mayor concentración de equipos se puede observar en números GE bajos, el porcentaje acumulado de equipos cuyo Número GE es inferior a 12 corresponde al 85%, del volumen total de equipos a adquirir. En base a los resultados obtenidos, se puede concluir que 184 Tipologías de Equipos, correspondiente a 1.472 unidades, poseen un Número de Gestión de Equipo igual o superior a 12. Estas unidades deberán ser gestionadas mediante un programa de mantenimiento preventivo. Es importante destacar que los resultados obtenidos en el proceso de clasificación podrán variar dependiendo de la cantidad de profesionales involucrados en dicho proceso, por lo que es altamente sugerente incorporar a más de una persona, además de un profesional clínico, que apoye

a determinar la clasificación de los impactos generados en el paciente en caso de que los equipos puedan presentar fallas.

El algoritmo propuesto por la OMS, entrega mayor puntaje a equipos que se relacionan de manera directa con el paciente, en particular para equipos cuya categoría sea de Terapéutico o Diagnostico. Debido a esto, se efectuó una revisión de todas las tipologías de equipos cuyo resultado de Número de Gestión de Equipo haya sido inferior a 12, para determinar equipos que deban ser incluidos en la gestión bajo enfoque de mantenimiento preventivo, dado su importancia en el proceso de atención del paciente. Concluyendo esta revisión se detectó que deben ser incorporado en el programa de mantenimiento preventivo los equipos mencionados en la Tabla 13.

**Tabla 13.** Equipos que deben incluirse en programa de mantenimiento.

| Nombre Equipo | Unidades |
|---|---|
| Lavadora A Vapor Para Instrumental De Laparoscopia | 1 |
| Lavadora Descontaminadora Material De Vidrio | 1 |
| Lavadora Instrumental Ultrasónica | 3 |
| Lavadora Descontaminadora | 4 |
| Reprocesador Automático De Endoscopios | 4 |
| Estufa De Cultivo | 7 |
| Freezer -30° C | 15 |
| Freezer -80°C 380L | 1 |
| Freezer -80°C 500L | 3 |
| Freezer | 7 |
| Refrigerador Banco De Sangre | 3 |
| Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Doble Puerta | 14 |
| Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta | 48 |
| Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta Pequeño | 10 |
| Sistema Refrigerado Para Almacenamiento Temporal Y Transporte De Sangre Y Hemoderivados | 8 |
| Estufa De Cultivo CO2 | 2 |

Nota: Elaboración propia.

En base estas consideraciones el programa de mantenimiento preventivo deberá contemplar el catastro de equipos mencionados en la Tabla 14.

**Tabla 14** Equipos a incluir en programa de mantenimiento preventivo.

| | Cantidad de tipologías de equipos | Unidades | Porcentaje en tipologías de equipos | Porcentaje de unidades |
|---|---|---|---|---|
| Equipos que se gestionarán por mantención preventiva | 200 | 1603 | 35% | 17% |
| Equipos que se gestionarán por mantención correctiva | 378 | 8032 | 65% | 83% |
| Total | 578 | 9635 | 100% | 100% |

Nota: Elaboración propia.

### 5.3.2 Determinación frecuencia de mantenimiento.

Para determinar la frecuencia de mantenimiento de las 1.603 unidades que serán gestionadas bajo enfoque de mantenimiento preventivo, se debe tomar en consideración lo exigido en la Resolución Exenta 1341, donde se determina que para ciertos equipos la frecuencia de mantenimiento debe ser semestral. Para los Tipos de Equipos que no pertenecen a la Resolución Exenta, se determina la frecuencia de mantenimiento en base a referencias de mantenimiento históricas de Establecimientos similares, además de la frecuencia sugerida por la OMS, dependiendo del Número de Gestión GE y los requerimientos de mantenimiento del equipo. Las frecuencias de equipos en base a los tipos de equipo se exponen en la Tabla 15.

**Tabla 15** Frecuencias de mantenimiento preventivo por Tipo de equipo y Volumen.

| Frecuencia | Tipos de equipo | Unidades |
|---|---|---|
| Anual | 99 | 695 |
| Semestral | 95 | 899 |
| Trimestral | 6 | 9 |

Nota: Elaboración propia.

En base a las frecuencias de mantenimiento definidas, anualmente se deberán ejecutar 2.529 mantenciones preventivas.

### 5.3.3 Recurso Humano.

Considerando que el volumen de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico para el Establecimiento N°1 y N°2 asciende a 9.635 unidades y para cumplir con las exigencias del contrato de concesiones y el Decreto Exento N° 290, el recurso humano asociado al Servicio de Administración y Mantenimiento se detalla en la Ilustración 2.

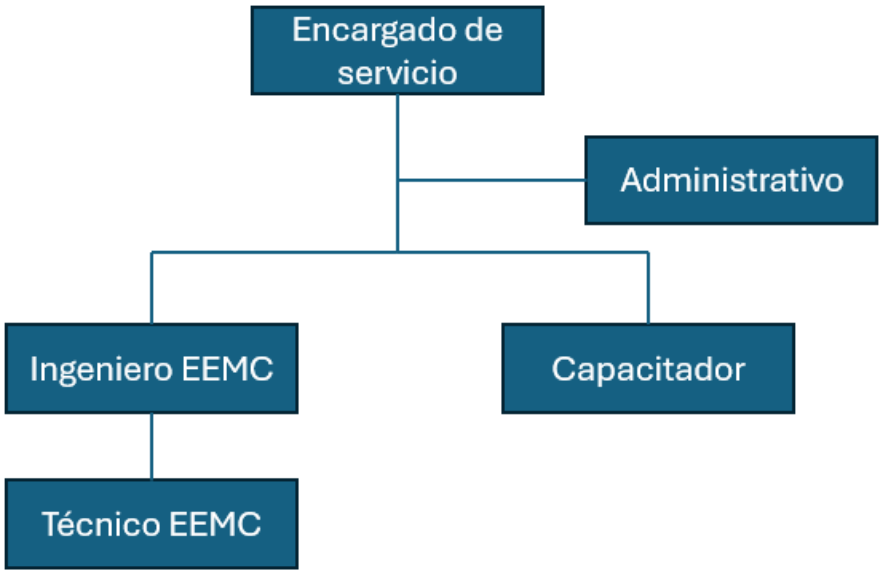



**Ilustración 2. RRHH Servicio de Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico.**

El perfil propuesto para ejecutar el servicio de Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico es el siguiente:

**Encargado de servicio**:

- Objetivo del cargo: Desarrollar estrategias para cumplir eficientemente las exigencias contractuales, asociadas al servicio de Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico.

- Responsabilidades Principales:
  - Desarrollar y ejecutar estrategias que permitan reducir los costos de mantenimiento.
  - Analizar métricas y KPI para evaluar rendimiento de las estrategias implementadas.
  - Gestionar y coordinar el RRHH involucrado con el servicio de Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico.
  - Colaborar, informar y coordinar actividades con otros servicios de la concesión.
  - Administrar presupuesto.
- Requisitos:
  - Ingeniero Civil o Mecánico o Eléctrico o Electrónico o Biomédico.
  - Experiencia laboral de 10 años. Experiencia de 5 años en cargos similares en establecimientos de Salud.
  - Experiencia de liderazgo de equipos de al menos 12 personas.
  - Conocimiento intermedio de Ms Office y Power BI.

**Administrativo**:

- Objetivo del cargo: Apoyar en la generación de documentación administrativa, gestión documental del proceso de mantenimiento. Procesar documentación asociada a pagos de servicio.
- Responsabilidades Principales:
  - Digitalizar y cargar los documentos de mantenimiento, ingresos, traslados, bajas y capacitación de equipos a gestor documental.
  - Respaldar documentación de mantenimiento asociada a los equipos de Acreditación nacional.
  - Elaboración de informes en base a los resultados operacionales del servicio de Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico.
  - Procesar facturas de pagos de servicio.
  - Apoyar el proceso de Adquisición de kits de mantenimiento.
- Requisitos:
  - Técnico del área de la Administración.
  - Experiencia laboral de 3 años en cargos similares en establecimientos de Salud.

- Conocimiento Ms Office.

**Ingeniero EEMC**:

- Objetivo del cargo: Apoyar en los diferentes procesos asociados al servicio de Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico. Apoyar en la planificación, coordinación y compra de accesorios y repuestos para la ejecución del mantenimiento del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico.
- Responsabilidades Principales:
  - Planificar y coordinar el mantenimiento del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico.
  - Ejecutar el proceso de compra de accesorios y repuestos para el mantenimiento.
  - Gestionar las garantías de los equipos con los proveedores.
  - Gestionar inventario del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico.
  - Gestionar las disponibilidades del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico.
  - Coordinar las capacitaciones entre proveedores y usuarios del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico.
  - Apoyar en la preparación de documentación asociado al proceso de Acreditación Nacional.
  - Apoyar en el proceso de confección de contratos de mantenimiento.
  - Elaborar documentación asociada al ingreso y baja del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico.
  - Cerrar órdenes de trabajo de mantenimiento.
- Requisitos:
  - Ingenieros Civiles o Ingeniero Biomédicos.
  - Experiencia laboral de 3 años en cargos similares en establecimientos de Salud.
  - Conocimiento Ms Office, Power BI.

**Técnico EEMC**:

- Objetivo del cargo: Apoyar en la ejecución del mantenimiento del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico.
- Responsabilidades Principales:

- Ejecutar el mantenimiento del Equipamiento Médico.
- Disponibilizar el Equipamiento Médico en terreno.
- Elaborar o recepcionar documentación de mantenimiento del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico.
- Actualizar el estado del Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico.
- Controlar el inventario de equipos.

- Requisitos:
  - Técnico profesional en las áreas de la electrónica.
  - Experiencia laboral de 3 años en cargos similares en establecimientos de Salud.
  - Conocimiento Ms Office.

Los 14 perfiles técnico EEMC deberán ser considerado en un hibrido entre trabajo diurno de lunes a viernes y sistema de turno para mantener disponibilidad de personal durante las 24 Hrs del día.

**Capacitadores:**

- Objetivo del cargo: Apoyar, gestionar y ejecutar el proceso de capacitación al personal de los establecimientos de Salud.
- Responsabilidades Principales:
  - Planificar el programa de capacitaciones asociado a los usuarios de los establecimientos de salud.
  - Evaluar el uso de los equipos, para determinar si los usuarios requieren refuerzo de capacitaciones, ya sea por evaluaciones en terreno como por indicadores de tasas de fallas.
  - Elaborar informes de capacitaciones ejecutadas, indicando su contenido, duración, profesionales capacitados.
  - Coordinar con proveedores la ejecución de capacitaciones, durante el periodo de garantía de los equipos.
- Requisitos:
  - Enfermeros/as, Tecnólogos médicos con especialización en imágenes o laboratorio clínico.

- Experiencia laboral de 3 años en cargos similares en establecimientos de Salud.

El personal asociado a las capacitaciones posee una gran importancia en la propuesta de RRHH, dado que es el personal que se debe encargar en formar al personal para el correcto uso de los equipos, lo cual impactará directamente generando disminuciones en los costos de mantenimiento correctivo de los equipos durante la operación de estos.

Aparte de la responsabilidad asociado al mantenimiento de los equipos, el recurso humano tendrá que ejecutar labores asociadas a la administración de los equipos, siendo entre ellas, la gestión del inventario, registro de bajas de equipos, registro de ingresos, registros de mantenimientos y a su vez administrar los equipos que sean trasladados a los establecimientos de salud, por parte del personal de salud.

La dotación y sueldos se aborda en el apartado 7.3.5 Estrategias y costos de mantenimiento.

### 5.3.4 Equipos necesarios para brindar el servicio de Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico.

En base a las exigencias del contrato de concesiones, en la Tabla 16 se proponen las marcas y modelos asociados a los equipos requeridos para brindar el servicio de Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico:

**Tabla 16.** Equipos requeridos para ejecutar servicio de mantenimiento.

| Equipo | Equipo propuesto | Precio referencial (Pesos) | Requiere calibración | Costo referencial calibración anual (Pesos) |
|---|---|---|---|---|
| Analizador de seguridad eléctrica | Fluke modelo ESA-612 + 1210 | 5.818.600 | SI | 1.000.000 |
| Multímetros de parámetros eléctricos | Fluke modelo 287 | 1.250.000 | NO | N/A |
| Frecuenciómetro | | | | |
| Osciloscopios | Tenma modelo 72-2580 | 629.990 | NO | N/A |

| Equipo | Equipo propuesto | Precio referencial (Pesos) | Requiere calibración | Costo referencial calibración anual (Pesos) |
|---|---|---|---|---|
| Generadores de señales eléctricas | | | | |
| Simuladores de señales | Fluke modelo Prosim 8 con sonda de saturación | 19.934.023 | SI | 1.000.000 |
| Calibradores de oxímetros de pulso | | | | |
| Calibradores de electrocardiógrafos | | | | |
| Calibradores de respiradores | Fluke modelo VT-650 | 10.999.534 | SI | 1.300.000 |
| Calibradores de desfibriladores | Fluke modelo Impulse 7000DP | 9.773.946 | SI | 1.000.000 |
| Calibradores de bombas de infusión | Fluke modelo IDA-5 (4 canales) | 24.149.860 | SI | 1.300.000 |
| Analizadores de espectros | Keysight N9321C | 15.356.544 | NO | N/A |
| Fuentes de alimentación | Korad KD3303D | 180.000 | NO | N/A |
| Sonómetro | Veto modelo D9001509 | 465.845 | NO | N/A |
| Contadores Geiger | PCE Modelo Ram 8 | 258.298 | NO | N/A |
| Dosímetros | Dosimetro personal | 13.500 | NO | N/A |
| Registradores | Registrador temperatura autoclave | 490.901 | NO | N/A |

Nota: Elaboración propia.

Las cantidades de cada equipo se determinará en el apartado 7.3.5 Estrategias y costos de mantenimiento. Para los equipos que requieren calibración, esta deberá ser realizada 1 vez al año.

Adicionalmente, se debe considerar un maletín con herramientas para las personas que efectuarán labores técnicas, junto con los equipos informáticos para el personal, siendo estos computadores, celulares, impresora de etiquetas, impresoras papel. La dotación de estos equipos ser aborda en el apartado 7.3.5 Estrategias y costos de mantenimiento.

Una de las grandes problemáticas a nivel del mantenimiento del Equipamiento Médico es la ubicación de los equipos, dado que existen movimientos entre servicios, ya sea por prestamos o intercambio de equipos para cubrir fallas, lo que a su vez genera

ineficiencias operativas dado que el personal debe destinar tiempo en encontrar los equipos de manera específica, poniendo en riesgo la programación y ejecución de las mantenciones. Es por este motivo que se propone implementar la tecnología de búsqueda por medio de Tag para dar solución a esta problemática. Evaluando los equipos que requieren mantenimiento preventivo, se determinó que la tecnología tag debería aplicar para 53 tipologías, correspondiente a 1.056 unidades. El detalle de estos equipos se puede observar en el Anexo 2 Propuesta Tag.

El costo de un dispositivo tag estimado, asciende a 120.000 pesos, dado que estos dispositivos utilizan batería, se debe considerar efectuar el cambio de batería cada 2 años cuando estas presenten un nivel de autonomía bajo, por lo que los costos asociados a la adquisición y mantención se pueden observar en la Tabla 17.

**Tabla 17** Costos tecnología TAG.

| | Precio (Pesos) | Unidades | Costo total (Pesos) |
|---|---|---|---|
| Dispositivo tag | 120.000 | 1.056 | 126.720.000 |
| Batería | 70.000 | 1.056 | 73.920.000 |

Nota: Elaboración propia.

Considerando las exigencias del contrato de Concesiones, se estima que el costo de adquisición de los equipos Backup, adquiriendo 1 unidad adicional de los equipos involucrados, asciende a 3.028.150.943 Millones de pesos. El cumplimiento de esta exigencia será abordado en el apartado 7.3.5 Estrategias y costos de mantenimiento.

### 5.3.5 Estrategias y costos de mantenimiento.

Para determinar la mejor propuesta de mantenimiento preventivo, se diseñan y proponen dos tipos de estrategias. La primera estrategia consiste en la externalización del mantenimiento preventivo para todos los equipos, en cambio, la segunda estrategia considera un mix entre equipos cuyo mantenimiento preventivo será externalizado y en otros casos la ejecución será realizada a nivel interno. La evaluación financiera de ambas estrategias se realiza en un periodo de 15 años y se utiliza una tasa de descuento del 8%.

### 5.3.5.1 Estrategia N°1: Mantenimiento preventivo externalizado.

La estrategia de externalización de mantenimiento preventivo posee los siguientes alcances:

- Los costos de mantenimiento son calculados en base a los montos referenciales expuestos por los proveedores durante los procesos de licitación del proyecto.
- Externalizando las mantenciones, los proveedores suministrarán los analizadores correspondientes, motivo por el cual se deben adquirir menos equipos para el taller de mantenimiento. De igual forma se considera que los backups de los equipos deberán ser incluidos en los contratos de mantenimiento.
- Se debe considerar personal técnico para acompañar a los proveedores a la ejecución del mantenimiento y facilitar las unidades correspondientes.
- Se debe considerar personal administrativo para digitalizar y respaldar los protocolos de mantenimiento ejecutados.

#### 5.3.5.1.1 Costos de mantenimiento.

Para la determinación de costos de mantenimiento se utiliza como base de información lo declarado por los proveedores durante los procesos de licitación. Considerando las frecuencias definidas en el apartado 7.3.2 y los costos referenciales definidos por los proveedores, se estima que anualmente el costo de mantenimiento preventivo para las 1.603 unidades asciende los 1.040.053.000 pesos, correspondiendo a los costos directos de mantenimiento. Dado que las mantenciones se gestionarán por medio de contratos de mantenimientos, es necesario considerar que dichos contratos podrían incluir clausulas adicionales que repercutirán en los costos totales de mantenciones, entre las cuales se encuentran:

1- Cumplimiento de mantenimiento preventivo en base a programación anual.
2- Ejecución de mantenimiento preventivo en horarios no hábiles.
3- Duración establecida para la ejecución del mantenimiento.
4- Dotación de personal y nivel de expertis del personal que ejecutará el mantenimiento.
5- Instalación de Kits de mantenimiento y desecho de estos.

6- Backups de equipos para ejecución de mantenimiento.
7- Herramientas para ejecución de mantenimiento y analizadores.
8- Actualización de software en caso de ser requerido.
9- Capacitación de uso del equipo a usuarios clínicos.
10- Traspaso de riesgos operacionales.
11- Multas por incumplimientos contractuales, retraso en la ejecución de mantenimiento, reprogramaciones por causas de empresa externa, indisponibilidad de kits de mantenimiento, analizadores sin calibración vigente, etc.

Muchas de las exigencias expuestas anteriormente no se encuentran consideradas en los costos de mantención expuestos por los proveedores. Considerando exigencias de tiempo, personal, mantenimiento en horario no hábil (Podría aumentar un 20% el costo de mantenimiento), además de las exigencias de los equipos backups, se estima que los costos de agencia de los contratos de mantenimiento pueden equivaler a un 25% de los costos directos del mantenimiento preventivo.

Para realizar la evaluación financiera se considera un reajuste anual del 4,5%, tomando como referencia el IPC acumulado durante el año 2024.

#### 5.3.5.1.2 Dotación de personal.

El personal que estará involucrado directamente con el mantenimiento preventivo corresponderá al Encargado de servicio, Administrativo, Ingeniero EEMC y Técnico EEMC. Dado que el mantenimiento preventivo será completamente externalizado se considera que el perfil Técnico EEMC requerirá un perfil de especialización bajo, dado que no efectuará actividades que intervengan los equipos. La dotación propuesta se puede observar en la Tabla 18.

**Tabla 18** Dotación de personal estrategia externa.

| Cargo | Dotación | Sueldo líquido Mensual (Pesos) | Sueldo Bruto Mensual (Pesos) | Costo Bruto anual (Pesos) |
|---|---|---|---|---|
| Encargado de servicio | 1 | 3.500.000 | 4.550.000 | 54.600.000 |
| Administrativo | 3 | 1.000.000 | 1.300.000 | 46.800.000 |
| Ingeniero EEMC | 3 | 1.700.000 | 2.210.000 | 79.560.000 |
| Técnico EEMC | 5 | 1.150.000 | 1.495.000 | 89.700.000 |
| | | | | 270.660.000 |

Nota: Elaboración propia.

Para realizar la evaluación financiera se considera un reajuste anual del 4,5%, tomando como referencia el IPC acumulado durante el año 2024

#### 5.3.5.1.3 Equipamiento necesario para el mantenimiento.

Dado que la ejecución de esta estrategia será externalizada, no será necesario la adquisición de la totalidad de los equipos para efectuar las mantenciones expuestos en el apartado 7.3.4, ya que esta exigencia puede ser incluida en los contratos de mantenimiento, al igual que la exigencia asociada a la vigencia de la calibración de los analizadores a utilizar durante el proceso de mantenimiento preventivo.
Para cumplir con las exigencias del contrato de concesiones, se deberá considerar la adquisición de los equipos expuestos en la Tabla 19.

**Tabla 19.** Equipos requeridos para ejecutar el servicio.

| Equipo | Equipo propuesto | Precio referencial (Pesos) | Cantidad | Monto total (Pesos) |
|---|---|---|---|---|
| Osciloscopios | Tenma modelo 72-2580 | 629.990 | 4 | 2.519.960 |
| Generadores de señales eléctricas | | | | |
| Analizadores de espectros | Keysight N9321C | 15.356.544 | 1 | 15.356.544 |
| Fuentes de alimentación | Korad KD3303D | 180.000 | 4 | 720.000 |
| Sonómetro | Veto modelo D9001509 | 465.845 | 4 | 1.863.380 |
| Contadores Geiger | PCE Modelo Ram 8 | 258.298 | 2 | 516.596 |
| Dosímetros | Dosimetro personal | 13.500 | 5 | 67.500 |

| Equipo | Equipo propuesto | Precio referencial (Pesos) | Cantidad | Monto total (Pesos) |
|---|---|---|---|---|
| Registradores | Registrador temperatura autoclave | 490.901 | 5 | 2.454.505 |
| | | | | 23.498.485 |

Nota: Elaboración propia.

Se considera una vida útil de estos equipos de 6 años y su variación anual se calculará, tomando como referencia el valor del IPC anual durante el año 2024, equivalente a un 4,5%.

Respecto a los equipos de oficina para ser utilizados por el personal involucrado con las actividades de mantenimiento preventivo, se proponen los expuestos en la Tabla 20.

**Tabla 20** Equipos oficina para ejecutar servicio estrategia externa.

| Equipo | Precio referencial (Pesos) | Cantidad | Costo total (Pesos) |
|---|---|---|---|
| Computador | 1.000.000 | 12 | 12.000.000 |
| Celular | 250.000 | 12 | 3.000.000 |
| Impresora de etiquetas | 320.000 | 2 | 640.000 |
| Impresora de papel | 600.000 | 1 | 600.000 |
| | | | 16.240.000 |

Nota: Elaboración propia.

Se considera una vida útil de estos equipos de 5 años y su variación anual se calculará, tomando como referencia el valor del IPC anual durante el año 2024, equivalente a un 4,5%.

Para la evaluación financiera se incorpora los costos asociados a la tecnología de búsqueda de equipos TAG, mencionada en el apartado 7.3.4, considerando una vida útil de 8 años y las baterías con una vida útil de 3 años. La variación anual se calculará, tomando como referencia el valor del IPC anual durante el año 2024, equivalente a un 4,5%. Es importante destacar que dado que en el año 9 se adquiere repone nuevamente

le dispositivo tag, la siguiente reposición de baterías corresponde 3 años posterior a la reposición.

#### 5.3.5.1.4 Evaluación financiera estrategia N°1.

Considerando los costos expuestos en la presenta estrategia, se efectúa la evaluación financiera, siendo esta realizada en base al Valor actual de costos (VAC), realizada a un periodo de 15 años, a una tasa de descuento del 8%. El resultado de la evaluación financiera se puede observar en la Tabla 21.

**Tabla 21.** Evaluación financiera estrategia externa.

| Metrica financiera | Monto | Unidad |
|---|---|---|
| VAN | -19.448.746.035 | Pesos |
| VAC | 19.448.746.035 | Pesos |

Nota: Elaboración propia.

Mediante la estrategia de externalización completa del mantenimiento preventivo se obtiene un VAC de 19.448.746.035 pesos.

### 5.3.5.2 Estrategia 2: Estrategia de mantenimiento preventivo mixta.

La estrategia mixta, consiste en clasificar que Tipos de Equipos deberían ser realizado por medio de mantenimiento interno o externo, para lo cual se toma en consideración el nivel tecnológico de los equipos, el nivel de conocimiento que debería tener el personal a efectuar el mantenimiento y función del equipo. En base a esto se realiza una evaluación de los equipos del proyecto determinando si su enfoque de mantenimiento será interno o externo, obteniendo los resultados de la Tabla 22. El detalle de los equipos puede ser observado en el Anexo 4 Estrategias mantenimiento.

**Tabla 22** Clasificación equipos mantenimiento interno y externo.

| Mantención | Tipos de equipo | Unidades | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| Externa | 147 | 604 | 38% |
| Interna | 53 | 999 | 62% |
| Total | 200 | 1603 | 100% |

Nota: Elaboración propia.

La frecuencia de mantención para los equipos cuya mantención preventiva será realizada externamente se pueden observar en la Tabla 23.

**Tabla 23** Frecuencia de mantenimiento preventivo equipos enfoque externo.

| Frecuencia | Tipos de equipo | Unidades | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| Anual | 56 | 214 | 35% |
| Semestral | 85 | 381 | 63% |
| Trimestral | 6 | 9 | 1% |
| Total | 147 | 604 | 100% |

Nota: Elaboración propia.

La frecuencia de mantención para los equipos cuya mantención preventiva será realizada de manera interna se puede observar en la Tabla 24.

**Tabla 24** Frecuencia de mantenimiento preventivo equipos enfoque interno.

| Frecuencia | Tipos de equipo | Unidades | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| Anual | 43 | 481 | 48% |
| Semestral | 10 | 518 | 52% |
| Trimestral | 0 | 0 | 0% |
| Total | 53 | 999 | 100% |

Nota: Elaboración propia.

Considerando las frecuencias de mantenimiento preventivo, para las 604 unidades cuyo enfoque será por medio de mantenimiento externo, se deberá ejecutar un total anual de 1.012 mantenciones, en cambio, para las 999 unidades cuyo enfoque será por medio de mantenimiento preventivo interno, se tendrán que ejecutar un total anual de 1.517 mantenciones.

#### 5.3.5.2.1 Costos de mantenimiento.

Para las unidades que se realizarán mediante mantenimiento externo, se considerarán los mismos costos de mantención preventiva declarado por los proveedores, lo que permite estimar que el costo directo anual para efectuar el mantenimiento preventivo externalizado de las 604 unidades asciende a 469.683.000 pesos. Al igual que en la estrategia N°1, se considera como costo de agencia un 25% de los costos directos de mantenimiento, dado

las potenciales exigencias contractuales que podrían surgir al concretar los contratos de mantenimiento con los diferentes proveedores.
Para la evaluación financiera se considerarán reajuste anual del 4,5%.

El costo de mantenimiento interno de las 999 unidades restantes será 0, dado que dicho costo será absorbido por la dotación del personal especializado destinado a cumplir el mantenimiento preventivo, además de los costos asociados a la compra de los equipos requeridos para ejecutar las mantenciones. Se estima que, para cumplir con la ejecución del mantenimiento preventivo interno, se requerirá un total de 2.244,5 HH, esta información se levantó considerando los tiempos de duración de mantenimiento preventivo declarada por los proveedores.

#### 5.3.5.2.2 Dotación de personal.

El personal que estará involucrado directamente con el mantenimiento preventivo corresponderá al Encargado de servicio, Administrativo, Ingeniero EEMC y Técnico EEMC.
En particular para el perfil de Técnico de EEMC, este será subdivido en Técnico EEMC de alta especialización y Técnico EEMC de baja especialización. El Técnico EEMC de alta especialización se encargará de efectuar el mantenimiento preventivo a nivel interno, en cambio el Técnico EEMC de baja especialización se encargará de facilitar los equipos y acompañar a los proveedores externos durante la ejecución del mantenimiento preventivo.

Se analizaron los equipos a gestionar de mantenimiento interno, clasificando la especialización de estos entre Clínico no invasivo, Monitoreo, Motores, Pabellón, Refrigeración y Ventilación. Considerando la especialización de los técnicos, se considera que para efectuar el mantenimiento de estos equipos se requerirá de 4 técnicos especializados. Es importante destacar que los técnicos altamente especializados deberán ser sometidos a un programa de capacitación de los equipos a intervenir, motivo por el cual se considera capacitaciones anuales con un costo de formación de 5.000.000 pesos por técnico.

Por otro lado, se estima que considerando una estrategia hibrida se requerirá de mayor dotación del perfil de Ingeniero EEMC, dado que se requerirá un mayor control y análisis de los procesos de mantenimiento, entre los cuales destacan, la administración de contrato con las empresas externas compra de kits de mantenimiento y control de ejecución de mantenimiento interno.
Para la evaluación financiera se considerarán reajuste anual del 4,5%.

La propuesta de dotación de personal se puede observar en la Tabla 25.

**Tabla 25** Dotación de personal estrategia externa.

| Cargo | Dotación | Sueldo líquido Mensual (Pesos) | Sueldo Bruto Mensual (Pesos) | Costo Bruto anual (Pesos) |
|---|---|---|---|---|
| Encargado de servicio | 1 | 3.500.000 | 4.550.000 | 54.600.000 |
| Administrativo | 3 | 1.000.000 | 1.300.000 | 46.800.000 |
| Ingeniero EEMC | 5 | 1.700.000 | 2.210.000 | 132.600.000 |
| Técnico EEMC baja especialización | 2 | 1.150.000 | 1.495.000 | 35.880.000 |
| Técnico EEMC alta especialización | 4 | 1.750.000 | 2.275.000 | 109.200.000 |
| | | | | 379.080.000 |

Nota: Elaboración propia.

#### 5.3.5.2.3 Equipamiento necesario para el mantenimiento.

Dado que para la presente estrategia se realizará la ejecución del mantenimiento por medio de personal interno, se deberá considerar la adquisición de la totalidad de los equipos expuestos en el punto 7.7. La propuesta de equipos se puede observar en la Tabla 26.

**Tabla 26** Equipos requeridos para ejecutar el servicio.

| Equipo | Equipo propuesto | Precio referencial (Pesos) | Cantidad | Monto total Equipos (Pesos) | Monto total calibración anual |
|---|---|---|---|---|---|
| Analizador de seguridad eléctrica | Fluke modelo ESA-612 + 1210 | 5.818.600 | 4 | 23.274.400 | 4.000.000 |
| Multímetros de parámetros eléctricos | Fluke modelo 287 | 1.250.000 | 4 | 5.000.000 | 0 |
| Frecuenciómetro | | | | | |
| Osciloscopios | Tenma modelo 72-2580 | 629.990 | 4 | 2.519.960 | 0 |
| Generadores de señales eléctricas | | | | | |
| Simuladores de señales | Fluke modelo Prosim 8 con sonda de saturación | 19.934.023 | 3 | 59.802.069 | 3.000.000 |
| Calibradores de oxímetros de pulso | | | | | |
| Calibradores de electrocardiógrafos | | | | | |
| Calibradores de respiradores | Fluke modelo VT-650 | 10.999.534 | 1 | 10.999.534 | 1.300.000 |
| Calibradores de desfibriladores | Fluke modelo Impulse 7000DP | 9.773.946 | 2 | 19.547.892 | 2.000.000 |
| Calibradores de bombas de infusión | Fluke modelo IDA-5 (4 canales) | 24.149.860 | 2 | 48.299.720 | 2.600.000 |
| Analizadores de espectros | Keysight N9321C | 15.356.544 | 1 | 15.356.544 | 0 |
| Fuentes de alimentación | Korad KD3303D | 180.000 | 4 | 720.000 | 0 |
| Sonómetro | Veto modelo D9001509 | 465.845 | 4 | 1.863.380 | 0 |
| Contadores Geiger | PCE Modelo Ram 8 | 258.298 | 2 | 516.596 | 0 |
| Dosímetros | Dosimetro personal | 13.500 | 6 | 81.000 | 0 |
| Registradores | Registrador temperatura autoclave | 490.901 | 5 | 2.454.505 | 0 |
| | | | | 190.435.600 | 12.900.000 |

Nota: Elaboración propia.

Para la evaluación financiera se tomará en consideración de los montos de calibraciones en base, considerando variaciones tomando como referencia el valor del IPC anual durante el año 2024, equivalente a un 4,5%, al igual que las variaciones de los montos de adquisición de los equipos para mantenimiento con una vida útil de 6 años.

Respecto a los equipos Backups, considerando exclusivamente los equipos cuya mantención preventiva será efectuada de manera interna, se propone considerar 1 unidad de backups. Los equipos que se deben adquirir, su cantidad, costo y su vida útil se puede observar en la Tabla 27.

**Tabla 27** Equipos Backup a considerar para brindar servicio.

| Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Costo backup (Pesos) | Vida util (Años) |
|---|---|---|---|
| 10034 | Electrocardiografo | 4.138.531 | 10 |
| 50007 | Calentador De Fluido | 3.584.467 | 8 |
| 50023 | Gabinete Calentador De Suero | 4.774.926 | 8 |
| 50039 | Bomba Alto Flujo Y Calentador De Sueros | 10.417.999 | 8 |
| 130002 | Central Monitoreo Recuperacion | 328.720.497 | 8 |
| 130003 | Central Monitoreo UPC | 256.861.404 | 8 |
| 130006 | Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria | 3.028.757 | 8 |
| 130007 | Monitor Desfibrilador | 7.729.581 | 8 |
| 130008 | Monitor Desfibrilador C/Mpe | 8.329.376 | 8 |
| 130010 | Monitor ECG Signos Vitales Baja Complejidad | 3.724.325 | 8 |
| 130011 | Monitor ECG Signos Vitales Mediana Complejidad | 4.640.515 | 8 |

| Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Costo backup (Pesos) | Vida util (Años) |
|---|---|---|---|
| 130015 | Desfibrilador tipo DEA | 2.283.814 | 8 |

Nota: Elaboración propia.

Los backups ascienden a un monto total de 638.234.192 pesos. Dado que dichos equipos deben ser mantenidos, de manera anual a nivel interno, se estima que las mantenciones de las unidades backups requerirán un total de 77,7 HH. Para la evaluación financiera se considerará una variación anual del 4,5 % del valor de los equipos y la vida útil de esos se considerará la misma de la que se estipula en el contrato de concesiones, siendo para algunos casos 8 años y para otros casos 10 años.

Respecto a los equipos de oficina propuestos para ser utilizados por el personal involucrado con las actividades de mantenimiento preventivo se pueden observar en la Tabla 28.

**Tabla 28** Equipos oficina para ejecutar servicio estrategia mixta.

| Equipo | Precio referencial (Pesos) | Cantidad | Costo total (Pesos) |
|---|---|---|---|
| Computador | 1.000.000 | 15 | 15.000.000 |
| Celular | 250.000 | 15 | 3.750.000 |
| Impresora de etiquetas | 320.000 | 2 | 640.000 |
| Impresora de papel | 600.000 | 1 | 600.000 |
| Maletín con herramientas | 400.000 | 4 | 1.600.000 |
| | | | 21.590.000 |

Nota: Elaboración propia.

Se considera una vida útil de estos equipos de 5 años y su variación anual se calculará, tomando como referencia el valor del IPC anual durante el año 2024, equivalente a un 4,5%.

Para la evaluación financiera se incorpora los costos asociados a la tecnología de búsqueda de equipos TAG, mencionada en el apartado 7.3.4, considerando una vida útil

de 8 años y las baterías con una vida útil de 3 años. La variación anual se calculará, tomando como referencia el valor del IPC anual durante el año 2024, equivalente a un 4,5%. Es importante destacar que dado que en el año 9 se adquiere repone nuevamente le dispositivo tag, la siguiente reposición de baterías corresponde 3 años posterior a la reposición.

#### 5.3.5.2.4 Evaluación financiera estrategia N°2.

Considerando los costos expuestos en la presenta estrategia, se efectúa la evaluación financiera, siendo realizada en base al Valor actual de costos (VAC), realizada a un periodo de 15 años, a una tasa de descuento del 8%. El resultado de la evaluación financiera se puede observar en la Tabla 29.

**Tabla 29** Evaluación financiera estrategia externa.

| Metrica financiera | Monto | Unidad |
|---|---|---|
| VAN | -14.129.298.073 | Pesos |
| VAC | 14.129.298.073 | Pesos |

Nota: Elaboración propia.

Mediante la estrategia hibrida de mantenimiento preventivo se obtiene un VAC de 14.129.298.073 pesos.

El detalle asociado a la evaluación financiera de ambas estrategias de mantenimiento se puede observar en el Anexo 5 Análisis financiero.

### 5.3.6 Actividades asociadas a la ejecución del mantenimiento preventivo.

Independiente de la estrategia, para brindar el servicio de mantenimiento y administración se deberá contemplar las siguientes actividades:

- Gestionar contratos de mantenimiento preventivo con proveedores: Ingeniero EEMC deberá elaborar las exigencias de los contratos de mantenimiento preventivo, con apoyo del área legal.

  Ingeniero EEMC deberá cotizar con diferentes proveedores y realizar la evaluación económica y técnica, para determinar la mejor opción, a su vez será responsable del proceso del proceso de mantenimiento para evaluar a las

empresas proveedores elegidas y levantar los incumplimientos contractuales de manera oportuna. La evaluación contractual deberá ser realizada mes a mes.

Para el caso de que la externalización no sea mediante contrato de mantenimiento, se deberá realizar cotizaciones de los servicios y emitir la orden de compra correspondiente los primeros 5 días del mes correspondiente a la ejecución del mantenimiento preventivo.

- Coordinación de mantenimiento: Ingeniero EEMC y Técnico EEMC elaboraran el cronograma de mantenimiento anual. Un mes previo a la ejecución del mantenimiento Ingeniero EEMC deberá corroborar las disponibilidades de horarios con los servicios clínicos.
- Verificación de entrenamiento y analizadores: Ingeniero EEMC y Técnico EEMC deberán verificar si el personal externo que realizará el mantenimiento cumple con las exigencias de entrenamiento del equipo estipuladas en los contratos de mantenimiento. De igual manera se deberá verificar si los analizadores que utilizará el proveedor externo poseen su calibración vigente. Esta verificación deberá ser realizada cada vez que ingrese el personal externo a realizar mantenimiento.
- Verificación de Backup brindado por el proveedor: Ingeniero EEMC o Técnico EEMC deberá verificar que el Backup que ingrese a reemplazar a alguna unidad posea su mantenimiento preventivo al día y se encuentre en buenas condiciones.
- Verificación de kits de mantenimiento: Ingeniero EEMC o Técnico EEMC deberá verificar que los kits de mantenimiento a utilizar por parte del proveedor externo se encuentran vigentes, además Técnico EEMC deberá verificar si el kit fue cambiado durante el proceso de mantenimiento. Esta verificación deberá ser realizada cada vez que un equipo requiera cambio de kit.
- Capacitación a personal Clínico: Perfil Capacitador (4 personas), será el encargado de gestionar la capacitación entre servicios clínicos y proveedores para el caso de capacitaciones externa (Equipos complejos). Para el caso de los equipos de menor complejidad, el capacitador será en encargado de ejecutar las mantenciones, previamente coordinadas con el personal clínico. Se deberá dejar constancia de cada capacitación ejecutada de manera formal.

- Actualización de inventario: Ingeniero EEMC y Técnico EEMC deberán realizar actualización del inventario en caso de que los equipos se encuentren físicamente en un servicio diferente al definido, a su vez de que se realicen bajas de equipo.

A nivel adicional de costo se puede contemplar los 4 perfiles de capacitadores, los cuales corresponden a profesionales de enfermería y tecnología médica con un costo bruto anual total de 87.360.000 pesos.

### 5.3.7 Procesos

Para el desarrollo de los procesos asociados al servicio de Administración y Mantenimiento, se focalizó principalmente en los procesos principales del servicio, siendo estos los siguientes:

1- Administración de inventario: El objetivo del proceso es determinar los responsables y las actividades necesarias para ejecutar la administración del inventario asociado a los equipos a adquirir.

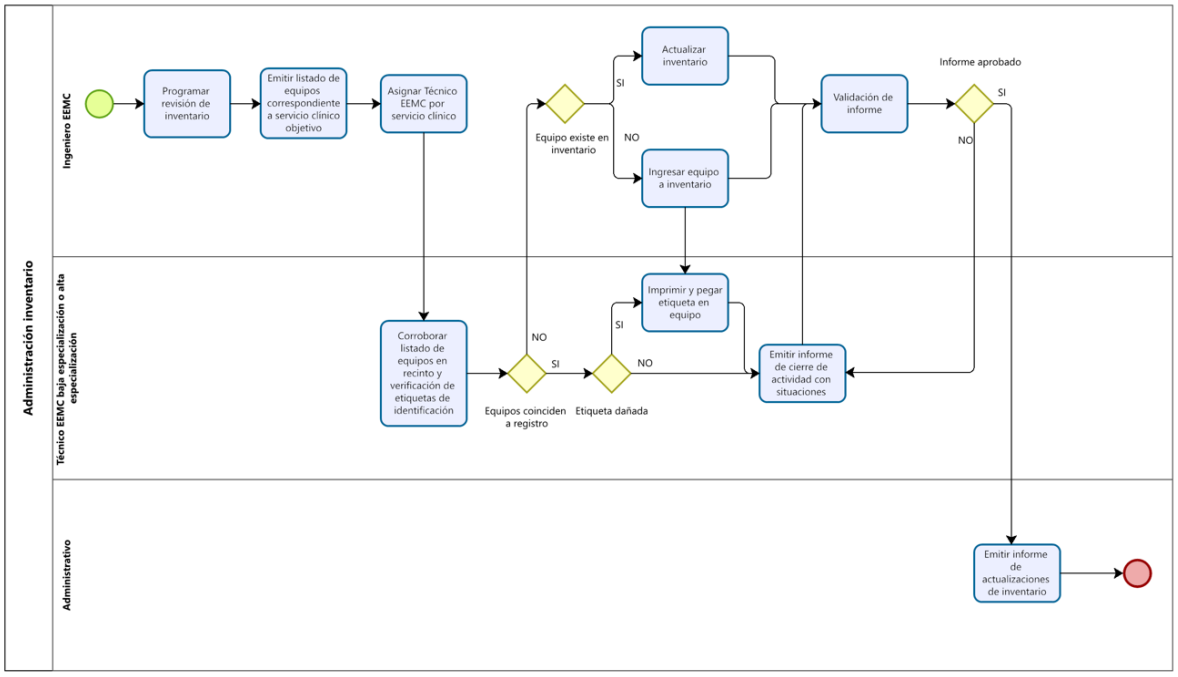



**Ilustración 3. Proceso Administración inventario.**

2- Verificación de proveedores. El objetivo del proceso es determinar los responsables y las actividades necesarias para ejecutar las acciones que garanticen que el personal del proveedor que interactuará con los equipos cumple con las capacitaciones requeridas para ejecutar la actividad, además de si los equipos backup y equipos requeridos para ejecutar las mantenciones se encuentran en condiciones para poder ser utilizados.

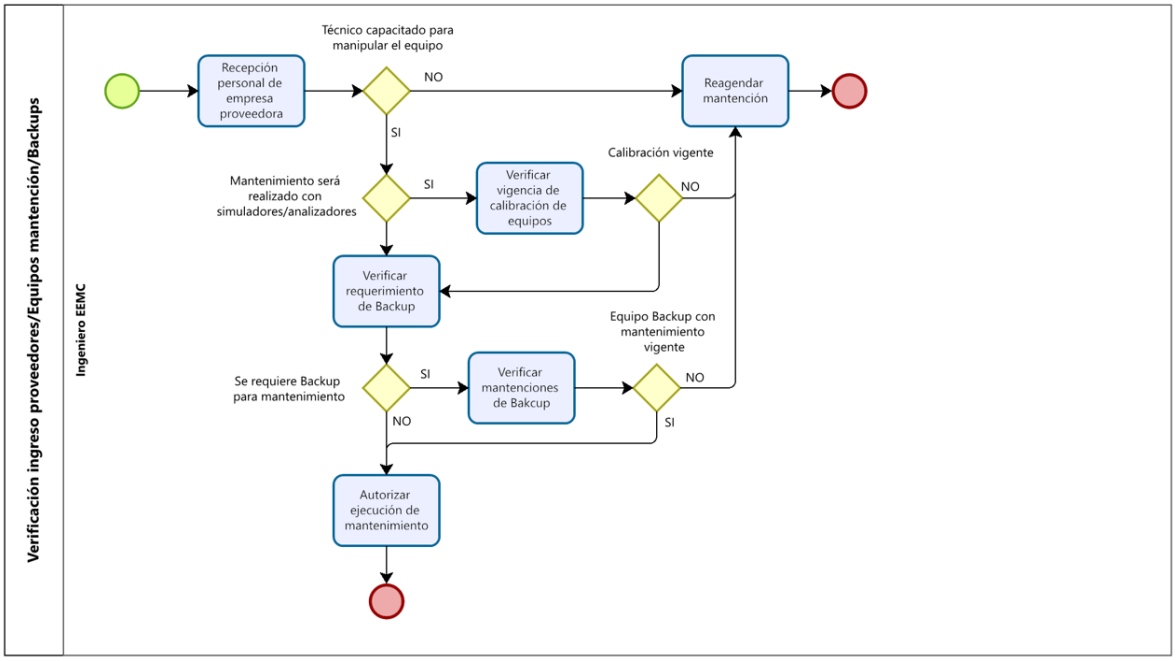



**Ilustración 4. Proceso verificación de proveedores.**

3- Ejecución de mantenimiento preventivo externo: El objetivo del proceso es determinar los responsables y las actividades necesarias para ejecutar las acciones que garanticen la correcta ejecución del mantenimiento preventivo mediante personal externo.

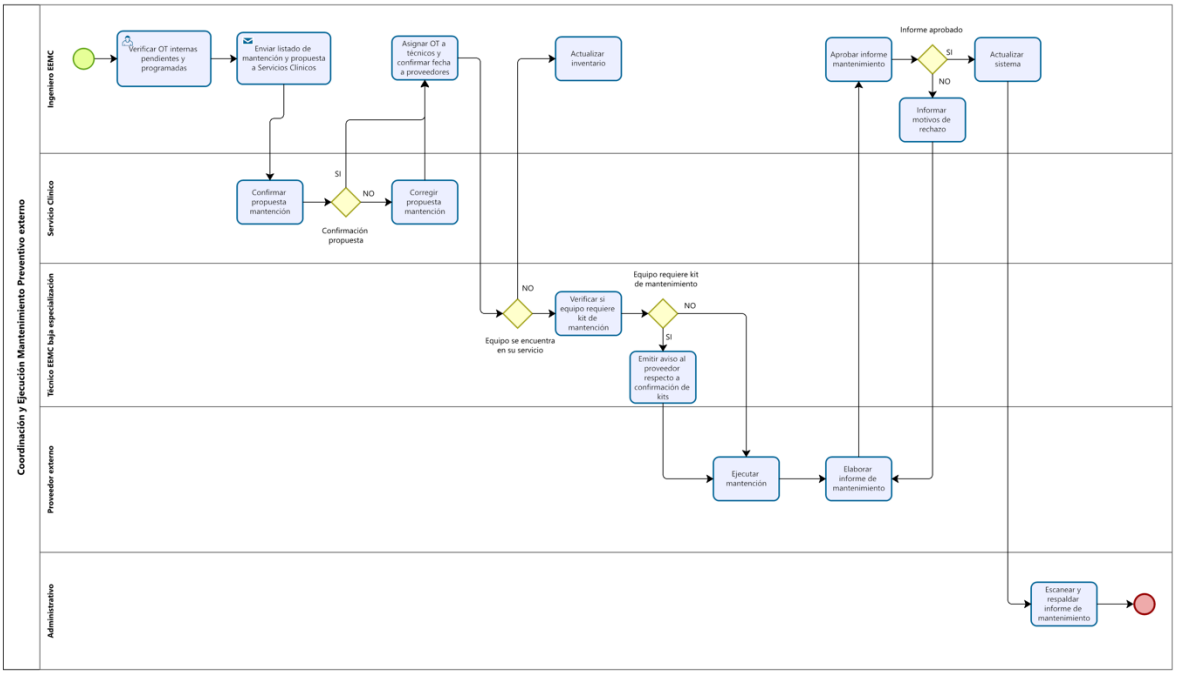



**Ilustración 5. Proceso mantenimiento preventivo por personal externo.**

4- Ejecución de mantenimiento preventivo interno: El objetivo del proceso es determinar los responsables y las actividades necesarias para ejecutar las acciones que garanticen la correcta ejecución del mantenimiento preventivo mediante personal externo.

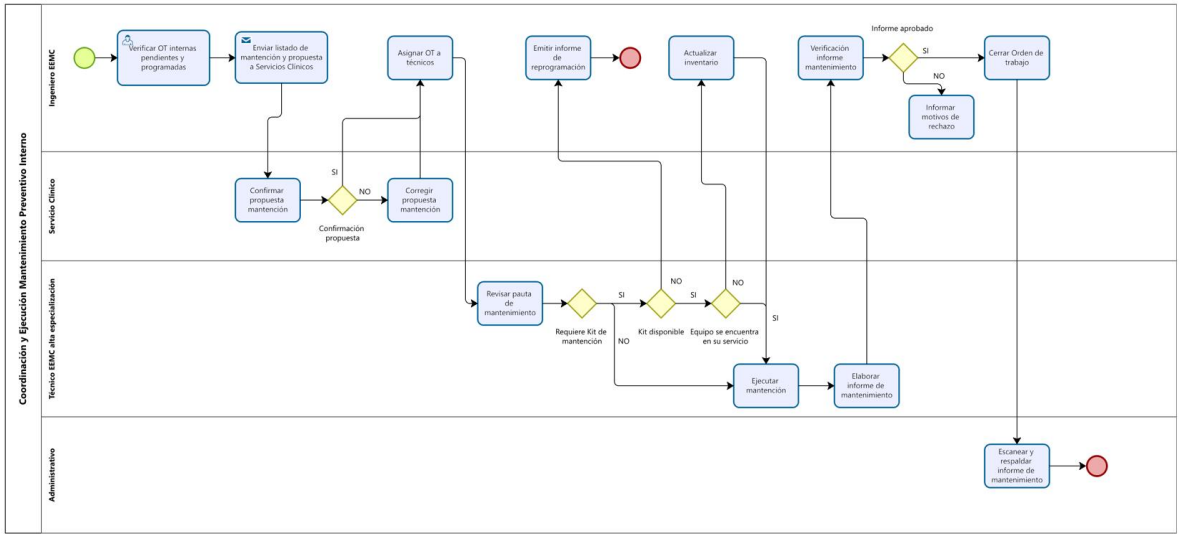



**Ilustración 6. Proceso mantenimiento preventivo por personal interno.**

### 5.3.8 Indicadores

Los indicadores deben ser desarrollados con la finalidad de permitir evaluaciones de rendimiento de los ámbitos técnicos y administrativos. El ámbito técnico tendrán relación con la ejecución directa del mantenimiento preventivo y la disponibilidad del equipo, en cambio el ámbito administrativo estará focalizado a la evaluación del rendimiento del personal y ejecución presupuestaria. Los indicadores técnicos se pueden observar en la Tabla 30 y los indicadores administrativos se pueden observar en la Tabla 31.

**Tabla 30** Indicadores técnicos.

| Indicador | Fórmula/Descripción | Unidad | Umbral |
|---|---|---|---|
| Disponibilidad del equipamiento | (Horas equipo operativo/Horas totales)*100 | % | 95-97 |
| Cumplimiento plan de mantenimiento preventivo | (N° mantenciones preventivas realizadas/N° mantenciones preventivas programadas)*100 | % | ≥95 |
| Cumplimiento plan de mantenimiento preventivo equipos de acreditación nacional | (N° mantenciones preventivas realizadas acreditación nacional/N° mantenciones preventivas programadas acreditación nacional)*100 | % | ≥99 |
| Cumplimiento Ordenes de trabajo mantenimiento preventivo por técnico | (N° mantenciones preventivas realizadas/N° de mantenciones preventivas asignadas) | % | ≥95 |
| Reprogramaciones | (N° mantenciones preventivas reprogramadas/N° mantenciones preventivas programadas)*100 | % | ≤5 |

Nota: Elaboración propia.

**Tabla 31** Indicadores administrativos

| Indicador | Fórmula/Descripción | Unidad | Umbral |
|---|---|---|---|
| Ejecución presupuestaria | (Gasto presupuestado/Gasto ejecutado)*100 | % | 95-105 |
| Equipos no encontrados | (N° de equipos extraviados/N° de equipos totales)*100 | % | ≤2 |
| Tiempo de gestión ordenes de compra | Días promedio desde solicitud de Orden de compra | Días | ≤ 3 |

Nota: Elaboración propia.

### 5.3.9 Comparación de estrategias.

Considerando la información elaborada en relación con los 2 escenarios de mantenimiento desarrollados en la presente propuesta se puede indicar lo siguiente:

1- El escenario Hibrido posee un costo de 1.976.063.542 de pesos, en comparación a los 1.737.190.735 pesos del escenario de externalización para el primer año de operación. El costo de operación de mantenimiento para el primer año es mayor en el escenario Hibrido, debido a que requiere una mayor inversión en equipos backups, al igual que requiere mayor dotación y personal técnico más especializado con capacitación constante.
2- A partir del año 2 se observan ahorros considerables en los costos de operación de mantenimiento de la estrategia hibrida, en comparación a la estrategia de externalización, esto debido al ahorro que generan efectuar las mantenciones a nivel interno por parte del personal técnico.
3- Los costos operativos de la estrategia hibrida aumentan considerablemente en el año 9, superando los costos operativos de la estrategia externa, debido a la reposición de equipos backups.
4- La estrategia hibrida permite un mayor control de la ejecución del mantenimiento, dado la disponibilidad y la adaptación del personal técnico interno, en comparación a la estrategia hibrida. Esta flexibilidad en la ejecución de mantenimiento favorece el cumplimiento de los programas de mantenimiento preventivo, permitiendo un alto nivel de cumplimiento, lo que se traduce en un mayor nivel de seguridad de atención a los pacientes.
5- A nivel nacional existe limitación respecto a la información técnica que suministran las empresas representantes de los equipos, motivo por el cual el conocimiento que perfeccione el personal interno será más limitado en comparación al conocimiento que pueden obtener los técnicos de las empresas representantes.
6- La estrategia hibrida durante los 15 años de operación evaluados posee un VAC de 5.319.447.962 pesos menor que la estrategia externa.

En base a los puntos externos anteriormente se propone tomar como referencia los lineamientos de la estrategia hibrida para brindar el servicio de Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico, dado el ahorro que genera a

nivel de costos, como a su vez la flexibilidad en la ejecución del mantenimiento de los equipos del establecimiento de salud.

# 6. Conclusiones.

El diseño del mantenimiento del equipamiento médico difiere entre establecimientos de salud, dependiendo de la composición de equipos que este tenga. La gestión eficiente del servicio de Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico resulta clave para cumplir con los estándares normativos, asegurar la disponibilidad de los equipos y garantizar la seguridad de los pacientes. Dado que los ingresos del concesionario dependen del cumplimiento de niveles de servicio, un diseño inadecuado del modelo operacional puede afectar directamente la rentabilidad del proyecto.

Para los establecimientos analizados, mediante el cálculo del número de gestión de equipo y juicio experto se determinó que 1.603 unidades de equipos deben ser incluidas en un programa de mantenimiento preventivo, las cuales equivalen a un 17% del volumen total de equipos. Las frecuencias de mantenimiento de los equipos son anuales, semestrales y trimestrales, dando un total de 2.529 mantenciones a anuales que deben ser ejecutadas para dar cumplimiento a las exigencias del contrato de Concesiones, como las exigencias determinadas por la Resolución Exenta N°1341 y las exigencias de los estándares exigidos en el proceso de acreditación de establecimientos hospitalarios.

La estrategia de mantenimiento preventivo externo permite transferir el riesgo y responsabilidades al proveedor externo, sin embargo, no posee tanta flexibilidad de ejecución de mantenimiento, poniendo en riesgo los cumplimientos de los programas de mantención. La estrategia de mantenimiento hibrida, permite transferir y determinar los riesgos que asumirá el proveedor y los que se asumirán a nivel interno, además posee una mayor flexibilidad de ejecución de mantenimiento, dado la disponibilidad y dedicación exclusiva del personal interno.

La estrategia de mantenimiento preventivo externo evaluada durante un periodo de 15 años posee un VAC de 19.448.746.035 pesos, en cambio la estrategia de mantenimiento preventivo hibrido posee un VAC de 14.129.298.073 pesos, lo cual se traduce en un ahorro de 5.319.447.962 pesos. Entre las principales diferencias de ambas estrategias se encuentran, el RRHH y su nivel de especialización a nivel de técnicos, equipos backup y el costo directo de mantenimiento externo. El factor que más contribuye en la disminución

del VAC de la estrategia hibrida se debe a la disminución de costos directo de mantenimiento externo, debido a la ejecución de estas por parte del personal interno.

Dado las ventajas y el VAC se sugiere implementar las estrategias de mantenimiento hibridas para el Servicio de Administración y Mantenimiento de Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico.

# 7. Bibliografia.


1- Cohen T. AAMI's Benchmarking solution: analysis of cost of service ratio and other metrics. Biomedical Instrumentation & Technology, 2010, 4(4):346-349.

2- OMNIA Partners, How to Drive MRO Savings with Total Cost of Ownership (TCO), 2021.

3- WHO, Medical device technical series, 2011

4- Ministerio de Salud, Decreto Exento N°290, 2017.

5- Super intendencia de salud, Manual del Estándar General de Acreditación para Prestadores Institucionales Atención Cerrada https://www.superdesalud.gob.cl/app/uploads/2016/04/articles-23475_recurso_1-1.pdf

# 8. Anexos.

## Anexo 1. Listado Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico.

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Critica | A.08.2.8 | 10002 | **Analizador Hidrogeno En Aire Espirado** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.11.2.6 | 10003 | **Analizador Termo Sensor** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.4.3 | 10004 | **Angiografo Retinal** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.12.2.2 | 10004 | **Angiografo Retinal** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.14.2.7 | 10005 | **Audiometro Alta Frecuencia** | 1 | 9 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.14.2.7 | 10005 | **Audiometro Alta Frecuencia** | 1 | 9 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.1 | 10007 | **Autorrefractometro Con Queratometro** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.12.2.2 | 10007 | **Autorrefractometro Con Queratometro** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.4.4_B | 10007 | **Autorrefractometro Con Queratometro** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.03.2.3 | 10008 | **Balanza Adulto Con Tallimetro** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.04.2.3 | 10008 | **Balanza Adulto Con Tallimetro** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.07.2.4 | 10008 | **Balanza Adulto Con Tallimetro** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.09.2.1 | 10008 | **Balanza Adulto Con Tallimetro** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.3 | 10008 | **Balanza Adulto Con Tallimetro** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.4 | 10008 | **Balanza Adulto Con Tallimetro** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.14.2.12 | 10008 | **Balanza Adulto Con Tallimetro** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.16.2.7 | 10008 | **Balanza Adulto Con Tallimetro** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.18.2.7 | 10008 | **Balanza Adulto Con Tallimetro** | 5 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.19.2.16 | 10008 | **Balanza Adulto Con Tallimetro** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.21.1.4 | 10008 | **Balanza Adulto Con Tallimetro** | 3 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.22.2.2 | 10008 | **Balanza Adulto Con Tallimetro** | 3 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.22.2.5 | 10008 | **Balanza Adulto Con Tallimetro** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 20:00 Hrs. | | |
| Muy Critica | A.23.2.5 | 10008 | **Balanza Adulto Con Tallimetro** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.6 | 10008 | **Balanza Adulto Con Tallimetro** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.3.29.1.2 | 10008 | **Balanza Adulto Con Tallimetro** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.1.31.3.1 | 10008 | **Balanza Adulto Con Tallimetro** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.2.32.3.1 | 10008 | **Balanza Adulto Con Tallimetro** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.3.33.3.1 | 10008 | **Balanza Adulto Con Tallimetro** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.4.34.3.1 | 10008 | **Balanza Adulto Con Tallimetro** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.5.35.3.1 | 10008 | **Balanza Adulto Con Tallimetro** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.6.36.3.1 | 10008 | **Balanza Adulto Con Tallimetro** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.1.3.1 | 10008 | **Balanza Adulto Con Tallimetro** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.2.4.1 | 10008 | **Balanza Adulto Con Tallimetro** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | G.42.3.1 | 10008 | **Balanza Adulto Con Tallimetro** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.3.47.4.2 | 10008 | **Balanza Adulto Con Tallimetro** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.03.2.4 | 10008 | **Balanza Adulto Con Tallimetro** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.11 | 10008 | **Balanza Adulto Con Tallimetro** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.9 | 10008 | **Balanza Adulto Con Tallimetro** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.18.2.8 | 10008 | **Balanza Adulto Con Tallimetro** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.19.2.17 | 10008 | **Balanza Adulto Con Tallimetro** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.19.2.18 | 10008 | **Balanza Adulto Con Tallimetro** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.19.2.3 | 10008 | **Balanza Adulto Con Tallimetro** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.22.2.4 | 10008 | **Balanza Adulto Con Tallimetro** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.06.2.4 | 10008 | **Balanza Adulto Con Tallimetro** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | H.1.43.3.5 | 10008 | **Balanza Adulto Con Tallimetro** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | I.3.47.10.1 | 10008 | **Balanza Adulto Con Tallimetro** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 20:00 Hrs. | | |
| Menos Critica | A.1.2.2 | 10008 | **Balanza Adulto Con Tallimetro** | 3 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.1.2.4 | 10008 | **Balanza Adulto Con Tallimetro** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.2.2 | 10008 | **Balanza Adulto Con Tallimetro** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.1.3.3.8 | 10008 | **Balanza Adulto Con Tallimetro** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.2.4.3.1 | 10008 | **Balanza Adulto Con Tallimetro** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.3.5.3.5 | 10008 | **Balanza Adulto Con Tallimetro** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.26.4.5 | 10008 | **Balanza Adulto Con Tallimetro** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.4.5 | 10009 | **Balanza Cama** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.3.40.3.5 | 10009 | **Balanza Cama** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.2.32.3.5 | 10009 | **Balanza Cama** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.4.34.3.5 | 10009 | **Balanza Cama** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.6.36.3.5 | 10009 | **Balanza Cama** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 20:00 Hrs. | | |
| Menos Critica | A.03.2.4 | 10010 | **Balanza Paciente Bariatrico** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.04.2.3 | 10010 | **Balanza Paciente Bariatrico** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.11 | 10010 | **Balanza Paciente Bariatrico** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.06.2.4 | 10010 | **Balanza Paciente Bariatrico** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.22.5.5 | 10011 | **Balanza Silla** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.1.31.3.1 | 10011 | **Balanza Silla** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.2.32.3.1 | 10011 | **Balanza Silla** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.3.33.3.1 | 10011 | **Balanza Silla** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.4.34.3.1 | 10011 | **Balanza Silla** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.5.35.3.1 | 10011 | **Balanza Silla** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.6.36.3.1 | 10011 | **Balanza Silla** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.2.39.3.5 | 10011 | **Balanza Silla** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24:00 Hrs. | | |
| Menos Critica | A.07.2.4 | 10011 | **Balanza silla** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.9 | 10011 | **Balanza Silla** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.2.4.1 | 10011 | **Balanza Silla** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.4.5 | 10011 | **Balanza Silla** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.3.40.3.5 | 10011 | **Balanza Silla** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | G.1.42.3.1 | 10011 | **balanza silla** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.1.2.2 | 10011 | **Balanza Silla** | 4 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.1.2.4 | 10011 | **Balanza Silla** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.5.2 | 10011 | **Balanza Silla** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.1.3.3.5 | 10011 | **Balanza Silla** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.10.7 | 10011 | **Balanza Silla** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | A.2.2.2 | 10011 | **Balanza Silla** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.8.4 | 10011 | **Balanza Silla** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.2.4.3.5 | 10011 | **Balanza Silla** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.3.5.3.5 | 10011 | **Balanza Silla** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Muy Critica | F.4.41.3.5 | 10011 | **Balanza Silla** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.4.6 | 10012 | **Barra De Prismas Horizontal** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.4.6 | 10013 | **Barra De Prismas Vertical** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.1.2.4 | 10014 | **Bioimpedanciometro** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.7.3 | 10014 | **Bioimpedanciometro** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.03.2.4 | 10014 | **Bioimpedanciometro** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.18.2.8 | 10014 | **Bioimpedanciometro** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.4.4 | 10015 | **Biometro** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.10 | 10016 | **Caja Lentes** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 20:00 Hrs. | | |
| Menos Critica | A.13.3.2 | 10016 | **Caja Lentes** | 7 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.5 | 10016 | **Caja Lentes** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.4.6 | 10016 | **Caja Lentes** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.12.2.1 | 10016 | **Caja Lentes** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.12.2.5 | 10016 | **Caja Lentes** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.7 | 10016 | **Caja Lentes** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.9 | 10016 | **Caja Lentes** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.12.2.6 | 10016 | **Caja Lentes** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.1.2.4 | 10017 | **Caliper** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.03.2.4 | 10017 | **Caliper** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.22.2.4 | 10017 | **Caliper** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | B.1.3.3.5 | 10017 | **Caliper** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.18.2.8 | 10017 | **Caliper** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.1.2.4 | 10018 | **Caliper De Ross** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | H.2.44.5.2 | 10019 | **Camara De Video** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.2.4.7 | 10019 | **Camara De Video** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.3.3 | 10020 | **Camara Fotografica** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.14.2.7 | 10022 | **Camara Silente** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.14.2.7 | 10023 | **Camara Silente Con Amplificadopres Y Campo Libre** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.4.2 | 10024 | **Campimetro Computarizado** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.4.2 | 10024 | **Campimetro Computarizado** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.4.2 | 10026 | **Campimetro Goldman** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.12.2.2 | 10026 | **Campimetro Goldman** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.14.2.5 | 10027 | **Cintillo De Luz Frontal** | 8 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.14.2.12 | 10027 | **Cintillo De Luz Frontal** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.14.2.9 | 10027 | **Cintillo De Luz Frontal** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.2.5 | 10028 | **Dermatoscopio** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.04.2.1 | 10029 | **Diapason De Sensibilidad** | 3 | 7 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.14 | 10030 | **Doppler Con Pletismografia Vascular** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.TM | 10031 | **Doppler Vascular** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.3 | 10031 | **Doppler vascular** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.13 | 10032 | **Doppler Vascular Portatil** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.2.3.3 | 10032 | **Doppler Vascular Portatil** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.13.4.4 | 10033 | **Ecografo Ocular** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.12.2.2 | 10033 | **Ecografo Ocular** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.13.4.4_B | 10033 | **Ecografo Ocular** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.09.2.11 | 10034 | **Electrocardiografo** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.09.2.6 | 10034 | **Electrocardiografo** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.2.5 | 10034 | **Electrocardiografo** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.6 | 10034 | **Electrocardiografo** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.4.1 | 10034 | **Electrocardiografo** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.2.39.3.1 | 10034 | **Electrocardiografo** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.3.40.3.1 | 10034 | **Electrocardiografo** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.09.2.7 | 10034 | **Electrocardiografo** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.19.2.4 | 10034 | **Electrocardiografo** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.12.2.3 | 10034 | **Electrocardiografo** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Critica | C.1.27.5.2 | 10034 | **Electrocardiografo** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.7.1 | 10034 | **Electrocardiografo** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.9.2/C.2.30.1.5 | 10034 | **Electrocardiografo** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.1.31.3.2 | 10034 | **Electrocardiografo** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.2.32.3.2 | 10034 | **Electrocardiografo** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.3.33.3.2 | 10034 | **Electrocardiografo** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.4.34.3.2 | 10034 | **Electrocardiografo** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.5.35.3.2 | 10034 | **Electrocardiografo** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.6.36.3.2 | 10034 | **Electrocardiografo** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | G.42.3.2 | 10034 | **Electrocardiografo** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.1.2.3 | 10034 | **Electrocardiografo** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.1.2.6 | 10034 | **Electrocardiografo** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.1.2.2 | 10034 | **Electrocardiografo** | 3 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.8.2 | 10034 | **Electrocardiografo** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.1.3.3.2 | 10034 | **Electrocardiografo** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.3.5.3.5 | 10034 | **Electrocardiografo** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.26.4.5 | 10034 | **Electrocardiografo** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.4.41.3.1 | 10034 | **Electrocardiografo** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.11.2.7 | 10035 | **Electroencefalografo** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.11.2.7 | 10035 | **Electroencefalografo** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.4.41.4.1 | 10035 | **Electroencefalografo** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.11.2.6 | 10037 | **Electromiografo Con Potenciales Evocados** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.13.4.5 | 10038 | **Electroretinografo** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.08.2.8 | 10039 | **Equipo De Manometria E Impedanciometria Esofagica Y Rectal** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.14.2.11 | 10040 | **Equipo De Potenciales Evocados Con Vem** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.5 | 10041 | **Equipo Urodinamia** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.19.2.18 | 10042 | **Esfigmomanometro Portatil de Sobremesa** | 1 | 7 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.3.1 | 10043 | **Esfigmomanometro Rodable** | 1 | 7 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.3.2 | 10043 | **Esfigmomanometro Rodable** | 1 | 7 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.3.3 | 10043 | **Esfigmomanometro Rodable** | 1 | 7 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.4.1 | 10043 | **Esfigmomanometro Rodable** | 1 | 7 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.4.4 | 10043 | **Esfigmomanometro Rodable** | 1 | 7 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.4.4 | 10043 | **Esfigmomanometro Rodable** | 1 | 7 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | B.26.5.2 | 10044 | **Espirometro Portatil** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.8 | 10045 | **Exoftalmometro De Hertel** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.4.5 | 10046 | **Flujometro De Wright** | 2 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.2.39.3.5 | 10046 | **Flujometro De Wright** | 2 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.3.40.3.5 | 10046 | **Flujometro De Wright** | 3 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.4.41.3.5 | 10046 | **Flujometro De Wright** | 3 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | H.1.43.3.1 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.1.2.2 | 10047 | **Fonendoscopio** | 7 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.17.2.1 | 10047 | **Fonendoscopio** | 7 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.19.2.11 | 10047 | **Fonendoscopio** | 4 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | H.2.44.4.1 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | H.2.44.3.6 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.2.4.2 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.4.2_P | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.4.3 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.4.4 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.4.5 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.4.6 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.6.2 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.6.3 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.7.3 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.8.2 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.8.3 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.8.4 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y | 3 dias | Edificio N°2 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 20:00 Hrs. | | |
| Critica | A.2.9.2 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.9.3 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.9.4 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.9.5 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.10.2 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.10.3 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.10.7 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.5.2 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.5.3 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.5.4 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.5.5 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.15 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | C.1.6.2.1 | 10047 | **Fonendoscopio** | 5 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.7 | 10047 | **Fonendoscopio** | 3 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.6 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.5 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.03.2.3 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.04.2.3 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.06.2.1 | 10047 | **Fonendoscopio** | 2 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.06.2.2 | 10047 | **Fonendoscopio** | 6 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.06.2.3 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.06.2.4 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.09.2.7 | 10047 | **Fonendoscopio** | 2 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.10 | 10047 | **Fonendoscopio** | 2 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.11 | 10047 | **Fonendoscopio** | 2 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | A.10.2.13 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.8 | 10047 | **Fonendoscopio** | 3 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.9 | 10047 | **Fonendoscopio** | 3 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.5 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.6 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.7 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.15 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.11.2.1 | 10047 | **Fonendoscopio** | 4 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.11.2.4 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.11.2.2 | 10047 | **Fonendoscopio** | 7 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.11.2.3 | 10047 | **Fonendoscopio** | 2 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.11.2.6 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.11.2.7 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.11.2.8 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.13.5 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.13.6 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.1 | 10047 | **Fonendoscopio** | 2 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.2 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.4 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.6 | 10047 | **Fonendoscopio** | 2 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.7 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.3 | 10047 | **Fonendoscopio** | 3 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.5 | 10047 | **Fonendoscopio** | 2 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.13.4 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.2.1 | 10047 | **Fonendoscopio** | 18 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.14.2.1 | 10047 | **Fonendoscopio** | 9 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Critica | C.1.27.5.2 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2 | 10047 | **Fonendoscopio** | 2 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.TM | 10047 | **Fonendoscopio** | 3 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.TP | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.U | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.3 | 10047 | **Fonendoscopio** | 5 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.7.9 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.2 | 10047 | **Fonendoscopio** | 3 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.3 | 10047 | **Fonendoscopio** | 6 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.4 | 10047 | **Fonendoscopio** | 2 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.5 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 20:00 Hrs. | | |
| Muy Critica | C.2.28.9.2/30.1.5 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.11.8 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.3.29.3.1 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.3.5.3.1 | 10047 | **Fonendoscopio** | 2 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | G.42.3.1 | 10047 | **Fonendoscopio** | 4 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | G.42.3.8 | 10047 | **Fonendoscopio** | 2 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.21.1.11 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.21.1.3 | 10047 | **Fonendoscopio** | 3 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.21.1.4 | 10047 | **Fonendoscopio** | 2 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.21.1.5 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.21.1.6 | 10047 | **Fonendoscopio** | 2 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.1.3.1 | 10047 | **Fonendoscopio** | 2 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.23.2.7 | 10047 | **Fonendoscopio** | 5 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.2.5 | 10047 | **Fonendoscopio** | 3 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.3.1 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.3.2 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.3.3 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.4.1 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.4.2 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.4.3 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | B.26.6 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.9.1 | 10047 | **Fonendoscopio** | 16 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.2.4.1 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.22.3.1 | 10047 | **Fonendoscopio** | 3 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.22.4.1 | 10047 | **Fonendoscopio** | 3 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.1.31.3.1 | 10047 | **Fonendoscopio** | 4 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.1.3.3.1 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | D.2.32.3.1 | 10047 | **Fonendoscopio** | 4 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.3.33.3.1 | 10047 | **Fonendoscopio** | 4 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.4.34.3.1 | 10047 | **Fonendoscopio** | 4 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | D.5.35.3.1 | 10047 | **Fonendoscopio** | 4 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.6.36.3.1 | 10047 | **Fonendoscopio** | 4 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.5.1 | 10047 | **Fonendoscopio** | 6 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.5.2 | 10047 | **Fonendoscopio** | 12 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.2.39.3.1 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.2.39.4.1 | 10047 | **Fonendoscopio** | 6 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.3.40.4.1 | 10047 | **Fonendoscopio** | 6 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.3.40.4.2 | 10047 | **Fonendoscopio** | 11 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.18.2.12 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.4.4 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | B.26.4.4 | 10047 | **Fonendoscopio** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.4.41.3.1 | 10047 | **Fonendoscopio** | 6 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.4.41.4.2 | 10047 | **Fonendoscopio** | 3 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.2 | 10048 | **Foroptero** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.14.2.7 | 10049 | **Impedanciometro De ORL** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.2.10.2 | 10050 | **Juego De Diapasones** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Muy Critica | H.1.43.2.7 | 10051 | **Lampara Examen** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.06.2.2 | 10051 | **Lampara Examen** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.24.1.8 | 10051 | **Lampara Examen** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.11 | 10051 | **Lampara Examen** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.1.2.1 | 10051 | **Lampara Examen** | 3 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.1.2.5 | 10051 | **Lampara Examen** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.1.2.6 | 10051 | **Lampara Examen** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.17.2.6 | 10051 | **Lampara Examen** | 7 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.2.6.2 | 10051 | **Lampara examen** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.15.2.4 | 10051 | **Lampara examen** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.08.2.10 | 10051 | **Lampara Examen** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.5 | 10051 | **Lampara examen** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.10 | 10051 | **Lampara Examen** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.11.2.6 | 10051 | **Lampara Examen** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.8 | 10051 | **Lampara Examen** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.7.1 | 10051 | **Lampara Examen** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.3.29.3.3 | 10051 | **Lampara Examen** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.1.3.3.5 | 10051 | **Lampara examen** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.3.5.3.5 | 10051 | **Lampara Examen** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las | 1 dia | Edificio N°2 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24:00 Hrs. | | |
| Menos Critica | A.16.2.7 | 10051 | **Lampara Examen** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.6 | 10051 | **Lampara Examen** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.7 | 10051 | **Lampara Examen** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.3.1 | 10051 | **Lampara Examen** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.3.2 | 10051 | **Lampara Examen** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.3.3 | 10051 | **Lampara Examen** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.4.1 | 10051 | **Lampara Examen** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.4.2 | 10051 | **Lampara Examen** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.4.3 | 10051 | **Lampara Examen** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.5.49.3.6 | 10051 | **Lampara Examen** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 00:00 y las 24:00 Hrs. | | |
| Muy Critica | A.22.3.1 | 10051 | **Lampara Examen** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.6.36.3.5 | 10051 | **Lampara Examen** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.4.35.3.5 | 10051 | **Lampara Examen** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.4.34.3.5 | 10051 | **Lampara Examen** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.3.33.3.5 | 10051 | **Lampara Examen** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | G.42.3.5 | 10051 | **Lampara Examen** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.1.32.3.5 | 10051 | **Lampara Examen** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.1.31.3.5 | 10051 | **Lampara Examen** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.12.2.1 | 10051 | **Lampara Examen** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.12.2.4 | 10051 | **Lampara Examen** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 20:00 Hrs. | | |
| Menos Critica | A.18.2.12 | 10051 | **Lampara Examen** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.18.2.10 | 10051 | **Lampara Examen** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.2.10.7 | 10051 | **Lampara Examen** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Muy Critica | E.37.2.4.1 | 10051 | **Lampara Examen** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | H.2.44.4.5 | 10051 | **Lampara Examen** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.1.3.5 | 10051 | **Lampara Examen** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.4.4 | 10051 | **Lampara Examen** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.4.4 | 10051 | **Lampara Examen** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.4.5 | 10051 | **Lampara Examen** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.9.1 | 10051 | **Lampara Examen** | 16 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.2 | 10052 | **Lampara Hendidura** | 7 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | B.26.12.2.6 | 10052 | **Lampara Hendidura** | 4 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.10 | 10052 | **Lampara Hendidura** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.7 | 10052 | **Lampara Hendidura** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.9 | 10054 | **Lampara Hendidura C/Sistema De Video** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.5 | 10054 | **Lampara Hendidura C/Sistema De Video** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.6 | 10054 | **Lampara Hendidura C/Sistema De Video** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.8 | 10054 | **Lampara Hendidura C/Sistema De Video** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.4.2 | 10054 | **Lampara Hendidura C/Sistema De Video** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.12.2.5 | 10054 | **Lampara Hendidura C/Sistema De Video** | 4 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.3 | 10054 | **Lampara Hendidura C/Sistema de Video** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.6.1 | 10055 | **Laringoscopio Con Set De Transiluminacion** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.2 | 10057 | **Lente De Tres Espejos Goldman** | 7 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.13.3.5 | 10057 | **Lente De Tres Espejos Goldman** | 2 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.6 | 10057 | **Lente De Tres Espejos Goldman** | 2 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.8 | 10057 | **Lente De Tres Espejos Goldman** | 2 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.9 | 10057 | **Lente De Tres Espejos Goldman** | 2 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.4.2 | 10057 | **Lente De Tres Espejos Goldman** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.7 | 10057 | **Lente De Tres Espejos Goldman** | 2 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.4.6 | 10058 | **Lentes Estriados De Bagolini** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.2.5.5 | 10059 | **Linterna** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Muy Critica | F.1.38.4.5 | 10060 | **Localizador Estimulador De Nervio Periferico** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.2.39.3.5 | 10060 | **Localizador Estimulador De Nervio Periferico** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.11.2.6 | 10060 | **Localizador Estimulador De Nervio Periferico** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2 | 10060 | **Localizador Estimulador De Nervio Periferico** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.2 | 10060 | **Localizador Estimulador De Nervio Periferico** | 3 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 20:00 Hrs. | | |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.TM | 10060 | **Localizador Estimulador De Nervio Periferico** | 3 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.TP | 10060 | **Localizador Estimulador De Nervio Periferico** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.U | 10060 | **Localizador Estimulador De Nervio Periferico** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.3 | 10060 | **Localizador Estimulador De Nervio Periferico** | 3 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.3 | 10060 | **Localizador Estimulador De Nervio Periferico** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.3 | 10060 | **Localizador Estimulador De Nervio Periferico** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.2.5 | 10061 | **Lupa C/Sistema De Iluminacion (Frontal)** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.2.6 | 10062 | **Lupa Dermatologica** | 7 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.3.1 | 10062 | **Lupa Dermatologica** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.5.1 | 10063 | **Medidor Cuff** | 6 | 6 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24:00 Hrs. | | |
| Muy Critica | F.1.38.5.2 | 10063 | **Medidor Cuff** | 2 | 6 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.2.39.4.1 | 10063 | **Medidor Cuff** | 6 | 6 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.2.39.4.2 | 10063 | **Medidor Cuff** | 2 | 6 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.3.40.4.1 | 10063 | **Medidor Cuff** | 6 | 6 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.3.40.4.2 | 10063 | **Medidor Cuff** | 2 | 6 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.4.41.4.1 | 10063 | **Medidor Cuff** | 6 | 6 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.4.41.4.2 | 10063 | **Medidor Cuff** | 3 | 6 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.1.2.4 | 10064 | **Medidor De Alturas Antropometricas** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.7.3 | 10064 | **Medidor De Alturas Antropometricas** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.14.2.12 | 10065 | **Microscopio Otorrino Movil** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.14.2.5 | 10067 | **Microscopio Otorrino Mural** | 6 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.7 | 10070 | **Negatoscopio 2 Caras** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.3 | 10070 | **Negatoscopio 2 Caras** | 4 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.1.3.7 | 10070 | **Negatoscopio 2 Caras** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.4.7 | 10070 | **Negatoscopio 2 Caras** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.3.40.3.7 | 10070 | **Negatoscopio 2 Caras** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.15 | 10070 | **Negatoscopio 2 Caras** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.21.1.3 | 10070 | **Negatoscopio 2 Caras** | 5 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.2.39.3.7 | 10070 | **Negatoscopio 2 Caras** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.3.5.3.1 | 10070 | **Negatoscopio 2 Caras** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.13.3.8 | 10071 | **Negatoscopio 3 Caras** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.13.3.9 | 10071 | **Negatoscopio 3 Caras** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.14.1.6 | 10071 | **Negatoscopio 3 Caras** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.2.5 | 10071 | **Negatoscopio 3 Caras** | 3 | 15 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | H.1.43.3.7 | 10071 | **Negatoscopio 3 Caras** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.3.47.4.4 | 10071 | **Negatoscopio 3 Caras** | 2 | 15 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.10 | 10071 | **Negatoscopio 3 Caras** | 2 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | C.1.6.1.11 | 10071 | **Negatoscopio 3 Caras** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.1.1.5 | 10071 | **Negatoscopio 3 caras** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.3.3 | 10071 | **Negatoscopio 3 caras** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.4.2 | 10071 | **Negatoscopio 3 caras** | 2 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.1.3.3.7 | 10071 | **Negatoscopio 3 caras** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.2.4.3.7 | 10071 | **Negatoscopio 3 caras** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las | 3 dias | Edificio N°2 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24:00 Hrs. | | |
| Menos Critica | C.1.6.2.2 | 10071 | **Negatoscopio 3 caras** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.3 | 10071 | **Negatoscopio 3 caras** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.12.2.1 | 10073 | **Negatoscopio Dental** | 3 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.12 | 10073 | **Negatoscopio Dental** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.13.4 | 10073 | **Negatoscopio Dental** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.13.5 | 10073 | **Negatoscopio Dental** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.13.6 | 10073 | **Negatoscopio Dental** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.2 | 10073 | **Negatoscopio Dental** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.3 | 10073 | **Negatoscopio Dental** | 6 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.4 | 10073 | **Negatoscopio Dental** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.5 | 10073 | **Negatoscopio Dental** | 3 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.6 | 10073 | **Negatoscopio Dental** | 3 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.13.3.10 | 10074 | **Oftalmoscopio Binocular Indirecto** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.2 | 10074 | **Oftalmoscopio Binocular Indirecto** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.5 | 10074 | **Oftalmoscopio Binocular Indirecto** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.6 | 10074 | **Oftalmoscopio Binocular Indirecto** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.7 | 10074 | **Oftalmoscopio Binocular Indirecto** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.7 | 10074 | **Oftalmoscopio Binocular Indirecto** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.8 | 10074 | **Oftalmoscopio Binocular Indirecto** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.9 | 10074 | **Oftalmoscopio Binocular Indirecto** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.4.5 | 10074 | **Oftalmoscopio Binocular Indirecto** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.12.2.6 | 10074 | **Oftalmoscopio Binocular Indirecto** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.3 | 10074 | **Oftalmoscopio Binocular indirecto** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.7 | 10075 | **Oftalmoscopio Binocular Indirecto C/Sistema De Video** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | B.26.12.2.6 | 10075 | **Oftalmoscopio Binocular Indirecto C/Sistema De Video** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.9 | 10075 | **Oftalmoscopio Binocular Indirecto C/Sistema De Video** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.2 | 10076 | **Oftalmoscopio Directo Con Retinoscopio** | 7 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.5 | 10076 | **Oftalmoscopio Directo Con Retinoscopio** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.6 | 10076 | **Oftalmoscopio Directo Con Retinoscopio** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.12.2.5 | 10076 | **Oftalmoscopio Directo Con Retinoscopio** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.7 | 10076 | **Oftalmoscopio Directo Con Retinoscopio** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.4.4 | 10077 | **Oftalmoscopio Directo Mural** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.12.2.1 | 10077 | **Oftalmoscopio Directo Mural** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.10 | 10077 | **Oftalmoscopio Directo Mural** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.9 | 10077 | **Oftalmoscopio Directo Mural** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.4.1 | 10077 | **Oftalmoscopio Directo Mural** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.13.4.3 | 10077 | **Oftalmoscopio Directo Mural** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.4.6 | 10077 | **Oftalmoscopio Directo Mural** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.4.4 | 10077 | **Oftalmoscopio Directo Mural** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.2.5 | 10077 | **Oftalmoscopio Directo Mural** | 3 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.3.1 | 10077 | **Oftalmoscopio Directo Mural** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.3.2 | 10077 | **Oftalmoscopio Directo Mural** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.3.3 | 10077 | **Oftalmoscopio Directo Mural** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.4.1 | 10077 | **Oftalmoscopio Directo Mural** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.4.2 | 10077 | **Oftalmoscopio Directo Mural** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.4.3 | 10077 | **Oftalmoscopio Directo Mural** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.9.1 | 10077 | **Oftalmoscopio Directo Mural** | 16 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.03.2.1 | 10078 | **Oftalmoscopio Directo Portatil** | 3 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.4.5 | 10078 | **Oftalmoscopio Directo Portatil** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.04.2.1 | 10078 | **Oftalmoscopio Directo Portatil** | 3 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.22.3.1 | 10079 | **Otooftalmoscopio Portatil** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.22.4.1 | 10079 | **Otooftalmoscopio Portatil** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.2.5 | 10079 | **Otooftalmoscopio Portatil** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.1.31.3.1 | 10079 | **Otooftalmoscopio Portatil** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.2.32.3.1 | 10079 | **Otooftalmoscopio Portatil** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.3.33.3.1 | 10079 | **Otooftalmoscopio Portatil** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.4.34.3.1 | 10079 | **Otooftalmoscopio Portatil** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.5.35.3.1 | 10079 | **Otooftalmoscopio Portatil** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.6.36.3.1 | 10079 | **Otooftalmoscopio Portatil** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.1.3.1 | 10079 | **Otooftalmoscopio Portatil** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 00:00 y las 24:00 Hrs. | | |
| Muy Critica | E.37.2.4.1 | 10079 | **Otooftalmoscopio Portatil** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.4.1 | 10079 | **Otooftalmoscopio Portatil** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.2.39.3.2 | 10079 | **Otooftalmoscopio Portatil** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.3.40.3.1 | 10079 | **Otooftalmoscopio Portatil** | 4 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | G.42.3.1 | 10079 | **Otooftalmoscopio Portatil** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.07.2.1 | 10079 | **Otooftalmoscopio Portatil** | 3 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.07.2.2 | 10079 | **Otooftalmoscopio Portatil** | 4 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.18.2.5 | 10079 | **Otooftalmoscopio Portatil** | 3 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.18.2.6 | 10079 | **Otooftalmoscopio Portatil** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.19.2.17 | 10079 | **Otooftalmoscopio Portatil** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.19.2.3 | 10079 | **Otooftalmoscopio Portatil** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 20:00 Hrs. | | |
| Menos Critica | A.21.1.11 | 10079 | **Otooftalmoscopio Portatil** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.21.1.3 | 10079 | **Otooftalmoscopio Portatil** | 5 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.21.1.6 | 10079 | **Otooftalmoscopio Portatil** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.7.1 | 10079 | **Otooftalmoscopio Portatil** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.3.29.3.3 | 10079 | **Otooftalmoscopio Portatil** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | H.2.44.3.6 | 10079 | **Otooftalmoscopio Portatil** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.1.2.1 | 10079 | **Otooftalmoscopio Portatil** | 3 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.5.2 | 10079 | **Otooftalmoscopio Portatil** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.4.3 | 10079 | **Otooftalmoscopio Portatil** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.1.3.3.2 | 10079 | **Otooftalmoscopio Portatil** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.3.5.3.2 | 10079 | **Otooftalmoscopio Portatil** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Critica | F.4.41.3.1 | 10079 | **Otooftalmoscopio Portatil** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.14.2.5 | 10080 | **Otoscopio Mural** | 5 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.4.4 | 10080 | **Otoscopio Mural** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.2.5 | 10080 | **Otoscopio Mural** | 3 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.3.1 | 10080 | **Otoscopio Mural** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.3.2 | 10080 | **Otoscopio Mural** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.3.3 | 10080 | **Otoscopio Mural** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.4.1 | 10080 | **Otoscopio Mural** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.4.2 | 10080 | **Otoscopio Mural** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.4.3 | 10080 | **Otoscopio Mural** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.9.1 | 10080 | **Otoscopio Mural** | 16 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.2.5.3 | 10081 | **Otoscopio Portatil** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.5.5 | 10081 | **Otoscopio Portatil** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y | 3 dias | Edificio N°2 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 20:00 Hrs. | | |
| Critica | A.2.2.2 | 10081 | **Otoscopio Portatil** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.7 | 10081 | **Otoscopio Portatil** | 3 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.15.2.12_B | 10083 | **Pimometro** | 1 | 3 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.7 | 10083 | **Pimometro** | 1 | 3 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.4.2 | 10083 | **Pimometro** | 1 | 3 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.2.39.3.2 | 10083 | **Pimometro** | 4 | 3 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.4.41.3.1 | 10083 | **Pimometro** | 2 | 3 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | A.2.10.2 | 10084 | **Podoscopio** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.10.5 | 10084 | **Podoscopio** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.15.2.3 | 10084 | **Podoscopio** | 4 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.5 | 10084 | **Podoscopio** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | C.1.6.2.1 | 10084 | **Podoscopio** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.13.3.10 | 10085 | **Proyector De Optotipos** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.2 | 10085 | **Proyector De Optotipos** | 7 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.5 | 10085 | **Proyector De Optotipos** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.7 | 10085 | **Proyector De Optotipos** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.9 | 10085 | **Proyector De Optotipos** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.4.2 | 10085 | **Proyector De Optotipos** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.4.6 | 10085 | **Proyector De Optotipos** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.12.2.1 | 10085 | **Proyector De Optotipos** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.12.2.5 | 10085 | **Proyector De Optotipos** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.12.2.6 | 10085 | **Proyector De Optotipos** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.2 | 10086 | **Prueba Colores Ishihara 24 Platos** | 3 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.13.3.6 | 10086 | **Prueba Colores Ishihara 24 Platos** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.4.6 | 10086 | **Prueba Colores Ishihara 24 Platos** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.2 | 10087 | **Prueba Estereopsis (Titmus Test)** | 3 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.6 | 10087 | **Prueba Estereopsis (Titmus Test)** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.9 | 10087 | **Prueba Estereopsis (Titmus Test)** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.4.6 | 10087 | **Prueba Estereopsis (Titmus Test)** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.14.2.10 | 10088 | **Rinomanometro** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.2 | 10089 | **Set Lupas Examen** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.10 | 10090 | **Set Lupas Examen Baja Vision** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.10 | 10091 | **Set Prismas** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.4.6 | 10091 | **Set Prismas** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.14.2.13 | 10092 | **Sistema De Posturografia Dinamica** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.2.10.5 | 10092 | **Sistema De Posturografia Dinamica** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.13.4.3 | 10095 | **Sistema Fotografia Polo Posterior** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.09.2.8 | 10096 | **Sistema Holter ECG Y Presion Arterial** | 2 | 6 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.09.2.7 | 10098 | **Sistema Para Test De Esfuerzo** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.11.2.2 | 10099 | **Softwares Para Neuropsicologia** | 2 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.4.6 | 10100 | **Test De Worth** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.11.2.2 | 10101 | **Test Inteligencia WAIS IV** | 2 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.4.2 | 10102 | **Tomografo De Coherencia optica** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.12.2.2 | 10102 | **Tomografo De Coherencia optica** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.4.3 | 10102 | **Tomografo De Coherencia optica** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.4.2 | 10104 | **Tonometro Aplanatico Perkins** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.12.2.1 | 10104 | **Tonometro Aplanatico Perkins** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.12.2.5 | 10104 | **Tonometro Aplanatico Perkins** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Critica | C.2.28.10.3 | 10104 | **Tonometro Aplanatico Perkins** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.1 | 10105 | **Tonometro Neumatico** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.3 | 10105 | **Tonometro Neumatico** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.12.2.2 | 10105 | **Tonometro Neumatico** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.14.2.8_A | 10108 | **Unidad Diagnostico Y Terapia Alteraciones De La Deglución** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.14.2.8 | 10109 | **Unidad Diagnostico Y Terapia Alteraciones Del Habla** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.5 | 10110 | **Uroflujometro** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.4.6 | 10111 | **Varilla De Maddox** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.4.2 | 10112 | **Ventilometro de Wright** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.2.39.3.2 | 10112 | **Ventilometro de Wright** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.3.40.3.2 | 10112 | **Ventilometro de Wright** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Critica | F.4.41.3.1 | 10112 | **Ventilometro de Wright** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.4.41.3.1 | 10112 | **Ventilometro de Wright** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| N/A | D.6.36.4.5_A | 10113 | **Videoencefalografo C/Somnografia C/ EEG 62 Canales** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.14.2.6 | 10114 | **Videonistagmografo** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.14.2.12 | 10116 | **Videootoscopio** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.14.2.5 | 10116 | **Videootoscopio** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.09.2.8 | 10118 | **Loop ECG** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.4.41.3.5 | 10119 | **Equipo Doppler Transcraneal** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.4 | 10128 | **Monitor nervio facial** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.19.2.4 | 10133 | **Balanza Silla de Ruedas** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.7 | 10134 | **Espirómetro** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.14.2.6 | 10135 | **VHIT** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.4.1 | 10137 | **Topografo Corneal** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.4.1 | 10137 | **Topografo Corneal** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2 | 20002 | **Carro de intubacion dificil** | 2 | 5 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.2 | 20002 | **Carro de intubacion dificil** | 1 | 5 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.4.2 | 20002 | **Carro de intubacion dificil** | 1 | 5 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.TM | 20003 | **Torre De Artroscopia** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.3 | 20003 | **Torre De Artroscopia** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.08.2.5 | 20004 | **Torre De Video Endoscopia Digestiva** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.08.2.6 | 20004 | **Torre De Video Endoscopia Digestiva** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.08.2.7 | 20004 | **Torre De Video Endoscopia Digestiva** | 3 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.14.2.9 | 20007 | **Torre De Video Endoscopia Otorrino** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.5 | 20008 | **Torre De Video Endoscopia Urologica** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.2 | 20009 | **Torre De Video Endosonografia/Endoscopica** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2 | 20010 | **Torre De Video Laparoscopica** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.2 | 20010 | **Torre De Video Laparoscopica** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.4 | 20010 | **Torre De Video Laparoscopica** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.3 | 20010 | **Torre De Video Laparoscopica** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.3 | 20010 | **Torre De Video Laparoscopica** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.3 | 20010 | **Torre De Video Laparoscopica** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.TM | 20010 | **Torre De Video Laparoscopica** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.TP | 20010 | **Torre De Video Laparoscopica** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.U | 20010 | **Torre De Video Laparoscopica** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 20:00 Hrs. | | |
| Muy Critica | C.2.28.10.2 | 20010 | **Torre De Video Laparoscopica** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.3 | 20010 | **Torre De Video Laparoscopica** | 5 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2 | 20011 | **Torre De Video Laparoscopica/Endoscopica** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.2 | 20011 | **Torre De Video Laparoscopica/Endoscopica** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.14.2.10 | 20013 | **Video Estroboscopio** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.7 | 20014 | **Torre De VideoCistocopia** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.4 | 20015 | **Rinovideolaringoscopio** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.4.5 | 20016 | **Fibrobroncoscopio** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.2.39.3.5 | 20016 | **Fibrobroncoscopio** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | H.1.43.3.10 | 30001 | **Lavadora De Chatas** | 2 | 15 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Critica | A.19.2.7 | 30001 | **Lavadora De Chatas** | 1 | 15 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.7.6 | 30001 | **Lavadora De Chatas** | 1 | 15 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.3.29.3.7 | 30001 | **Lavadora De Chatas** | 1 | 15 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.1.3.3.11 | 30001 | **Lavadora De Chatas** | 2 | 15 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.3.5.3.10 | 30001 | **Lavadora De Chatas** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Muy Critica | E.37.1.3.11 | 30001 | **Lavadora De Chatas** | 1 | 15 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.2.3.3 | 30001 | **Lavadora De Chatas** | 1 | 15 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | G.42.3.11 | 30001 | **Lavadora De Chatas** | 2 | 15 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.1.31.3.11 | 30001 | **Lavadora De Chatas** | 2 | 15 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.2.32.3.11 | 30001 | **Lavadora De Chatas** | 2 | 15 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.3.33.3.11 | 30001 | **Lavadora De Chatas** | 2 | 15 | 97% | Lunes a Domingo entre | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 00:00 y las 24:00 Hrs. | | |
| Critica | D.4.34.3.11 | 30001 | **Lavadora De Chatas** | 2 | 15 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.5.35.3.11 | 30001 | **Lavadora De Chatas** | 2 | 15 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.6.36.3.11 | 30001 | **Lavadora De Chatas** | 2 | 15 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.6.5 | 30002 | **Maceradora De Chatas** | 2 | 15 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.4.10 | 30002 | **Maceradora De Chatas** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.2.39.3.10 | 30002 | **Maceradora De Chatas** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.3.40.3.10 | 30002 | **Maceradora De Chatas** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.4.41.3.10 | 30002 | **Maceradora De Chatas** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | I.2.46.3.3_C | 30003 | **Microondas** | 1 | 6 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.2.5.5 | 30004 | **Termolaminadora** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y | 3 dias | Edificio N°2 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 20:00 Hrs. | | |
| Menos Critica | C.1.6.2.7 | 30004 | **Termolaminadora** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2 | 40001 | **Aspirador Ultrasonico** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.2 | 40001 | **Aspirador Ultrasonico** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.2.5 | 40003 | **Bomba Aspiracion Quirurgica** | 3 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.2 | 40003 | **Bomba Aspiracion Quirurgica** | 3 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.4 | 40003 | **Bomba Aspiracion Quirurgica** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2 | 40003 | **Bomba Aspiracion Quirurgica** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.TM | 40003 | **Bomba Aspiracion Quirurgica** | 3 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.TP | 40003 | **Bomba Aspiracion Quirurgica** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.U | 40003 | **Bomba Aspiracion Quirurgica** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Critica | C.1.27.6.3 | 40003 | **Bomba Aspiracion Quirurgica** | 4 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.3 | 40003 | **Bomba Aspiracion Quirurgica** | 6 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.5 | 40003 | **Bomba Aspiracion Quirurgica** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.3 | 40003 | **Bomba Aspiracion Quirurgica** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.08.2.5 | 40004 | **Bomba Aspiracion Universal** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.12 | 40004 | **Bomba Aspiracion Universal** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.9.1 | 40004 | **Bomba Aspiracion Universal** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | G.42.3.5 | 40004 | **Bomba Aspiracion Universal** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.3.6 | 40004 | **Bomba Aspiracion Universal** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.08.2.6 | 40004 | **Bomba Aspiracion Universal** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.08.2.7 | 40004 | **Bomba Aspiracion Universal** | 3 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.08.2.8 | 40004 | **Bomba Aspiracion Universal** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 20:00 Hrs. | | |
| Critica | A.10.2.8 | 40004 | **Bomba Aspiracion Universal** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.4.5 | 40004 | **Bomba Aspiracion Universal** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.2.39.3.5 | 40004 | **Bomba Aspiracion Universal** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.1.31.3.5 | 40004 | **Bomba Aspiracion Universal** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.2.32.3.5 | 40004 | **Bomba Aspiracion Universal** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.3.33.3.5 | 40004 | **Bomba Aspiracion Universal** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.4.34.3.5 | 40004 | **Bomba Aspiracion Universal** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.5.35.3.5 | 40004 | **Bomba Aspiracion Universal** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.6.36.3.5 | 40004 | **Bomba Aspiracion Universal** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.1.3.3.5 | 40004 | **Bomba Aspiracion Universal** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre | 3 dias | Edificio N°2 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 00:00 y las 24:00 Hrs. | | |
| Critica | B.3.5.3.5 | 40004 | **Bomba Aspiracion Universal** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 08:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Muy Critica | C.1.27.6.3 | 40005 | **Bomba irrigacion de pulsos** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.3 | 40006 | **Ciclodiodo transescleral con sondas** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.3 | 40007 | **Columna Pabellon I** | 6 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.5 | 40007 | **Columna Pabellon I** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.2.5 | 40008 | **Columna De Reanimacion** | 3 | 15 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2 | 40009 | **Columna Pabellon II** | 2 | 15 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.TM | 40009 | **Columna Pabellon II** | 2 | 15 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.U | 40009 | **Columna Pabellon II** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.3 | 40009 | **Columna Pabellon II** | 5 | 15 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.2 | 40009 | **Columna Pabellon II** | 3 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 20:00 Hrs. | | |
| Muy Critica | C.2.28.10.4 | 40009 | **Columna Pabellon II** | 2 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.4.30.2 | 40009 | **Columna Pabellon II** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.4.30.3 | 40009 | **Columna Pabellon II** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.5.1 | 40010 | **Columna Porta Equipos Para UCI** | 6 | 15 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.2.39.4.1 | 40010 | **Columna Porta Equipos Para UCI** | 6 | 15 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.3.40.4.1 | 40010 | **Columna Porta Equipos Para UCI** | 6 | 15 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.4.41.4.1 | 40010 | **Columna Porta Equipos Para UCI** | 6 | 15 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.13.4 | 40013 | **Electrobisturi Baja Potencia** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.13.5 | 40013 | **Electrobisturi Baja Potencia** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.13.6 | 40013 | **Electrobisturi Baja Potencia** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.8 | 40013 | **Electrobisturi Baja Potencia** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24:00 Hrs. | | |
| Menos Critica | A.17.2.9 | 40013 | **Electrobisturi Baja Potencia** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2 | 40014 | **Electrobisturi Disector Ultrasonico** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2 | 40014 | **Electrobisturi Disector Ultrasonico** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.2 | 40014 | **Electrobisturi Disector Ultrasonico** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.3 | 40014 | **Electrobisturi Disector ultrasonico** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.4.30.2 | 40015 | **Equipo De Electroterapia Por Radiofrecuencia** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.4.30.3 | 40015 | **Equipo De Electroterapia Por Radiofrecuencia** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.3.1 | 40016 | **Equipo Nitrogeno** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2 | 40017 | **Equipo Transfusion Rapida** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.2 | 40017 | **Equipo Transfusion Rapida** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2 | 40018 | **Esternotomo Electrico** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24:00 Hrs. | | |
| Muy Critica | C.2.28.10.3 | 40019 | **Facoemulsificador C/Vitrector Anterior** | 4 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.5.2 | 40021 | **Fotocoagulador Laser (Verde)** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.5.4 | 40022 | **Fotodisruptor Laser Nd-Yag** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.5 | 40023 | **Laser Holmium 150 W** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.2.5 | 40024 | **Lampara Procedimiento Rodable** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.2.7 | 40024 | **Lampara Procedimiento Rodable** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.2.8 | 40024 | **Lampara Procedimiento Rodable** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.2.9 | 40024 | **Lampara Procedimiento Rodable** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.3.1 | 40024 | **Lampara Procedimiento Rodable** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.3.3 | 40024 | **Lampara Procedimiento Rodable** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.19.2.18 | 40024 | **Lampara Procedimiento Rodable** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.19.2.19 | 40024 | **Lampara Procedimiento Rodable** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | H.2.44.3.6 | 40024 | **Lampara Procedimiento Rodable** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.2.2.3 | 40024 | **Lampara Procedimiento Rodable** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.3.3 | 40024 | **Lampara Procedimiento Rodable** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.5.4 | 40024 | **Lampara Procedimiento Rodable** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.8.2 | 40024 | **Lampara Procedimiento Rodable** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.9.2 | 40024 | **Lampara Procedimiento Rodable** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.9.3 | 40024 | **Lampara Procedimiento Rodable** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.9.4 | 40024 | **Lampara Procedimiento Rodable** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.9.5 | 40024 | **Lampara Procedimiento Rodable** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | I.3.47.4.2 | 40024 | **Lampara Procedimiento Rodable** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.3.47.4.3 | 40024 | **Lampara Procedimiento Rodable** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.3.47.7.1 | 40024 | **Lampara Procedimiento Rodable** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.03.2.5 | 40024 | **Lampara Procedimiento Rodable** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 20:00 Hrs. | | |
| Critica | A.05.2.2 | 40024 | **Lampara Procedimiento Rodable** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.06.2.3 | 40024 | **Lampara Procedimiento Rodable** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.6 | 40024 | **Lampara Procedimiento Rodable** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.8 | 40024 | **Lampara Procedimiento Rodable** | 3 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.9 | 40024 | **Lampara Procedimiento Rodable** | 3 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.5.3 | 40024 | **Lampara Procedimiento Rodable** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.14.2.12 | 40024 | **Lampara Procedimiento Rodable** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.1.3.3.8 | 40024 | **Lampara Procedimiento Rodable** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.21.1.5 | 40024 | **Lampara Procedimiento Rodable** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.1.3.8 | 40024 | **Lampara Procedimiento Rodable** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.23.2.7/A.23.2.8/A.23.2.9 | 40024 | **Lampara Procedimiento Rodable** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | B.26.8 | 40024 | **Lampara Procedimiento Rodable** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.2.5 | 40024 | **Lampara Procedimiento Rodable** | 3 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.22.2.6 | 40024 | **Lampara Procedimiento Rodable** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | G.42.3.8 | 40024 | **Lampara Procedimiento Rodable** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.4.5 | 40024 | **Lampara Procedimiento Rodable** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.2.39.3.5 | 40024 | **Lampara Procedimiento Rodable** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.3.40.3.5 | 40024 | **Lampara Procedimiento Rodable** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.1.31.3.8 | 40024 | **Lampara Procedimiento Rodable** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.2.32.3.8 | 40024 | **Lampara Procedimiento Rodable** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.3.33.3.8 | 40024 | **Lampara Procedimiento Rodable** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | D.4.34.3.8 | 40024 | **Lampara Procedimiento Rodable** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.5.35.3.8 | 40024 | **Lampara Procedimiento Rodable** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.6.36.3.8 | 40024 | **Lampara Procedimiento Rodable** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.18.2.11 | 40024 | **Lampara Procedimiento Rodable** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | I.4.48.5.2 | 40024 | **Lampara Procedimiento Rodable** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | I.4.48.5.2.a | 40024 | **Lampara Procedimiento Rodable** | 3 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | I.4.48.5.5 | 40024 | **Lampara Procedimiento Rodable** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.4.41.3.5 | 40024 | **Lampara Procedimiento Rodable** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.11.2.4 | 40024 | **Lampara Procedimiento Rodable** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.5 | 40025 | **Morcelador** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.3 | 40026 | **Lampara Quirurgica I** | 6 | 12 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Critica | C.4.30.2 | 40026 | **Lampara Quirurgica I** | 1 | 12 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.4.30.3 | 40026 | **Lampara Quirurgica I** | 1 | 12 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2 | 40027 | **Lampara Quirurgica II** | 2 | 12 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.TM | 40027 | **Lampara Quirurgica II** | 2 | 12 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.U | 40027 | **Lampara Quirurgica II** | 1 | 12 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.3 | 40027 | **Lampara Quirurgica II** | 5 | 12 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.2 | 40027 | **Lampara Quirurgica II** | 3 | 12 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.4 | 40027 | **Lampara Quirurgica II** | 2 | 12 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.5 | 40027 | **Lampara Quirurgica II** | 1 | 12 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.8.1 | 40028 | **Lampara Quirurgica Rodable** | 1 | 12 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.5 | 40028 | **Lampara Quirurgica Rodable** | 1 | 12 | 97% | Lunes a Domingo entre | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 00:00 y las 24:00 Hrs. | | |
| Menos Critica | A.17.3.1 | 40029 | **Laser CO2 Dermatologia** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.4 | 40030 | **Laser CO2 Otorrinolaringologia** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.5 | 40033 | **Litotriptor Intracorporeo Neumatico** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.8 | 40034 | **Lupa Quirurgica** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2 | 40034 | **Lupa Quirurgica** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.2 | 40034 | **Lupa Quirurgica** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.4 | 40034 | **Lupa Quirurgica** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.TM | 40034 | **Lupa quirurgica** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.3 | 40034 | **Lupa quirurgica** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.2.5 | 40035 | **Mango Isquemia Automatico** | 3 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2 | 40035 | **Mango Isquemia Automatico** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 00:00 y las 24:00 Hrs. | | |
| Muy Critica | C.2.28.10.2 | 40035 | **Mango Isquemia Automatico** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.3 | 40035 | **Mango Isquemia Automatico** | 3 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2 | 40036 | **Maquina Anestesia Alta Complejidad** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.2 | 40036 | **Maquina Anestesia Alta Complejidad** | 3 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.4 | 40036 | **Maquina Anestesia Alta Complejidad** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.TM | 40036 | **Maquina Anestesia Alta Complejidad** | 3 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.TP | 40036 | **Maquina Anestesia Alta Complejidad** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.U | 40036 | **Maquina Anestesia Alta Complejidad** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.3 | 40036 | **Maquina Anestesia Alta Complejidad** | 3 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.3 | 40036 | **Maquina Anestesia Alta Complejidad** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 00:00 y las 24:00 Hrs. | | |
| Muy Critica | C.1.27.6.3 | 40036 | **Maquina Anestesia Alta Complejidad** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.4.30.2 | 40036 | **Maquina Anestesia Alta Complejidad** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.4.30.3 | 40036 | **Maquina Anestesia Alta Complejidad** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.5 | 40037 | **Laser con Resectoscopios** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.5 | 40038 | **Maquina Anestesia Mediana Complejidad** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.3 | 40038 | **Maquina Anestesia Mediana Complejidad** | 6 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.4 | 40038 | **Maquina Anestesia Mediana Complejidad** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.TM | 40039 | **Mesa Quirurgica Traumatologia** | 3 | 15 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.3 | 40039 | **Mesa Quirurgica Traumatologia** | 1 | 15 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2 | 40040 | **Mesa Quirurgica Universal** | 2 | 15 | 95% | Lunes a Domingo entre | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 00:00 y las 24:00 Hrs. | | |
| Muy Critica | C.2.28.10.2 | 40040 | **Mesa Quirurgica Universal** | 3 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.4 | 40040 | **Mesa Quirurgica Universal** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.TP | 40040 | **Mesa Quirurgica Universal** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.U | 40040 | **Mesa Quirurgica Universal** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.3 | 40040 | **Mesa Quirurgica Universal** | 2 | 15 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.3 | 40040 | **Mesa Quirurgica Universal** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.3 | 40040 | **Mesa Quirurgica Universal** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.4 | 40040 | **Mesa Quirurgica Universal** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.5 | 40040 | **Mesa Quirurgica Universal** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2 | 40042 | **Microscopio Quirurgico** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24:00 Hrs. | | |
| Muy Critica | C.2.28.10.3 | 40043 | **Microscopio Quirurgico Oftalmológico** | 5 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.3 | 40043 | **Microscopio Quirurgico Oftalmológico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.4 | 40044 | **Microscopio Quirurgico Otorrino** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.4 | 40044 | **Microscopio Quirurgico Otorrino** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.7 | 40045 | **Motor De Yeso** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.10 | 40045 | **Motor De Yeso** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.TM | 40046 | **Motor Quirurgico Grandes Fragmentos** | 6 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.4 | 40047 | **Motor Quirurgico Otorrino** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.TM | 40048 | **Motor Quirurgico Pequeños Fragmentos** | 6 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.3 | 40049 | **Unidad Criocirugia/Criocauterio** | 5 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2 | 40050 | **Unidad Para Electrocirugia Con Fusion De Tejidos** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Critica | C.2.28.10.2 | 40050 | **Unidad Para Electrocirugia Con Fusion De Tejidos** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.TM | 40050 | **Unidad Para Electrocirugia Con Fusion De Tejidos** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.TP | 40050 | **Unidad Para Electrocirugia Con Fusion De Tejidos** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.U | 40050 | **Unidad Para Electrocirugia Con Fusion De Tejidos** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.3 | 40050 | **Unidad Para Electrocirugia Con Fusion De Tejidos** | 3 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.4.30.2 | 40050 | **Unidad Para Electrocirugia Con Fusion De Tejidos** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.4.30.3 | 40050 | **Unidad Para Electrocirugia Con Fusion De Tejidos** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.3 | 40051 | **Unidad Para Electrocirugia De Alta Potencia** | 5 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.4 | 40051 | **Unidad Para Electrocirugia De Alta Potencia** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.3 | 40051 | **Unidad Para Electrocirugia De Alta Potencia** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Critica | C.2.28.10.4 | 40051 | **Unidad Para Electrocirugia De Alta Potencia** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2 | 40052 | **Unidad Para Electrocirugia De Alta Potencia Con Modulo De Argon** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.2 | 40052 | **Unidad Para Electrocirugia De Alta Potencia Con Modulo De Argon** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.3 | 40052 | **Unidad Para Electrocirugia De Alta Potencia Con Modulo De Argon** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.08.2.5 | 40053 | **Unidad Para Electrocirugia De Argon Plasma Para Endoscopia Digestiva** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2 | 40053 | **Unidad Para Electrocirugia De Argon Plasma Para Endoscopia Digestiva** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.08.2.6 | 40053 | **Unidad Para Electrocirugia De Argon Plasma Para Endoscopia Digestiva** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.08.2.7 | 40054 | **Unidad Para Electrocirugia Para Endoscopia Digestiva** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.5 | 40055 | **Unidad Para Electrocirugia Urologica Endoscopica** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.3 | 40056 | **Vitrector posterior** | 3 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Critica | C.1.27.6.2.TP | 40057 | **sistema integrado de pabellones** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.TM | 40057 | **sistema integrado de pabellones** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.13.5 | 40081 | **Lampara Procedimiento a techo** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.13.6 | 40081 | **Lampara Procedimiento a techo** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.4.5 | 40084 | **Sistema para monitoreo de indica biespectral (BIS)** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.2.39.3.5 | 40084 | **Sistema para monitoreo de indica biespectral (BIS)** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2 | 50001 | **Acelerador Infusion 1000 cc.** | 4 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.TM | 50001 | **Acelerador Infusion 1000 cc.** | 6 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.TP | 50001 | **Acelerador Infusion 1000 cc.** | 4 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.U | 50001 | **Acelerador Infusion 1000 cc.** | 2 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.3 | 50001 | **Acelerador Infusion 1000 cc.** | 2 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 00:00 y las 24:00 Hrs. | | |
| Muy Critica | C.2.28.10.2 | 50001 | **Acelerador Infusion 1000 cc.** | 3 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.3 | 50001 | **Acelerador Infusion 1000 cc.** | 6 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.4 | 50001 | **Acelerador Infusion 1000 cc.** | 4 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.9.2/30.1.5 | 50001 | **Acelerador Infusion 1000 cc.** | 2 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.2.5 | 50001 | **Acelerador Infusion 1000 cc.** | 3 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.5.1 | 50001 | **Acelerador Infusion 1000 cc.** | 2 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.5.2 | 50001 | **Acelerador Infusion 1000 cc.** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.2.39.4.1 | 50001 | **Acelerador Infusion 1000 cc.** | 2 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.2.39.4.2 | 50001 | **Acelerador Infusion 1000 cc.** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.3.40.4.1 | 50001 | **Acelerador Infusion 1000 cc.** | 2 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24:00 Hrs. | | |
| Muy Critica | F.3.40.4.2 | 50001 | **Acelerador Infusion 1000 cc.** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.TM | 50001 | **Acelerador Infusion 1000 cc.** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.3 | 50001 | **Acelerador Infusion 1000 cc.** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.4.41.4.1 | 50001 | **Acelerador Infusion 1000 cc.** | 2 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.4.41.4.2 | 50001 | **Acelerador Infusion 1000 cc.** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.11.8 | 50002 | **Acelerador Infusion 500 cc.** | 2 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.5.1 | 50002 | **Acelerador Infusion 500 cc.** | 4 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.5.2 | 50002 | **Acelerador Infusion 500 cc.** | 5 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.2.39.4.1 | 50002 | **Acelerador Infusion 500 cc.** | 4 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.2.39.4.2 | 50002 | **Acelerador Infusion 500 cc.** | 5 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 00:00 y las 24:00 Hrs. | | |
| Muy Critica | F.3.40.4.1 | 50002 | **Acelerador Infusion 500 cc.** | 4 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.3.40.4.2 | 50002 | **Acelerador Infusion 500 cc.** | 5 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.4.41.4.1 | 50002 | **Acelerador Infusion 500 cc.** | 6 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.4.41.4.2 | 50002 | **Acelerador Infusion 500 cc.** | 3 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.4.5 | 50004 | **Balon Contrapulsacion Aortico** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.4.30.2 | 50004 | **Balon contrapulsacion aortico** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.4.30.3 | 50004 | **Balon contrapulsacion aortico** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.3.4 | 50006 | **Cabina De Puvaterapia** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.2.5 | 50007 | **Calentador De Fluido** | 3 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2 | 50007 | **Calentador De Fluido** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 00:00 y las 24:00 Hrs. | | |
| Muy Critica | C.2.28.10.2 | 50007 | **Calentador De Fluido** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.4 | 50007 | **Calentador De Fluido** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.4.1 | 50007 | **Calentador De Fluido** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.3 | 50007 | **Calentador De Fluido** | 5 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.3 | 50007 | **Calentador De Fluido** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.2.39.3.1 | 50007 | **Calentador De Fluido** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.3.40.3.5 | 50007 | **Calentador De Fluido** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.TM | 50007 | **Calentador De Fluido** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.4.41.4.2 | 50007 | **Calentador De Fluido** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.2.5 | 50008 | **Calentador De Paciente** | 3 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | B.26.8 | 50008 | **Calentador De Paciente** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2 | 50008 | **Calentador De Paciente** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.2 | 50008 | **Calentador De Paciente** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.4 | 50008 | **Calentador De Paciente** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.5 | 50008 | **Calentador De Paciente** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.4.5 | 50008 | **Calentador De Paciente** | 4 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.2.39.3.5 | 50008 | **Calentador De Paciente** | 4 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.3.40.3.5 | 50008 | **Calentador De Paciente** | 4 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.8 | 50008 | **Calentador De Paciente** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.TM | 50008 | **Calentador De Paciente** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.TP | 50008 | **Calentador De Paciente** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24:00 Hrs. | | |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.U | 50008 | **Calentador De Paciente** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.3 | 50008 | **Calentador De Paciente** | 3 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.7.9/C.1.30.1.5 | 50008 | **Calentador De Paciente** | 11 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.3 | 50008 | **Calentador De Paciente** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.23.2.7/A.23.2.8/A.23.2.9 | 50008 | **Calentador De Paciente** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.6 | 50008 | **Calentador De Paciente** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | G.42.3.5 | 50008 | **Calentador De Paciente** | 4 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.1.31.3.5 | 50008 | **Calentador De Paciente** | 4 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.2.32.3.5 | 50008 | **Calentador De Paciente** | 4 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.3.33.3.5 | 50008 | **Calentador De Paciente** | 4 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24:00 Hrs. | | |
| Critica | D.4.34.3.5 | 50008 | **Calentador De Paciente** | 4 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.5.35.3.5 | 50008 | **Calentador De Paciente** | 4 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.6.36.3.5 | 50008 | **Calentador De Paciente** | 4 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.TM | 50008 | **Calentador De Paciente** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.3 | 50008 | **Calentador De Paciente** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.3 | 50008 | **Calentador De Paciente** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.4.41.3.5 | 50008 | **Calentador De Paciente** | 4 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.2.5 | 50012 | **Collar Extricacion Cervical** | 9 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.7 | 50012 | **Collar Extricacion Cervical** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | B.1.3.4.5 | 50013 | **Concentrador De Oxigeno** | 3 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.1.3.4.7 | 50013 | **Concentrador De Oxigeno** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.3.5.4.5 | 50013 | **Concentrador De Oxigeno** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Muy Critica | F.1.38.4.5 | 50014 | **Equipo de Asistencia Respiratoria con Membrana Extracorporea** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.4.5 | 50016 | **Equipo Regulacion Termica** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | H.1.43.3.5 | 50020 | **Equipo Terapia Electroconvulsiva** | 1 | 15 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.3.4 | 50021 | **Equipo Terapia Fotodinamica** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.4.5 | 50022 | **Ferula De Brown** | 3 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.2.39.3.5 | 50022 | **Ferula De Brown** | 3 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.3.40.3.5 | 50022 | **Ferula De Brown** | 3 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Critica | F.4.41.3.5 | 50022 | **Ferula De Brown** | 3 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.4.1 | 50023 | **Gabinete Calentador De Suero** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.7.1_T | 50023 | **Gabinete Calentador De Suero** | 4 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.11_T | 50023 | **Gabinete calentador de suero** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.4.30.2 | 50024 | **Generador De Pulso Bicameral** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.4.5 | 50024 | **Generador De Pulso Bicameral** | 3 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.2.39.3.5 | 50024 | **Generador De Pulso Bicameral** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.3.40.3.5 | 50024 | **Generador De Pulso Bicameral** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.4.30.3 | 50024 | **Generador De Pulso Bicameral** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.4.41.3.5 | 50024 | **Generador De Pulso Bicameral** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24:00 Hrs. | | |
| Muy Critica | C.4.30.2 | 50025 | **Generador De Pulso Unicameral** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.4.5 | 50025 | **Generador De Pulso Unicameral** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.2.39.3.5 | 50025 | **Generador De Pulso Unicameral** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.3.40.3.5 | 50025 | **Generador De Pulso Unicameral** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.4.30.3 | 50025 | **Generador De Pulso Unicameral** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.4.41.3.5 | 50025 | **Generador De Pulso Unicameral** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.5.2 | 50026 | **Humidificador O2 C/ Calefactor** | 8 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.1.4.3 | 50026 | **Humidificador O2 C/ Calefactor** | 3 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.2.5.2 | 50026 | **Humidificador O2 C/ Calefactor** | 6 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | G.42.3.5 | 50026 | **Humidificador O2 C/ Calefactor** | 2 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.1.31.3.5 | 50026 | **Humidificador O2 C/ Calefactor** | 2 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.2.32.3.5 | 50026 | **Humidificador O2 C/ Calefactor** | 2 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.3.33.3.5 | 50026 | **Humidificador O2 C/ Calefactor** | 2 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.4.34.3.5 | 50026 | **Humidificador O2 C/ Calefactor** | 2 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.5.35.3.5 | 50026 | **Humidificador O2 C/ Calefactor** | 2 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.6.36.3.5 | 50026 | **Humidificador O2 C/ Calefactor** | 3 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.5.2 | 50026 | **Humidificador O2 C/ Calefactor** | 6 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.2.39.4.2 | 50026 | **Humidificador O2 C/ Calefactor** | 6 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.3.40.4.2 | 50026 | **Humidificador O2 C/ Calefactor** | 6 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24:00 Hrs. | | |
| Muy Critica | F.4.41.4.2 | 50026 | **Humidificador O2 C/ Calefactor** | 6 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.1.3.3.5 | 50026 | **Humidificador O2 C/ Calefactor** | 4 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.2.4.3.5 | 50026 | **Humidificador O2 C/ Calefactor** | 4 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.3.5.3.5 | 50026 | **Humidificador O2 C/ Calefactor** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.17.3.4 | 50027 | **Lampara De Fototerapia Uva** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.19.2.11 | 50029 | **Maquina Hemodialisis** | 4 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.19.2.12 | 50029 | **Maquina Hemodialisis** | 12 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.19.2.13 | 50029 | **Maquina Hemodialisis** | 8 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.19.4.6 | 50029 | **Maquina Hemodialisis** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.4.5 | 50029 | **Maquina Hemodialisis** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.2.39.3.5 | 50029 | **Maquina Hemodialisis** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | B.26.5.2 | 50031 | **Nebulizador Ultrasonico** | 4 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.5.2 | 50032 | **Set Lentes (Lupas) Para Fotocoagulacion** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.2.5 | 50033 | **Tabla Espinal** | 3 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.7 | 50033 | **Tabla Espinal** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.2.5 | 50035 | **Ventilador De Transporte** | 3 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2 | 50035 | **Ventilador De Transporte** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.2 | 50035 | **Ventilador De Transporte** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.4.5 | 50035 | **Ventilador De Transporte** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.2.39.3.5 | 50035 | **Ventilador De Transporte** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.3.40.3.5 | 50035 | **Ventilador De Transporte** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Critica | C.1.27.6.2.TM | 50035 | **Ventilador De Transporte** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.TP | 50035 | **Ventilador De Transporte** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.3 | 50035 | **Ventilador De Transporte** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.4.41.3.5 | 50035 | **Ventilador De Transporte** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.2.5 | 50036 | **Ventilador Manual** | 3 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.4.5 | 50036 | **Ventilador Manual** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.5.1 | 50036 | **Ventilador Manual** | 6 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.2.39.4.1 | 50036 | **Ventilador Manual** | 6 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.3.40.4.1 | 50036 | **Ventilador Manual** | 6 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.4.41.4.1 | 50036 | **Ventilador Manual** | 6 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24:00 Hrs. | | |
| Muy Critica | F.1.38.5.1 | 50037 | **Ventilador Mecanico No Invasivo** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.5.2 | 50037 | **Ventilador Mecanico No Invasivo** | 12 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.2.39.4.1 | 50037 | **Ventilador Mecanico No Invasivo** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.2.39.4.2 | 50037 | **Ventilador Mecanico No Invasivo** | 12 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.3.40.4.1 | 50037 | **Ventilador Mecanico No Invasivo** | 1 | 8 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.1.31.3.5 | 50037 | **Ventilador Mecanico No Invasivo** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.2.32.3.5 | 50037 | **Ventilador Mecanico No Invasivo** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.3.33.3.5 | 50037 | **Ventilador Mecanico No Invasivo** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.4.34.3.5 | 50037 | **Ventilador Mecanico No Invasivo** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | D.5.35.3.5 | 50037 | **Ventilador Mecanico No Invasivo** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.6.36.3.5 | 50037 | **Ventilador Mecanico No Invasivo** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.1.3.2 | 50037 | **Ventilador Mecanico No Invasivo** | 3 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.2.4.5 | 50037 | **Ventilador Mecanico No Invasivo** | 3 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | G.42.3.5 | 50037 | **Ventilador Mecanico No Invasivo** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.4.41.4.1 | 50037 | **Ventilador Mecanico No Invasivo** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.4.41.4.2 | 50037 | **Ventilador Mecanico No Invasivo** | 3 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.5.1 | 50038 | **Ventilador Volumetrico** | 6 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.2.39.4.1 | 50038 | **Ventilador Volumetrico** | 6 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.3.40.4.1 | 50038 | **Ventilador Volumetrico** | 6 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24:00 Hrs. | | |
| Muy Critica | F.4.41.4.1 | 50038 | **Ventilador Volumetrico** | 6 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2 | 50039 | **Bomba Alto Flujo Y Calentador De Sueros** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.2 | 50039 | **Bomba Alto Flujo Y Calentador De Sueros** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.5.1 | 50043 | **Maquina Hemodiafiltracion** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.2.39.4.1 | 50043 | **Maquina Hemodiafiltracion** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.3.40.4.1 | 50043 | **Maquina Hemodiafiltracion** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.4.41.4.1 | 50043 | **Maquina Hemodiafiltracion** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.9.2.10 | 50044 | **Marcapasos** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.2.4.4 | 60001 | **Computador Para Evaluacion** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Muy Critica | C.1.27.3.3 | 60002 | **Dictafono C/Transcriptor** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Critica | C.2.28.3.3 | 60002 | **Dictafono C/Transcriptor** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.1.5 | 60002 | **Dictafono C/Transcriptor** | 8 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.3.47.2.2 | 60002 | **Dictafono C/Transcriptor** | 6 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | I.4.48.2.5 | 60002 | **Dictafono C/Transcriptor** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.1.8 | 60002 | **Dictafono C/Transcriptor** | 5 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.3.1 | 60002 | **Dictafono C/Transcriptor** | 2 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.5.49.3.1 | 60003 | **Impresora De Etiquetas** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.1.1.2 | 60003 | **Impresora de etiquetas** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| No Critica | E.3.12.2.1 | 60003 | **Impresora De Etiquetas** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Muy Critica | A.08.2.9 | 60005 | **Computador Bajo Rendimiento sin Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.12.4 | 60005 | **Computador Bajo Rendimiento sin Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Critica | C.2.28.5.1 | 60005 | **Computador Bajo Rendimiento sin Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | J.1.50.5.2 | 60005 | **Computador Bajo Rendimiento sin Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | J.1.50.6.1 | 60005 | **Computador Bajo Rendimiento sin Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | J.1.50.6.4 | 60005 | **Computador Bajo Rendimiento sin Ofimatica** | 4 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | J.1.50.7.1 | 60005 | **Computador Bajo Rendimiento sin Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | J.1.50.8.3 | 60005 | **Computador Bajo Rendimiento sin Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | J.2.51.4 | 60005 | **Computador Bajo Rendimiento sin Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | J.1.50.4.0 | 60005 | **Computador Bajo Rendimiento sin Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | J.1.50.4.4 | 60005 | **Computador Bajo Rendimiento sin Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | J.1.50.5.1 | 60005 | **Computador Bajo Rendimiento sin Ofimatica** | 4 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Critica | J.1.50.6.2 | 60005 | **Computador Bajo Rendimiento sin Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | J.1.50.8.1 | 60005 | **Computador Bajo Rendimiento sin Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | J.1.50.9.1/J.1.50.9.2/J.1.50.9.3 | 60005 | **Computador Bajo Rendimiento sin Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | J.2.51.7 | 60005 | **Computador Bajo Rendimiento sin Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.08.2.3 | 60005 | **Computador Bajo Rendimiento sin Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.4.1 | 60005 | **Computador Bajo Rendimiento sin Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.8.4 | 60005 | **Computador Bajo Rendimiento sin Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | J.1.50.4.2 | 60005 | **Computador Bajo Rendimiento sin Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | J.2.51.5 | 60005 | **Computador Bajo Rendimiento sin Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.3.2 | 60005 | **Computador Bajo Rendimiento sin Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.4.4 | 60005 | **Computador Bajo Rendimiento sin Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | B.26.4.4 | 60005 | **Computador Bajo Rendimiento sin Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.4.5 | 60005 | **Computador Bajo Rendimiento sin Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.2.4 | 60006 | **Computador Alto rendimiento sin ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.4.30.2.1 | 60006 | **Computador Alto rendimiento sin ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.4.30.3.1 | 60006 | **Computador Alto rendimiento sin ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | I.3.47.10.1_C | 60006 | **Computador Alto rendimiento sin ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | I.3.47.6.1 | 60006 | **Computador Alto rendimiento sin ofimatica** | 4 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | I.3.47.7.1_C | 60006 | **Computador Alto rendimiento sin ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | I.3.47.8.2 | 60006 | **Computador Alto rendimiento sin ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | I.3.47.8.8 | 60006 | **Computador Alto rendimiento sin ofimatica** | 4 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | I.3.47.9.2 | 60006 | **Computador Alto rendimiento sin ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.01.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.01.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.02.1.3 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 5 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.02.1.4 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.02.2.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.02.2.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.02.2.4 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.02.2.5 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.02.2.6 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.02.2.7 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.02.3.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 5 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.03.1.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.03.2.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 5 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.03.2.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.03.2.3 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.03.2.4 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.03.2.5 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.04.1.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.04.2.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 6 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.04.2.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.04.2.3 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | A.05.1.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | A.05.2.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | A.05.2.3 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | A.05.2.4 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.06.1.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.06.2.3 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.06.2.4 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.07.1.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.07.2.4 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.08.1.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.08.2.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.09.1.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.09.2.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.09.2.10 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.09.2.13 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.09.2.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.09.2.6 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.09.2.7 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.09.2.8 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.5 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.6 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.11.1.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.11.1.3 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.11.1.4 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.11.1.5 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 5 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.11.2.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 8 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.11.2.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.11.2.3 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.11.2.4 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.11.2.6 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.11.2.7 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.1.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.13.4 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.13.5 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.12.2.13.6 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.3 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 6 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.7 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.1.5 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.1.6 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.1.8 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.1.9 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.2.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.4 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.9 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.13.4.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.4.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.4.3 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.4.4 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.4.5 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.4.6 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.5.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.14.1.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.14.1.3 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.14.1.4 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.14.1.5 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.14.1.6 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 5 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.14.2.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.14.2.10 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.14.2.11 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.14.2.12 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.14.2.13 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.14.2.5 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 6 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.14.2.6 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.14.2.7 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.14.2.8 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.14.2.9 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.15.1.3 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.1.4 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.1.6 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 10 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.11 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.12 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.14 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.22 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.3 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 4 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.4 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.5 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.6 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 4 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.15.2.7 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.9 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.16.1.3 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 5 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.16.1.4 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.16.1.5 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.16.1.6 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.16.2.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.16.2.4 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 6 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.16.2.5 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 8 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.16.2.6 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 8 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.16.2.7 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.16.2.8 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.1.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.1.3 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.1.6 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.1.7 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.2.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.2.5 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.2.7 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.2.8 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.2.9 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.3.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.17.3.3 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.3.4 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.18.1.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 4 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.18.1.3 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.18.2.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.18.2.10 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.18.2.11 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.18.2.12 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.18.2.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.18.2.5 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.18.2.6 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.18.2.7 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 5 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.18.2.8 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.18.2.9 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.19.1.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.19.1.4 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.19.2.12 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.19.2.16 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.19.2.17 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.19.2.18 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.19.2.3 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.19.2.4 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 4 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Critica | A.20.1.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | A.20.2.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | A.20.2.3 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.21.1.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.21.1.3 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 5 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.21.1.4 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.21.1.5 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.21.1.7 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 4 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.22.1.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.22.1.4 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Critica | A.22.2.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.22.2.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.22.2.3 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.22.2.4 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.22.2.5 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.22.2.6 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.22.3.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.22.4.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.23.1.3 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.23.1.4 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.23.2.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Critica | A.23.2.10 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.23.2.4 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.23.2.5 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.23.2.6 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.23.2.7 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.24.1.11.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.24.1.11.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.24.1.4 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 10 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.24.1.5 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.24.1.8 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.24.1.9 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.25.1.3 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.25.1.5 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.25.1.6 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.25.3.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 6 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.25.3.3 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.25.3.4 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.25.3.5 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.1.10 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.1.4 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 4 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.1.5 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.1.6 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | B.26.1.9 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.12.1.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 3 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.12.1.3 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.12.2.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.12.2.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.12.2.3 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.12.2.4 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.12.2.5 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 4 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.2.3 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.2.5 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 3 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las | 0,5 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24:00 Hrs. | | |
| Critica | B.26.2.7 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.2.8 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.3.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.3.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.3.3 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.4.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.4.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.4.3 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.5.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | B.26.6 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 4 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.7 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.8 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.9.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 16 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.1.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.5.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 4 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.1.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.6 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.9.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.0.27.0.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24:00 Hrs. | | |
| Muy Critica | C.0.27.0.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.0.27.0.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.0.27.0.3 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.3.29.1.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.3.29.3.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.4.30.1.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.1.31.1.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.1.31.2.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.1.31.2.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | D.1.31.2.3 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.1.31.3.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 4 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.1.31.4.5 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 4 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.3.33.4.5 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 4 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.4.34.4.5 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 4 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.5.35.4.5 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 4 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.6.36.4.5 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.2.32.1.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.2.32.2.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.2.32.2.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24:00 Hrs. | | |
| Critica | D.2.32.2.3 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.2.32.3.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 4 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.3.33.1.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.3.33.2.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.3.33.2.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.3.33.3.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 4 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.4.34.1.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.4.34.2.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.4.34.2.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | D.4.34.2.3 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.4.34.3.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 4 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.5.35.1.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.5.35.2.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.5.35.2.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.5.35.2.3 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.5.35.3.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 4 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.6.36.1.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.6.36.2.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.6.36.2.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24:00 Hrs. | | |
| Critica | D.6.36.3.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 4 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.1.1.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.1.2.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.1.2.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.1.3.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.1.3.8 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.1.4.3 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 18 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.2.1.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.2.2.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Critica | E.37.2.2.3 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.2.2.3.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.2.4.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.2.5.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 12 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.2.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.3.3 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.4.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 4 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.5.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 6 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.5.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 12 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.2.39.1.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las | 0,5 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24:00 Hrs. | | |
| Muy Critica | F.2.39.2.3 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.2.39.3.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 8 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.2.39.4.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 6 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.2.39.4.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 12 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.3.40.2.3 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.3.40.3.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 8 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.3.40.4.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 6 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.3.40.4.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 11 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.0.38.1.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Critica | F.0.38.1.3 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.4.41.1.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.4.41.2.3 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.4.41.3.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 8 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.4.41.4.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 6 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.4.41.4.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 12 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Critica | G.42.1.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | G.42.2.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | G.42.2.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | G.42.3.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 4 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24:00 Hrs. | | |
| Critica | G.42.3.8 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | H.1.43.1.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | H.1.43.2.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | H.1.43.2.4 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | H.1.43.2.7 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | H.1.43.3.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | H.1.43.3.7 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 6 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | H.1.43.4.7 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | H.1.43.4.8 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | H.2.44.1.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | H.2.44.1.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | H.2.44.1.3 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | H.2.44.2.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | H.2.44.3.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | H.2.44.4.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | H.2.44.4.7 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 4 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | H.2.44.5.3 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | H.2.44.5.4 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.1.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 4 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | I.1.45.1.4 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.1.5 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.1.7 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 10 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.3.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 6 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.3.4 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 4 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.3.5 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.4.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 4 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.4.3 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.4.4 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.4.6 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.4.7 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | I.1.45.5.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 9 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.5.3 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 5 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.5.4 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.5.5 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 7 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.6.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 4 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.6.3 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.6.4 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.7.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.8.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.9.4 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.9.6 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | I.1.45.9.8 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.1.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.1.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 4 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.1.9 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.3.3 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | I.2.46.3.4 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.3.5 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.6.4 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.6.5 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.7.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.7.4 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | I.3.47.1.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 4 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | I.3.47.1.3 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | I.3.47.2.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | I.3.47.2.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 6 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | I.3.47.2.6 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | I.4.48.1.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | I.4.48.1.3 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | I.4.48.5.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | I.5.49.1.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 4 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | I.5.49.1.5 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | I.5.49.1.6 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | I.5.49.3.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | I.5.49.3.3 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | I.5.49.3.4 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | I.5.49.3.5 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | J.1.50.1.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | J.1.50.1.3 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | J.1.50.6.3 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | J.1.50.7.3 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | J.2.51.6 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | J.2.51.9 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Critica | K.1.52.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | K.1.52.3 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | K.1.52.5 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | K.1.52.6 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 8 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | K.1.52.7 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 3 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | K.2.53.1.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | K.2.53.1.3 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 8 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | K.2.53.2.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | K.3.54.1.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | K.3.54.1.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las | 0,5 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24:00 Hrs. | | |
| Muy Critica | K.3.54.1.3 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | K.3.54.1.4 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 8 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | K.3.54.3.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | K.3.55.1.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | K.3.55.2.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 4 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | K.3.55.2.11 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | K.3.55.3.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 4 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | K.3.55.3.9 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.1.56.1.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Critica | L.1.56.1.3 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 6 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.1.56.10.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.1.56.10.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 6 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.1.56.11.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.1.56.11.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.1.56.12.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.1.56.12.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.1.56.13.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.1.56.13.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 10 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.1.56.14.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.1.56.14.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 4 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Critica | L.1.56.14.3 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 8 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.1.56.15.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.1.56.16.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.1.56.16.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.1.56.2.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.1.56.2.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.1.56.2.4 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.1.56.3.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.1.56.3.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.1.56.3.3 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.1.56.3.4 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Critica | L.1.56.3.5 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.1.56.4.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.1.56.5.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.1.56.5.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.1.56.5.3 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.1.56.5.4 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.1.56.7.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.1.56.7.3 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.1.56.8.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.1.56.8.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.1.56.8.3 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 6 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Critica | L.2.57.2.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.2.57.2.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.2.57.2.3 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.2.57.2.4 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.2.57.2.5 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 4 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.2.57.2.6 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.2.57.2.7 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.2.57.3.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.2.57.3.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.2.57.3.3 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.2.57.3.4 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Critica | L.2.57.3.5 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.2.57.3.6 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.2.57.3.7 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.2.57.3.8.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 15 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.2.57.4.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 4 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.2.57.6.1.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.2.57.6.1.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.2.57.6.1.3 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.2.57.6.2.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.2.57.6.2.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 5 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.2.57.6.3.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Critica | L.2.57.6.3.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 5 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.2.57.6.4.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.2.57.6.4.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.2.58.2.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.2.58.2.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.2.58.2.3 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.2.58.2.4 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 6 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.2.58.2.5 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.2.58.3.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.2.58.3.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.2.58.3.3 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Critica | L.2.58.3.4 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.2.58.3.5 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.2.58.3.6 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.2.58.3.7 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 4 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.2.58.3.8 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.2.58.4.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.4.59.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 6 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.4.59.3 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.6.61.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 10 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.5.60.1.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.5.60.1.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 6 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Critica | L.5.60.3.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 12 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.5.60.3.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.5.60.3.3 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 8 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.5.60.3.4 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 7 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.5.60.3.5 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 4 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.5.60.3.6 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 8 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.5.60.3.7 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.5.60.3.8 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 6 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.5.60.4.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.5.60.4.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.5.60.4.3 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Critica | L.5.60.4.4 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.5.60.5.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.5.60.5.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.5.60.5.3 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.5.60.5.4 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 5 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.5.60.5.5 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 5 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.5.60.5.6 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 4 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.5.60.5.7 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 4 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.08.1.4 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.08.2.10 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | A.10.2.11 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.9 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.11.1.4.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.4.4_B | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.14.2.8_A | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.12_A | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.21_B | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 4 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.24 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.25 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.16.1.7 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 6 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.21.1.11 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.21.1.8_A | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 4 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.21.1.8_B | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 4 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.23.1.4.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.24.1.6.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.12.1.5 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.7.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 6 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.11_T | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.7.1_T | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.7.9/C.1.30.1.5 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.3.29.3.1/28.11.8 /28.11.9 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | D.1.31.3.8 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.2.32.3.8 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.2.32.4.5 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 4 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.3.33.3.8 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.4.34.3.8 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.5.35.3.8 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.6.36.3.8 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| N/A | D.6.36.4.5_A | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| CENTRAL ALIMENTACION | 67.2.3 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| CENTRAL ALIMENTACION | 67.2.5 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROPERIA | 69.1.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| ROPERIA | 69.2.7 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| ROPERIA | 69.4.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| ROPERIA | 69.5.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| ROPERIA | 69.5.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| MOVILIZACION - AREA DE CHOFERES | 70.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Sala Trabajo Médico | 80.11 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 4 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| AREA DE CAPACITACIÓN | 81.1.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| AREA DE CAPACITACIÓN | 81.2.3 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| N/A | 81.2.4 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| AREA DE CAPACITACIÓN | 81.2.5a | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA DE CAPACITACIÓN | 81.2.5b | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| AREA DE CAPACITACIÓN | 81.2.6 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| UNIDAD DE LOGISTICA | 85.1.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| UNIDAD DE LOGISTICA | 85.1.1.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| UNIDAD DE LOGISTICA | 85.1.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| UNIDAD DE LOGISTICA | 85.1.3 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| UNIDAD DE LOGISTICA | 85.1.4 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 8 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| UNIDAD DE LOGISTICA | 85.1.5 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| UNIDAD DE LOGISTICA | 85.1.8 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| N/A | 85.1.6 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| UNIDAD DE LOGISTICA | 85.2.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD DE LOGISTICA | 85.2.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| N/A | 67.2.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| N/A | D.1.31.4.6 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 7 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| N/A | D.2.32.2.11 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 4 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| N/A | D.4.34.4.6 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 7 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| N/A | D.5.35.2.11 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 4 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| N/A | H.1.43.7.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| N/A | I.3.47.4.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| N/A | L.1.56.7.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| N/A | L.2.57.5.5 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.3.40.1.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las | 0,5 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24:00 Hrs. | | |
| Muy Critica | F.4.41.4.3 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Critica | H.2.44.3.6 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.X/45.3.2/45.3.3 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 8 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.3.3_C | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 4 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.3.47.11.2/I.3.47.11.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | I.3.47.11.3 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.3.47.4.3 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | J.1.50.4.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | J.1.50.4.3 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 4 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | K.2.53.1.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Critica | K.3.54.3.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.1.56.9.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.1.56.9.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.2.57.1.2/L.2.57.1.3 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 7 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.2.57.6.5.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.5.60.2.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.5.60.2.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.5.60.2.3 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 8 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.5.60.4.5_E | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.5.60.4.5_T | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.5.60.4.5_U | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Critica | P.14.80.1/P.14.80.5 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | P.14.80.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | P.14.80.4 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 5 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.1.1.3 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.1.1.4 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.1.2.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 7 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.1.2.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 7 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.1.2.3 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.1.2.4 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.1.2.5 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.1.2.6 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.1.3.1.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.1.3.1.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.1.3.1.3 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.1.3.2.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.1.3.2.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.1.3.2.3 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.1.3 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 5 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.10.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.10.3 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.10.4 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.10.7 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | A.2.2.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 5 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.2.3 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.3.3 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.4.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.4.2_P | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.4.3 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.4.4 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.4.5 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.4.6 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.4.7 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.5.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | A.2.5.3 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.5.5 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.6.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.6.3 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.7.3 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.9.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.9.3 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.9.4 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.9.5 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.8.3 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.8.4 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | B.0.3.0.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | B.0.3.0.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | B.1.3.1.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | B.1.3.2.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | B.1.3.3.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 4 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | B.1.3.3.7 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 8 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | B.1.3.3.8 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | B.1.3.4.3 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | B.2.4.2.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | B.2.4.3.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 4 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | B.2.4.3.7 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 8 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | B.3.5.1.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | B.3.5.2.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | B.3.5.2.3 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | B.3.5.3.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | B.3.5.3.7 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | B.3.5.4.3 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.1.11 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.1.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.1.4 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.10 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | C.1.6.2.12 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.13 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.14 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.15 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.16 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.3 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.4 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.7 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.8 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| No Critica | D.0.7.0.3 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Critica | D.0.7.0.5 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| No Critica | D.0.7.0.6 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| No Critica | D.0.7.0.7 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 4 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| No Critica | D.1.8.1.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| No Critica | D.1.8.1.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| No Critica | D.1.8.2.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| No Critica | D.1.8.2.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| No Critica | D.2.9.1.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| No Critica | D.2.9.1.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Muy Critica | D.2.9.3.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las | 1 dia | Edificio N°2 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24:00 Hrs. | | |
| No Critica | D.2.9.3.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| No Critica | E.1.10.1.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| No Critica | E.1.10.1.3 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| No Critica | E.1.10.1.5 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| No Critica | E.1.10.2.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| No Critica | E.1.10.2.4 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| No Critica | E.1.10.2.5 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| No Critica | E.1.10.2.6 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| No Critica | E.1.10.2.7 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| No Critica | E.1.10.2.8 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Critica | E.1.10.3.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| No Critica | E.1.10.3.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| No Critica | E.2.11.1.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| No Critica | E.2.11.2.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| No Critica | E.2.11.2.10 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| No Critica | E.2.11.2.12 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| No Critica | E.2.11.2.13 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| No Critica | E.2.11.2.14 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| No Critica | E.2.11.2.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| No Critica | E.2.11.2.3 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 6 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| No Critica | E.2.11.2.4 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Critica | E.2.11.2.5 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| No Critica | E.2.11.2.6 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| No Critica | E.2.11.2.7 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| No Critica | E.2.11.2.8 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| No Critica | E.2.11.2.9 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 4 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| No Critica | E.3.12.1.3 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| No Critica | E.3.12.1.4 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| No Critica | E.3.12.1.5 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| No Critica | E.3.12.1.6 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| No Critica | E.3.12.2.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| No Critica | E.3.12.2.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Critica | E.3.12.3.3 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| No Critica | E.3.12.4.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| No Critica | E.3.12.4.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| No Critica | E.3.12.6.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| No Critica | E.3.12.6.3 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.1.1.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.10.5 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.2.1/A.2.3.1/A.2.5.1/A.2.6.1/A.2.7.1/A.2.9.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 4 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.2.1/A.2.3.1/A.2.5.1/A.2.6.1/A.2.7.1/A.2.9.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.3.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.4.1/A.2.8.1/A.2.10.1 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 4 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | A.2.4.8 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.5.4 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.8.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | B.2.4.1.2 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | B.2.4.3.8 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | B.2.4.4.3 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.11 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| No Critica | D.0.7.0.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| No Critica | D.1.8.2.3 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| No Critica | D.2.9.3.7 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°2 |
| No Critica | E.1.10.1.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Critica | E.1.10.2.9 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| No Critica | E.2.11.2.11 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| No Critica | E.3.12.2.4 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| No Critica | E.3.12.3.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| No Critica | E.3.12.6.4 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| No Critica | P.13.79.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| No Critica | P.13.79.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.2.1.6 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Menos Critica | B.26.12.2.7 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.5 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.6 | 60008 | **Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Critica | E.3.12.6.2 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | B.26.2.1 | 60008 | **Computador Bajo rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | I.3.47.11.3 | 60009 | **Sistema RIS-PACS** | 1 | 6 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | J.1.50.7.2 | 60010 | **Sistema Trazabilidad De Instrumental Clinico** | 1 | 6 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.3.3_C | 60012 | **Sistema de Dictado Movil y Transcripcion para A.P.** | 8 | 5 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.07.2.2 | 60015 | **Computador Alto rendimiento sin ofimatica, monitor Definicion Clinica** | 4 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.8 | 60015 | **Computador Alto rendimiento sin ofimatica, monitor Definicion Clinica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | E.3.12.1.3 | 60016 | **Impresora de etiquetas y brazaletes** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| No Critica | E.3.12.1.4 | 60016 | **Impresora de etiquetas y brazaletes** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| No Critica | E.3.12.2.1 | 60016 | **Impresora de etiquetas y brazaletes** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | I.2.46.3.3_C | 60017 | **Sistema de Impresion de laminas** | 5 | 6 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.3.1 | 60018 | **Sistema de Impresion de Cassettes** | 2 | 6 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.03.2.1 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 6 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.04.2.1 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 5 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.06.2.1 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.06.2.2 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 11 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.07.2.1 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.07.2.3 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.08.1.3 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 5 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.08.2.5 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.08.2.6 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.08.2.7 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Critica | A.08.2.8 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.09.1.3 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.09.2.11 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.09.2.12 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.09.2.9 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.10 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.13 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.7 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.1.3 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.1.4 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 6 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.1 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 4 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | A.12.2.11 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.12 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.4 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.6 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.1.10 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 5 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.1.7 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.1 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.10 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.2 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 7 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.3 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.5 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.13.3.6 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.7 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 4 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.8 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.5.2 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.5.3 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.5.4 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.1.5 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.1.9 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 4 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.2.6 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 7 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.3.2 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.1.7 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | B.26.12.1.4 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.12.2.6 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.3.3 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 5 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.3 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 5 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.2 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.3 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 6 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.4 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.5 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.3.3 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 5 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24:00 Hrs. | | |
| Critica | D.1.31.3.7 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 8 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.2.32.3.7 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 8 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.3.33.3.7 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 8 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.5.35.3.7 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 8 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.6.36.3.7 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 8 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.1.3.7 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 4 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.2.2.2 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.2.4.7 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 4 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.4.7 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 4 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Critica | F.2.39.3.7 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 4 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.3.40.3.7 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 4 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.0.38.1.2 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.0.38.1.4 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.4.41.3.7 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 4 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Critica | G.42.3.7 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 8 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.1.3 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.1.5 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 8 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.1.6 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.1.7 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | I.2.46.1.8 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 5 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.3.1 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | I.3.47.2.5 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | I.4.48.2.3 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | I.4.48.2.4 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | I.4.48.5.2 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.14 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.15 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.3 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 4 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.1.3_A | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.5 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | D.4.34.3.7 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 8 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | I.4.48.2.5 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 4 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | I.4.48.5.2.a | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| MEDICINA NUCLEAR | I.4.48.5.5 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | H.2.44.5.2 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | I.4.48.6.3 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.9 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.10 | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.TM | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.TP | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.U | 60019 | **Computador Alto rendimiento con ofimatica** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24:00 Hrs. | | |
| Menos Critica | A.11.1.6 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.1.5 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.1.11 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.14.1.7 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.1.5 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.1.8 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.18.1.4 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | A.20.2.1 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.21.1.9 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.1.8 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.0.27.0.4 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | D.1.31.2.4 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.2.32.4.3 | 60020 | **Notebook** | 7 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.2.32.2.4 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.3.33.2.3 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.3.33.2.4 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.3.33.4.3 | 60020 | **Notebook** | 7 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.4.34.4.3 | 60020 | **Notebook** | 5 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.5.35.4.3 | 60020 | **Notebook** | 5 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.6.36.4.3 | 60020 | **Notebook** | 5 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.4.34.2.4 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24:00 Hrs. | | |
| Critica | D.5.35.2.4 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.6.36.2.3 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.6.36.2.4 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.1.2.3 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.1.2.4 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.2.2.5 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.3.2 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.2.39.2.2 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.3.40.2.2 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Critica | F.0.38.1.5 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.4.41.2.2 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Critica | G.42.2.3 | 60020 | **Notebook** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | G.42.4.3 | 60020 | **Notebook** | 5 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | H.1.43.2.2 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | H.1.43.2.3 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | H.2.44.3.2 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | H.2.44.3.3 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.1.6 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.1.4 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | I.3.47.2.7 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | I.4.48.2.6 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | I.5.49.1.7 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | J.1.50.1.4 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | K.3.54.1.5 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.1.56.16.3 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.1.56.2.5 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.1.56.5.5 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.1.56.5.6 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.1.56.7.4 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.1.56.8.4 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.1.56.9.3 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Critica | L.2.57.1.5 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.2.57.4.1 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.5.60.1.4 | 60020 | **Notebook** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.23 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.22.1.6 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.1.31.4.3 | 60020 | **Notebook** | 7 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Área de Formación | D.2.32.X | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Área de Formación | D.2.33.X | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Área de Formación | D.2.35.X | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Área de Formación | D.2.36.X | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Área de capacitación | P.15.81.2.7 | 60020 | **Notebook** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD DE LOGÍSTICA | P.19.85.1.6 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| No Critica | L.1.56.2.5A | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.1.1.5 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.1.4 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.2.4 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | B.1.3.2.2 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | B.1.3.2.3 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | B.1.3.4.5 | 60020 | **Notebook** | 4 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | B.2.4.2.2 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | B.2.4.2.3 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | B.3.5.2.2 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.1.10 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y | 1 dia | Edificio N°2 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 20:00 Hrs. | | |
| No Critica | D.0.7.0.8 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| No Critica | E.1.10.1.7 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| No Critica | E.2.11.1.4 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | B.2.4.4.5 | 60020 | **Notebook** | 4 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | B.1.3.4.3 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | B.3.5.4.5 | 60020 | **Notebook** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Menos Critica | B.26.10.9 | 60020 | **Notebook** | 1 | 4 | 99.5% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 0,5 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | J.1.50.7.2 | 70001 | **Autoclave 650 lt.** | 3 | 12 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.4.3 | 70002 | **Autoclave Laboratorio** | 1 | 12 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | J.1.50.8.2 | 70003 | **Esterilizador Oxido de Etileno** | 1 | 12 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | J.1.50.9.1/J.1.50.9.2/J.1.50.9.3 | 70004 | **Esterilizador Plasma** | 2 | 12 | 97% | Lunes a Domingo entre | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 00:00 y las 24:00 Hrs. | | |
| Muy Critica | J.1.50.5.2 | 70005 | **Gabinete Secador** | 2 | 12 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | J.1.50.5.2 | 70006 | **Lavadora A Vapor Para Instumental De Laparoscopia** | 1 | 12 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.5.49.4.1 | 70007 | **Lavadora Descontaminadora Material De Vidrio** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | J.1.50.5.2 | 70008 | **Lavadora Instrumental Ultrasonica** | 3 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | J.1.50.5.2 | 70009 | **Lavadora Descontaminadora** | 4 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | J.1.50.6.1 | 70010 | **Lupa/Lampara De Revision** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | J.1.50.4.2 | 70012 | **Reprocesador Automatico De Endoscopios** | 4 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | K.3.55.2.11 | 70013 | **Selladora Polietileno Y Otros (Mixta)** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | K.3.55.3.9 | 70013 | **Selladora Polietileno Y Otros (Mixta)** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | J.1.50.7.2 | 70014 | **Autoclave 300 lt.** | 2 | 12 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24:00 Hrs. | | |
| Muy Critica | C.4.30.2 | 80001 | **Angiografo Multiproposito I** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | I.4.48.5.1 | 80002 | **Calibrador De Dosis** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | I.4.48.5.1 | 80003 | **Celda Para Preparacion De Radiofarmaco** | 2 | 15 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | I.4.48.5.1 | 80004 | **Contenedor De Radioisotopos** | 2 | 15 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | I.3.47.10.1 | 80005 | **Densitometro oseo** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.09.2.11 | 80006 | **Ecocardiografo** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.09.2.11 | 80006 | **Ecocardiografo** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.3.47.6.1 | 80007 | **Ecotomografo Doppler Color Multiproposito** | 4 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.3.47.11.5 | 80007 | **Ecotomografo Doppler Color Multiproposito** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.15 | 80007 | **Ecotomografo Doppler Color Multiproposito** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.13 | 80007 | **Ecotomografo Doppler Color Multiproposito** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.3.2.5 | 80007 | **Ecotomografo Doppler Color Multiproposito** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Critica | C.1.27.6.2.TM | 80010 | **Equipo Rx Arco C** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.TP | 80010 | **Equipo Rx Arco C** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.3 | 80010 | **Equipo Rx Arco C** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.2 | 80010 | **Equipo Rx Arco C** | 3 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2 | 80010 | **Equipo Rx Arco C** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.U | 80010 | **Equipo Rx Arco C** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | I.4.48.5.1 | 80011 | **Medidor De Radiacion** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.8 | 80012 | **Rayos X Dental Intraoral** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.9 | 80013 | **Rayos X Dental Panoramico** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.3.47.5.1 | 80014 | **Rayos X Osteopulmonar** | 4 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.3.47.9.1 | 80015 | **Resonador Nuclear Magnetico** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.3.47.11.5 | 80018 | **Rx Portatil** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24:00 Hrs. | | |
| Muy Critica | F.1.38.4.5 | 80018 | **Rx Portatil** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.2.39.3.5 | 80018 | **Rx Portatil** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | I.3.47.7.1 | 80019 | **Rx Telecomandado** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.3.47.8.1 | 80020 | **Tomografo Axial Computarizado** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.10 | 80021 | **Tomografo Axial Computarizado Dental** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | I.4.48.6.1 | 80022 | **Tomografo Por Emision De Fotones** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.4.30.3 | 80023 | **Angiografo Multiproposito II** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.03.2.5 | 80026 | **Ecotomografo Doppler Tiroides** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2 | 80032 | **Ecografo doppler para pabellones** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.TP | 80032 | **Ecografo doppler para pabellones** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.U | 80032 | **Ecografo doppler para pabellones** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24:00 Hrs. | | |
| Muy Critica | C.1.27.6.3 | 80032 | **Ecografo doppler para pabellones** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.2 | 80032 | **Ecografo doppler para pabellones** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | I.4.48.6.1.a | 80033 | **PET - CT** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.21.1.5 | 80033 | **Ecotomografo doppler portátil** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.2 | 80033 | **Ecotomografo doppler portátil** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.4.5 | 80033 | **Ecotomografo doppler portátil** | 3 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | I.3.47.8.1 | 80034 | **Tomografo Axial Computarizado I** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.4.30.2 | 80034 | **Equipo Ecografia intravascular** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.5 | 80035 | **Ecografo Portatil Urologia** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.4.7 | 90002 | **Agitador Circular Para Vdrl** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.5.4 | 90003 | **Agitador Magnetico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | I.1.45.5.2 | 90003 | **Agitador Magnetico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.5.2 | 90004 | **Agitador Vortex** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.5.3 | 90004 | **Agitador Vortex** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.5.4 | 90004 | **Agitador Vortex** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.6.2 | 90004 | **Agitador Vortex** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.6.3 | 90004 | **Agitador Vortex** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.7.2 | 90004 | **Agitador Vortex** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.8.2 | 90004 | **Agitador Vortex** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.9.4 | 90004 | **Agitador Vortex** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.3.3_C | 90004 | **Agitador Vortex** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.4.2 | 90004 | **Agitador Vortex** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.6.4 | 90004 | **Agitador Vortex** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.X/45.3.2/45.3.3 | 90004 | **Agitador Vortex** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 20:00 Hrs. | | |
| Critica | I.1.45.4.4 | 90004 | **Agitador Vortex** | 3 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.2.10.4 | 90005 | **Analizador De Lactato** | 1 | 5 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | I.1.45.9.3 | 90006 | **Balanza Analitica Digital** | 3 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.3.1 | 90006 | **Balanza Analitica Digital** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.5.2 | 90006 | **Balanza Analitica Digital** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.4.3 | 90008 | **Balanza De Precision** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | I.2.46.3.1 | 90008 | **Balanza De Precision** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.3.1 | 90008 | **Balanza De Precision** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.7.2 | 90009 | **Balanza Peso Organos** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.3.3_C | 90010 | **Baño Histologico** | 5 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.5.4 | 90011 | **Baño Seco** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | I.1.45.4.3 | 90012 | **Baño Termorregulado** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.4.7 | 90012 | **Baño Termorregulado** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.5.2 | 90012 | **Baño Termorregulado** | 3 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.8.2 | 90012 | **Baño Termorregulado** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.5.49.3.1 | 90012 | **Baño Termorregulado** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.2.4.5 | 90012 | **Baño Termorregulado** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.5.2 | 90013 | **Campana De Flujo Laminar** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | K.3.55.2.6 | 90013 | **Campana De Flujo Laminar** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.6.2 | 90014 | **Camara Electroforesis Horizontal** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.6.3 | 90014 | **Camara Electroforesis Horizontal** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.6.3 | 90016 | **Camara Electroforesis Vertical** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.7.4 | 90017 | **Camara Mortuoria** | 2 | 15 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.6.4 | 90022 | **Centrifuga Refrigerada** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 20:00 Hrs. | | |
| Menos Critica | I.2.46.3.3 | 90024 | **Centro De Inclusion** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.5.4 | 90025 | **Citocentrifuga** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.3.3_C | 90025 | **Citocentrifuga** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.3.4 | 90027 | **Contador Celular** | 4 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.5.3 | 90027 | **Contador Celular** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.5.4 | 90027 | **Contador Celular** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.7.2 | 90027 | **Contador Celular** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| No Critica | A.20.2.4 | 90028 | **Cooler 48L** | 3 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.5.49.4.2 | 90028 | **Cooler 48l** | 4 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.2.5.5 | 90028 | **Cooler 48l** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.1.2.5 | 90028 | **Cooler 48L** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| No Critica | A.20.2.4 | 90029 | **Cooler 24L** | 3 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 00:00 y las 24:00 Hrs. | | |
| Muy Critica | K.3.54.3.1 | 90029 | **Cooler 24L** | 10 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.3.2 | 90030 | **Criostato** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | I.2.46.3.2 | 90031 | **Criostato Portatil** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | K.3.54.3.2 | 90033 | **Desblisteadora** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | D.2.9.3.2 | 90033 | **Desblisteadora** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Muy Critica | K.3.54.3.1 | 90034 | **Sistema de dispensacion de Farmacia HDS** | 2 | 15 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.25.3.5 | 90034 | **Sistema de dispensacion de Farmacia HDS** | 2 | 15 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.18.2.2 | 90034 | **Sistema de dispensacion de Farmacia HDS** | 1 | 15 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.6.2 | 90040 | **Espectrofotometro** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.6.4 | 90040 | **Espectrofotometro** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | I.1.45.6.2 | 90041 | **Estacion De Trabajo Para Pcr** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.6.3 | 90041 | **Estacion De Trabajo Para Pcr** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.4.5 | 90042 | **Estufa De Cultivo** | 5 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.5.2 | 90042 | **Estufa De Cultivo** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.7.2 | 90043 | **Estufa De Secado** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.9.6 | 90043 | **Estufa De Secado** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.3.3 | 90043 | **Estufa de secado** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.3.4 | 90043 | **Estufa De Secado** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.5.49.4.1 | 90043 | **Estufa De Secado** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.6.4 | 90044 | **Extractor Automatizado De Adn/Arn** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| No Critica | A.20.2.4 | 90045 | **Freezer -30° C** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.6.2 | 90045 | **Freezer -30° C** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | I.1.45.9.8 | 90045 | **Freezer -30° C** | 6 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.5.49.3.2 | 90045 | **Freezer -30° C** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.3.3_C | 90045 | **Freezer -30° C** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.4.2 | 90045 | **Freezer -30° C** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.5.2 | 90045 | **Freezer -30° C** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.6.3 | 90045 | **Freezer -30° C** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.9.1 | 90045 | **Freezer -30° C** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.9.8 | 90046 | **Freezer -80°C 380L** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.5.49.3.2 | 90047 | **Freezer -80°C 500L** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.9.8 | 90047 | **Freezer -80°C 500L** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | K.3.54.3.1 | 90048 | **Freezer** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.25.3.5 | 90048 | **Freezer** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | K.3.55.3.11 | 90048 | **Freezer** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.21.1.6 | 90048 | **Freezer** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.1.3.3.2 | 90048 | **Freezer** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.3.5.3.2 | 90048 | **Freezer** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Muy Critica | K.3.55.3.6 | 90049 | **Gabinete Bioseguridad Clase II B2** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | K.3.55.2.8 | 90049 | **Gabinete Bioseguridad Clase II B2** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.8.2 | 90051 | **HPLC (Cromatografia Liquida De Alta Efieciencia)** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.5.49.3.2 | 90052 | **Incubador/Agitador De Plaquetas** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.4.2 | 90053 | **Lupa Estereoscopica** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.7.2 | 90056 | **Mesa Autopsia** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.5.2 | 90057 | **Microcentrifuga 12T** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 20:00 Hrs. | | |
| Critica | I.1.45.6.2 | 90057 | **Microcentrifuga 12T** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.6.3 | 90057 | **Microcentrifuga 12T** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.6.4 | 90057 | **Microcentrifuga 12T** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.1.7 | 90058 | **Microscopio 10 Cabezales Con Camara Digital** | 1 | 15 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.5.5 | 90059 | **Microscopio 5 Cabezales** | 1 | 15 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.5.5 | 90060 | **Microscopio Coobservacion** | 2 | 15 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.7.3 | 90061 | **Microscopio Inmunofluorescencia** | 2 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.7.3 | 90061 | **Microscopio Inmunofluorescencia** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.5.4 | 90062 | **Microscopio Trinocular** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.3.4 | 90063 | **Microscopio Universal** | 4 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.4.2 | 90063 | **Microscopio Universal** | 3 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.4.7 | 90063 | **Microscopio Universal** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | I.1.45.5.5 | 90063 | **Microscopio Universal** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.3.2 | 90063 | **Microscopio Universal** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.3.3_C | 90064 | **Microtomo Rotatorio Semiautomatico** | 5 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.5.2 | 90066 | **PHmetro** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.3.3_C | 90066 | **PHmetro** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.3.3_C | 90067 | **Placa Calefaccionada** | 5 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.5.2 | 90067 | **Placa Calefaccionada** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.3.5 | 90068 | **Procesador De Tejidos** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | K.3.54.3.2 | 90069 | **Reenvasadora** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.5.49.3.2 | 90070 | **Refrigerador Banco De Sangre** | 3 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.25.3.5 | 90071 | **Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Doble Puerta** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.9.1 | 90071 | **Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Doble Puerta** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24:00 Hrs. | | |
| Critica | I.1.45.9.8 | 90071 | **Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Doble Puerta** | 5 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | K.3.54.3.1 | 90071 | **Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Doble Puerta** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.3.3_C | 90071 | **Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Doble Puerta** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | K.3.55.2.11 | 90071 | **Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Doble Puerta** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.5.4 | 90071 | **Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Doble Puerta** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.1.3.2.4 | 90071 | **Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Doble Puerta** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Muy Critica | D.2.9.3.1 | 90071 | **Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Doble Puerta** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Muy Critica | A.08.2.2 | 90072 | **Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.2.2 | 90072 | **Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.13.3.6 | 90072 | **Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.2.5 | 90072 | **Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.18.2.4 | 90072 | **Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.19.2.5 | 90072 | **Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| No Critica | A.20.2.4 | 90072 | **Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.24.1.9 | 90072 | **Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.4.2 | 90072 | **Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.2.39.3.2 | 90072 | **Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.3.40.3.2 | 90072 | **Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.4.2 | 90072 | **Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | I.1.45.4.3 | 90072 | **Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.5.2 | 90072 | **Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | I.4.48.5.1 | 90072 | **Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.5.49.3.5 | 90072 | **Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | K.3.55.2.2 | 90072 | **Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | K.3.55.3.2 | 90072 | **Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | K.3.55.3.4 | 90072 | **Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | H.1.43.3.4 | 90072 | **Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.3.1 | 90072 | **Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.3.2 | 90072 | **Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Critica | K.3.55.3.10 | 90072 | **Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | H.2.44.3.6 | 90072 | **Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.7.2 | 90072 | **Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.7.2 | 90072 | **Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.1.3.2 | 90072 | **Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.23.2.2 | 90072 | **Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.6.1 | 90072 | **Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.2.4.2 | 90072 | **Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.22.5.10 | 90072 | **Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | G.42.3.2 | 90072 | **Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | D.1.31.3.2 | 90072 | **Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.2.32.3.2 | 90072 | **Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.3.33.3.2 | 90072 | **Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.4.34.3.2 | 90072 | **Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.6.36.3.2 | 90072 | **Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.18.2.3 | 90072 | **Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | D.2.9.3.1 | 90072 | **Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Muy Critica | D.2.9.3.6 | 90072 | **Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.1.2.5 | 90072 | **Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.3.5.3.2 | 90072 | **Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Critica | F.4.41.3.2 | 90072 | **Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | A.05.2.4 | 90073 | **Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta Pequeño** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.2 | 90073 | **Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta Pequeño** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.5.3 | 90073 | **Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta Pequeño** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.6.2 | 90073 | **Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta Pequeño** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.6.3 | 90073 | **Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta Pequeño** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.5.2 | 90073 | **Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta Pequeño** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.9.2/C.2.30.1.5 | 90073 | **Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta Pequeño** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.5.35.3.2 | 90073 | **Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta Pequeño** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.1.3.3.2 | 90073 | **Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta Pequeño** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | I.1.45.6.3 | 90075 | **Secuenciador De Adn/Arn** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.5.49.3.1 | 90076 | **Selladora Tubuladora** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.5.49.3.6 | 90076 | **Selladora Tubuladora** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.X/45.3.2/45.3.3 | 90078 | **Set Micropipetas Automaticas** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.7.2 | 90080 | **Sierra Electrica Para Autopsias** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.3.5 | 90083 | **Sistema Integrado Cubridor Y Teñidor de Laminas** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.5.49.4.2 | 90084 | **Sistema Refrigerado Para Almacenamiento Temporal Y Transporte De Sangre Y Hemoderivados** | 8 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.6.4 | 90087 | **Termobloque** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.6.2 | 90088 | **Termociclador** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.6.3 | 90088 | **Termociclador** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.6.2 | 90089 | **Termociclador Tiempo Real** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | I.1.45.6.3 | 90089 | **Termociclador Tiempo Real** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.25.3.6 | 90090 | **Termometro-Higrometro (Ambiental)** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | K.3.55.2.2 | 90090 | **Termometro-Higrometro (Ambiental)** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | K.3.55.2.6 | 90090 | **Termometro-Higrometro (Ambiental)** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | K.3.55.2.8 | 90090 | **Termometro-Higrometro (Ambiental)** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | K.3.55.3.6 | 90090 | **Termometro-Higrometro (Ambiental)** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.6.2 | 90091 | **Transiluminador** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.6.3 | 90091 | **Transiluminador** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.3.3_C | 90093 | **Agitador Magnetico con calefactor** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.4.5 | 90102 | **Estufa De Cultivo CO2** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.4.2 | 90105 | **Mechero Bunsen** | 4 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.4.3 | 90105 | **Mechero Bunsen** | 4 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.4.4 | 90105 | **Mechero Bunsen** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | I.1.45.4.6 | 90105 | **Mechero Bunsen** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.3.5 | 90107 | **Microscopio Contraste de Fase** | 2 | 15 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.X/45.3.2/45.3.3 | 90107 | **Microscopio Contraste de Fase** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.5.2 | 90108 | **Microscopio Contraste de Fase Trinocular** | 2 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.7.2 | 90111 | **Microscopio Universal Luz Polarizada** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.1.8 | 90111 | **Microscopio Universal Luz Polarizada** | 5 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.3.2 | 90111 | **Microscopio Universal Luz Polarizada** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.5.3 | 90114 | **Microscopio Coobservacion 3 cabezales** | 1 | 15 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.1.3 | 90115 | **Microscopio Coobservacion Luz Polarizada** | 1 | 15 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.1.5 | 90115 | **Microscopio Coobservacion Luz Polarizada** | 8 | 15 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | I.2.46.3.1 | 90115 | **Microscopio Coobservacion Luz Polarizada** | 1 | 15 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.3.4 | 90116 | **Microscopio Luz Polarizada Basico** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Critica | D.2.9.3.1 | 90118 | **Sistema de dispensacion de Farmacia ING** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.1.3.2.2 | 90118 | **Sistema de dispensacion de Farmacia ING** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Muy Critica | I.2.46.3.1 | 90119 | **set de tincion** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.3.4 | 90126 | **Campana De extraccion gases organicos I** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.3.5 | 90126 | **Campana De extraccion gases organicos I** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.6 | 90126 | **Campana De extraccion gases organicos I** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.5.2 | 90127 | **Campana De Extraccion gases organicos II** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.8.2 | 90127 | **Campana De Extraccion gases organicos II** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.4.7 | 90128 | **Centrifuga Universal** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.5.49.3.1 | 90128 | **Centrifuga Universal** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.5.49.3.3 | 90128 | **Centrifuga Universal** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24:00 Hrs. | | |
| Critica | I.1.45.5.2 | 90128 | **Centrifuga Universal** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.5.3 | 90128 | **Centrifuga Universal** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.5.4 | 90128 | **Centrifuga Universal** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.9.4 | 90128 | **Centrifuga Universal** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.5.49.3.1 | 90129 | **Conector Esteril de Tubuladuras** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.1.3.3.5 | 90130 | **Cooler 16L** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Muy Critica | H.1.43.3.4 | 90133 | **Dispensador automatico de insumos y medicamentos 1 columna** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.9.2/C.2.30.1.5 | 90133 | **Dispensador automatico de insumos y medicamentos 1 columna** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.2.4.4 | 90133 | **Dispensador automatico de insumos y medicamentos 1 columna** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | G.1.42.3.4 | 90133 | **Dispensador automatico de insumos y medicamentos 1 columna** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | B.3.5.3.2 | 90133 | **Dispensador automatico de insumos y medicamentos 1 columna** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Muy Critica | C.1.27.5.2 | 90134 | **Dispensador automatico de insumos y medicamentos 2 columnas** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.27.4.1/C.2.28.5.1 | 90134 | **Dispensador automatico de insumos y medicamentos 2 columnas** | 8 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.3.29.3.5 | 90134 | **Dispensador automatico de insumos y medicamentos 2 columnas** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.1.3.4 | 90134 | **Dispensador automatico de insumos y medicamentos 2 columnas** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.4.4 | 90134 | **Dispensador automatico de insumos y medicamentos 2 columnas** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.2.39.3.4 | 90134 | **Dispensador automatico de insumos y medicamentos 2 columnas** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.1.31.3.4 | 90134 | **Dispensador automatico de insumos y medicamentos 2 columnas** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | D.2.32.3.4 | 90134 | **Dispensador automatico de insumos y medicamentos 2 columnas** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.3.33.3.4 | 90134 | **Dispensador automatico de insumos y medicamentos 2 columnas** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.5.35.3.4 | 90134 | **Dispensador automatico de insumos y medicamentos 2 columnas** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.6.36.3.4 | 90134 | **Dispensador automatico de insumos y medicamentos 2 columnas** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.1.3.3.2 | 90134 | **Dispensador automatico de insumos y medicamentos 2 columnas** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Muy Critica | F.2.39.3.4 | 90134 | **Dispensador automatico de insumos y medicamentos 2 columnas** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | B.26.6.3 | 90134 | **Dispensador automatico de insumos y medicamentos 2 columnas** | 4 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.4.41.3.4 | 90134 | **Dispensador automatico de insumos y medicamentos 2 columnas** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Critica | F.3.40.3.4 | 90134 | **Dispensador automatico de insumos y medicamentos 2 columnas** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | D.4.34.3.4 | 90134 | **Dispensador automatico de insumos y medicamentos 2 columnas** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.7.4/C.1.30.2.2 | 90134 | **Dispensador automatico de insumos y medicamentos 2 columnas** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.27.4.1/C.2.28.5.1 | 90136 | **Dispensador automatico de insumos y medicamentos 3 columnas** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.3.40.3.4 | 90136 | **Dispensador automatico de insumos y medicamentos 3 columnas** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.4.41.3.4 | 90136 | **Dispensador automatico de insumos y medicamentos 3 columnas** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.5.2 | 90137 | **Escaner de Metafases** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.4.3 | 90139 | **Gabinete Bioseguridad Clase II A2** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.4.4 | 90139 | **Gabinete Bioseguridad Clase II A2** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.6.4 | 90139 | **Gabinete Bioseguridad Clase II A2** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | I.1.45.6.2 | 90139 | **Gabinete Bioseguridad Clase II A2** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.6.3 | 90139 | **Gabinete Bioseguridad Clase II A2** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.4.4 | 90140 | **Incinerador electrico de asas** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.3.3_C | 90141 | **Placas frias** | 5 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.3.1 | 90145 | **Estacion Trabajo Anatomia Patologica** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.2.10.4 | 100002 | **Andador Plegable, con asiento, con Ruedas** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.15.3.8 | 100002 | **Andador Plegable, con asiento, con Ruedas** | 10 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | C.1.6.3.1 | 100002 | **Andador Plegable, con asiento, con Ruedas** | 6 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.1.3.3.5 | 100002 | **Andador Plegable, con asiento, con Ruedas** | 5 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.10.4 | 100003 | **Andador Sin Ruedas** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.10.5 | 100003 | **Andador Sin Ruedas** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.15.3.8 | 100003 | **Andador Sin Ruedas** | 10 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | C.1.6.3.1 | 100003 | **Andador Sin Ruedas** | 6 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y | 3 dias | Edificio N°2 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 20:00 Hrs. | | |
| Critica | B.3.5.3.5 | 100003 | **Andador Sin Ruedas** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | D.1.31.3.1 | 100003 | **Andador Sin Ruedas** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.1.31.3.5 | 100003 | **Andador Sin Ruedas** | 6 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.1.3.3.5 | 100003 | **Andador Sin Ruedas** | 5 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | D.2.32.3.5 | 100003 | **Andador Sin Ruedas** | 6 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.3.33.3.5 | 100003 | **Andador Sin Ruedas** | 6 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.4.34.3.5 | 100003 | **Andador Sin Ruedas** | 6 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.5.35.3.5 | 100003 | **Andador Sin Ruedas** | 6 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.6.36.3.5 | 100003 | **Andador Sin Ruedas** | 6 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.5.2 | 100003 | **Andador Sin Ruedas** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.2.39.4.2 | 100003 | **Andador Sin Ruedas** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.3.40.4.2 | 100003 | **Andador Sin Ruedas** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 00:00 y las 24:00 Hrs. | | |
| Muy Critica | F.4.41.4.2 | 100003 | **Andador Sin Ruedas** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | C.1.6.2.10 | 100004 | **Anteojos De Lectura Con Iman** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.12 | 100005 | **Antiequino Con Funda** | 10 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.10 | 100006 | **Arbol De Ejercicios** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.12 | 100006 | **Arbol De Ejercicios** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.3 | 100006 | **Arbol De Ejercicios** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.15.2.24 | 100007 | **Arco Para Hombro** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | C.1.6.2.12 | 100009 | **Banca Terapeutica** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.15.2.14 | 100010 | **Baño Parafina** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | C.1.6.2.6 | 100010 | **Baño Parafina** | 4 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.6.3 | 100011 | **Barras Paralelas** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.15.2.12 | 100011 | **Barras Paralelas** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.15.2.9 | 100011 | **Barras Paralelas** | 3 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | C.1.6.1.11 | 100011 | **Barras Paralelas** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.3 | 100011 | **Barras Paralelas** | 2 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.15.2.11 | 100012 | **Barras Paralelas Plano Inclinado** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.12 | 100012 | **Barras Paralelas Plano Inclinado** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.12 | 100013 | **Baston Ortopedico De Codera Fija** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.3.8 | 100013 | **Baston Ortopedico De Codera Fija** | 10 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | C.1.6.3.1 | 100013 | **Baston Ortopedico De Codera Fija** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.10.4 | 100014 | **Baston Ortopedico De Codera Movil** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.15.3.8 | 100014 | **Baston Ortopedico De Codera Movil** | 10 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | C.1.6.3.1 | 100014 | **Baston Ortopedico De Codera Movil** | 12 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.15.2.12 | 100015 | **Baston Ortopedico De Cuatro Apoyos** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | C.1.6.3.1 | 100016 | **Baston Telescopico Plegable** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.15.2.24 | 100017 | **Bicicleta De Mano** | 4 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.9 | 100017 | **Bicicleta De Mano** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | C.1.6.2.12 | 100017 | **Bicicleta De Mano** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.2 | 100017 | **Bicicleta De Mano** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.3 | 100017 | **Bicicleta De Mano** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.15.2.11 | 100018 | **Bicicleta Ergonometrica Horizontal** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.9 | 100018 | **Bicicleta Ergonometrica Horizontal** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | C.1.6.2.2 | 100018 | **Bicicleta Ergonometrica Horizontal** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.3 | 100018 | **Bicicleta Ergonometrica Horizontal** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.10.4 | 100020 | **Bicicleta Ergonometrica Vertical** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.15.2.12 | 100020 | **Bicicleta Ergonometrica Vertical** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.9 | 100020 | **Bicicleta Ergonometrica Vertical** | 5 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | C.1.6.1.11 | 100020 | **Bicicleta Ergonometrica Vertical** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | C.1.6.2.2 | 100020 | **Bicicleta Ergonometrica Vertical** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.15.2.33 | 100021 | **Calentador De Compresas** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | C.1.6.2.6 | 100021 | **Calentador De Compresas** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.16 | 100021 | **Calentador De Compresas** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.15.2.27 | 100022 | **Calentador Para Trabajo Termoplastico** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | C.1.6.2.16 | 100022 | **Calentador Para Trabajo Termoplastico** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.10.4 | 100023 | **Cama Elastica (Mini)** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.15.2.9 | 100023 | **Cama Elastica (Mini)** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | C.1.6.2.2 | 100023 | **Cama Elastica (Mini)** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.15.2.12 | 100024 | **Camilla De Bipdestacion** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.9 | 100024 | **Camilla De Bipdestacion** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | C.1.6.2.3 | 100024 | **Camilla De Bipdestacion** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.09.2.10 | 100024 | **Camilla De Bipdestacion** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | C.1.6.2.11 | 100024 | **Camilla De Bipdestacion** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.15.2.12 | 100025 | **Camilla Neurologica (Bobath)** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | C.1.6.2.10 | 100025 | **Camilla Neurologica (Bobath)** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.2 | 100025 | **Camilla Neurologica (Bobath)** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.3 | 100025 | **Camilla Neurologica (Bobath)** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.10.4 | 100026 | **Colchoneta Encatrada** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.6.3 | 100026 | **Colchoneta Encatrada** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.15.2.12 | 100026 | **Colchoneta Encatrada** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.9 | 100026 | **Colchoneta Encatrada** | 5 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | C.1.6.1.11 | 100026 | **Colchoneta Encatrada** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.11 | 100026 | **Colchoneta Encatrada** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.10.4 | 100027 | **Colchoneta Jumbo** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.2 | 100027 | **Colchoneta Jumbo** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.15.2.12B | 100028 | **Colchonetas, juego de 12** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.9 | 100028 | **Colchonetas, juego de 12** | 6 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | C.1.6.2.4 | 100028 | **Colchonetas, juego de 12** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.15.2.6 | 100029 | **Compresor Neumatico** | 3 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | C.1.6.2.1 | 100029 | **Compresor Neumatico** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.15.2.24 | 100030 | **Consola Juegos** | 2 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | C.1.6.2.4 | 100030 | **Consola Juegos** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.12 | 100031 | **Cuñas Para EESS Antiedema** | 6 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.15.2.9 | 100032 | **Dinamometro De Cuadriceps** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | C.1.6.2.2 | 100032 | **Dinamometro De Cuadriceps** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.1.2.2 | 100033 | **Dinamometro de Mano** | 4 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.1.2.4 | 100033 | **Dinamometro De Mano** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.10.4 | 100033 | **Dinamometro De Mano** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | A.2.7.3 | 100033 | **Dinamometro De Mano** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.3 | 100033 | **Dinamometro de mano** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.1.3.3.5 | 100033 | **Dinamometro De Mano** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.15.2.12 | 100035 | **Dinamometro Multiaplicacion** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.12 | 100037 | **Disco Equilibrio Y Fortalecimiento Muscular** | 2 | 2 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | C.1.6.1.11 | 100038 | **Ejercitador De Mano** | 3 | 6 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.12 | 100038 | **Ejercitador De Mano** | 4 | 6 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.3 | 100038 | **Ejercitador De Mano** | 3 | 6 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.15.2.24 | 100039 | **Ejercitador De Mano Y Brazo** | 4 | 6 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | C.1.6.1.11 | 100039 | **Ejercitador De Mano Y Brazo** | 1 | 6 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.3 | 100039 | **Ejercitador De Mano Y Brazo** | 1 | 6 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.3 | 100040 | **Ejercitador De Mano, Brazo Y Hombro** | 2 | 6 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.15.2.12 | 100041 | **Electroestimulador** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 20:00 Hrs. | | |
| Menos Critica | A.15.2.6 | 100041 | **Electroestimulador** | 4 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.2.9.5 | 100042 | **Electroestimulador Biofeedback Miografia Para Incontinencia** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.15.2.7 | 100042 | **Electroestimulador Biofeedback Miografia Para Incontinencia** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.6 | 100044 | **Electroestimulador De Analgesia** | 4 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | C.1.6.1.11 | 100044 | **Electroestimulador De Analgesia** | 4 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.1 | 100044 | **Electroestimulador De Analgesia** | 10 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.1.3.3.5 | 100044 | **Electroestimulador De Analgesia** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.15.2.9 | 100046 | **Disco De Freeman** | 8 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | C.1.6.2.2 | 100046 | **Disco De Freeman** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.15.2.9 | 100048 | **Eliptica** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | C.1.6.2.4 | 100049 | **Enfriador De Compresas** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.2 | 100049 | **Enfriador de compresas** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y | 3 dias | Edificio N°2 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 20:00 Hrs. | | |
| Menos Critica | A.15.2.26 | 100050 | **Equipo Computarizado Para Simulacion Laboral** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.12 | 100052 | **Equipo De Terapia Combinada** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | C.1.6.2.1 | 100052 | **Equipo De Terapia Combinada** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.11.2.3 | 100053 | **Equipo Para Estimulacion Del Habla Y La Deglucion** | 3 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.2.5.5 | 100053 | **Equipo Para Estimulacion Del Habla Y La Deglucion** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.1.3.3.8 | 100053 | **Equipo Para Estimulacion Del Habla Y La Deglucion** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.7 | 100053 | **Equipo Para Estimulacion Del Habla Y La Deglucion** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.15.2.24 | 100054 | **Equipo Terapia De Manos** | 4 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.11 | 100055 | **Escala Esquina Kinesica** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.12 | 100055 | **Escala Esquina Kinesica** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.9 | 100055 | **Escala Esquina Kinesica** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | C.1.6.1.11 | 100055 | **Escala Esquina Kinesica** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | C.1.6.2.2 | 100055 | **Escala Esquina Kinesica** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.15.2.22 | 100056 | **Escalera De Dedos** | 3 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.24 | 100056 | **Escalera de dedos** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.5 | 100056 | **Escalera De Dedos** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | C.1.6.1.11 | 100056 | **Escalera De Dedos** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.12 | 100056 | **Escalera de dedos** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.2 | 100056 | **Escalera de dedos** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.3 | 100056 | **Escalera de dedos** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.13 | 100057 | **Escalerilla Incorporadora** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.15.2.12 | 100058 | **Espaldera** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.9 | 100058 | **Espaldera** | 3 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | C.1.6.2.2 | 100058 | **Espaldera** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.3 | 100058 | **Espaldera** | 2 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.15.2.5 | 100059 | **Espejo De Evaluacion Ortopedica Mural** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.2.5.5 | 100060 | **Espejo De Glatzel** | 2 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.7 | 100060 | **Espejo De Glatzel** | 3 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | H.2.44.5.2 | 100062 | **Grabadora** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | C.1.6.1.11 | 100063 | **Laberintos Magneticos** | 2 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.10 | 100063 | **Laberintos Magneticos** | 2 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.12 | 100063 | **Laberintos Magneticos** | 4 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.1 | 100064 | **Lampara Infrarroja** | 10 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.15 | 100064 | **Lampara Infrarroja** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.3.1 | 100064 | **Lampara Infrarroja** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.15.2.24 | 100065 | **Lijador Bilateral** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.9 | 100067 | **Maquina Universal De Ejercicios** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.15.2.24 | 100068 | **Material de Rehabilitacion Neuropsicologica I** | 2 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | C.1.6.2.12 | 100068 | **Material de Rehabilitacion Neuropsicologica I** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.11.2.2 | 100069 | **Material de Rehabilitacion Neuropsicologica II** | 2 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.24 | 100070 | **Mesa Kanavel** | 2 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | C.1.6.2.10 | 100070 | **Mesa Kanavel** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.10.4 | 100071 | **Mesa Para Cuadriceps** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.15.2.9 | 100071 | **Mesa Para Cuadriceps** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | C.1.6.1.11 | 100071 | **Mesa Para Cuadriceps** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.2 | 100071 | **Mesa Para Cuadriceps** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Muy Critica | H.1.43.4.7 | 100072 | **Equipo de Musica** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | H.1.43.4.9 | 100072 | **Equipo de Musica** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | H.2.44.5.3 | 100072 | **Equipo de Musica** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | H.2.44.5.5 | 100072 | **Equipo de Musica** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 20:00 Hrs. | | |
| Critica | A.2.4.7 | 100072 | **Equipo de Musica** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.4.8 | 100072 | **Equipo de Musica** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.11.2.3 | 100072 | **Equipo de Musica** | 3 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.14.2.8 | 100072 | **Equipo de Musica** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.2.10.2 | 100073 | **Monofilamento** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.15.2.24 | 100074 | **Pinzas Largo Alcance** | 2 | 3 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | C.1.6.2.2 | 100076 | **Plataforma Vibratoria** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.15.2.9 | 100077 | **Polea Doble** | 3 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | C.1.6.1.11 | 100077 | **Polea Doble** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.2 | 100077 | **Polea Doble** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.3 | 100077 | **Polea Doble** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.15.2.12 | 100078 | **Pronosupinadora** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.15.2.24 | 100078 | **Pronosupinadora** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.9 | 100078 | **Pronosupinadora** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | C.1.6.2.12 | 100078 | **Pronosupinadora** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.10.4 | 100079 | **Rampas Plegables** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.15.2.9 | 100080 | **Rodillera Articulada** | 3 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.2.10.4 | 100081 | **Rollos Terapeuticos** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.15.2.12 | 100081 | **Rollos Terapeuticos** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.9 | 100081 | **Rollos Terapeuticos** | 2 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | C.1.6.1.11 | 100081 | **Rollos Terapeuticos** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.2 | 100081 | **Rollos Terapeuticos** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.3 | 100081 | **Rollos Terapeuticos** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.3.1 | 100081 | **Rollos Terapeuticos** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.11 | 100081 | **Rollos Terapeuticos** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.15.2.9 | 100082 | **Rueda de Hombro** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.12B | 100083 | **Set Conos Terapeuticos** | 3 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.24 | 100083 | **Set Conos Terapeuticos** | 4 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | C.1.6.1.11 | 100084 | **Set Aditamiento Para Vestuario** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.13 | 100084 | **Set Aditamiento Para Vestuario** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Muy Critica | H.1.43.4.7 | 100085 | **Set Balones Terapeuticos** | 2 | 3 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.2.10.4 | 100085 | **Set Balones Terapeuticos** | 1 | 3 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.6.3 | 100085 | **Set Balones Terapeuticos** | 1 | 3 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.15.2.12 | 100085 | **Set Balones Terapeuticos** | 1 | 3 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.9 | 100085 | **Set Balones Terapeuticos** | 3 | 3 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | C.1.6.2.2 | 100085 | **Set Balones Terapeuticos** | 1 | 3 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.3 | 100085 | **Set Balones Terapeuticos** | 1 | 3 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.15.2.12B | 100087 | **Set Cuñas** | 1 | 3 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.15.2.9 | 100087 | **Set Cuñas** | 6 | 3 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.24 | 100088 | **Set de Evaluacion Alimentacion** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.3.5.4.3 | 100088 | **Set de Evaluacion Alimentacion** | 3 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.1.3.4.3 | 100088 | **Set de Evaluacion Alimentacion** | 3 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.1.4.4.3 | 100088 | **Set de Evaluacion Alimentacion** | 3 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Muy Critica | H.1.43.4.7 | 100089 | **Set Evaluacion Cognitiva LOTCA** | 6 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.2.4.7 | 100089 | **Set Evaluacion Cognitiva LOTCA** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.3.5.4.3 | 100089 | **Set Evaluacion Cognitiva LOTCA** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.1.3.4.3 | 100089 | **Set Evaluacion Cognitiva LOTCA** | 3 | 5 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.1.4.4.3 | 100089 | **Set Evaluacion Cognitiva LOTCA** | 3 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.15.2.24 | 100090 | **Set Implementos Terapeuticos** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.25 | 100091 | **Set Instrumentos Y Vajilla Especializada Para AVD** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | C.1.6.2.14 | 100091 | **Set Instrumentos Y Vajilla Especializada Para AVD** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y | 3 dias | Edificio N°2 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 20:00 Hrs. | | |
| Menos Critica | A.15.2.12 | 100092 | **Set Perros Terapeuticos** | 2 | 3 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.24 | 100092 | **Set Perros Terapeuticos** | 4 | 3 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | H.1.43.4.7 | 100093 | **Set Ejercicios Dedos Y Manos** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.12 | 100093 | **Set Ejercicios Dedos Y Manos** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.24 | 100093 | **Set Ejercicios Dedos Y Manos** | 10 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.9 | 100093 | **Set Ejercicios Dedos Y Manos** | 3 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | C.1.6.1.11 | 100093 | **Set Ejercicios Dedos Y Manos** | 6 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.3.5.4.3 | 100093 | **Set Ejercicios Dedos Y Manos** | 3 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.1.3.4.3 | 100093 | **Set Ejercicios Dedos Y Manos** | 3 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.1.4.4.3 | 100093 | **Set Ejercicios Dedos Y Manos** | 3 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.15.2.25 | 100095 | **Set Electrodomesticos** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.26 | 100096 | **Set Entrenamiento Laboral** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.15.2.24 | 100098 | **Set Evaluacion Manos** | 2 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.5 | 100098 | **Set Evaluacion Manos** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.2.10.4 | 100099 | **Set Goniometros** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.15.2.24 | 100099 | **Set Goniometros** | 2 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.5 | 100099 | **Set Goniometros** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.27 | 100100 | **Set Herramientas Ortesis** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | C.1.6.2.16 | 100100 | **Set Herramientas Ortesis** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.15.2.12 | 100101 | **Set Pesas Y Mancuernas** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.9 | 100101 | **Set Pesas Y Mancuernas** | 4 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | C.1.6.2.2 | 100101 | **Set Pesas Y Mancuernas** | 2 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.3 | 100101 | **Set Pesas Y Mancuernas** | 2 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.10 | 100102 | **Set Tableros De Discriminacion De Formas** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.10 | 100103 | **Set Tableros Montessori** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | A.2.10.4 | 100104 | **Sistema Con Arnes Para Rehabilitacion De La Marcha** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.3 | 100104 | **Sistema Con Arnes Para Rehabilitacion De La Marcha** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | C.1.6.2.5 | 100105 | **Sistema Equilibrio SD** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.15.2.12 | 100106 | **Sistema Evaluacion Dinamica De La Marcha** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.24 | 100107 | **Sistema Suspension Antigravedad** | 4 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.2.4.7 | 100108 | **Software De Estimulacion Cognitiva** | 1 | 7 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.15.2.11 | 100109 | **Step** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.12 | 100109 | **Step** | 2 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.9 | 100109 | **Step** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | C.1.6.2.10 | 100109 | **Step** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.10.2 | 100110 | **Tabla Bidireccional De Equilibrio** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.10.4 | 100110 | **Tabla Bidireccional De Equilibrio** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.10.5 | 100110 | **Tabla Bidireccional De Equilibrio** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y | 3 dias | Edificio N°2 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 20:00 Hrs. | | |
| Menos Critica | A.15.2.12 | 100110 | **Tabla Bidireccional De Equilibrio** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.9 | 100110 | **Tabla Bidireccional De Equilibrio** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | C.1.6.2.10 | 100110 | **Tabla Bidireccional De Equilibrio** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.15.2.12 | 100112 | **Tablero Estimulacion De Percepcion** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.24 | 100112 | **Tablero Estimulacion De Percepcion** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.12 | 100113 | **Treadmill** | 1 | 9 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.9 | 100113 | **Treadmill** | 3 | 9 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | C.1.6.2.2 | 100113 | **Treadmill** | 2 | 9 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.15.2.14 | 100114 | **Turbion De Extremidades** | 5 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.6 | 100115 | **Ultrasonido** | 6 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | C.1.6.2.1 | 100115 | **Ultrasonido** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.15.2.6 | 100116 | **Ultratermia** | 6 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | C.1.6.2.15 | 100117 | **Alza Baño** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.15.2.6 | 100118 | **Camilla Examen Kinesiologica** | 8 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | C.1.6.2.1 | 100119 | **Camilla Examen Kinesiologica Geriatrica** | 18 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Muy Critica | H.1.43.4.7 | 100120 | **Colchonetas, juego de 10** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.11 | 100120 | **Colchonetas, juego de 10** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | C.1.6.2.2 | 100120 | **Colchonetas, juego de 10** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.3 | 100120 | **Colchonetas, juego de 10** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.15.2.9 | 100123 | **Escala Esquina Kinesica 3 y 4 peldaños** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.12 | 100124 | **Espejo De Evaluacion Ortopedica Movil** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.9 | 100124 | **Espejo De Evaluacion Ortopedica Movil** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | C.1.6.2.2 | 100124 | **Espejo De Evaluacion Ortopedica Movil** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.15.2.24 | 100125 | **Espejo de Fonoaudiologia** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.11.2.3 | 100125 | **Espejo de Fonoaudiologia** | 3 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.15.2.21_B | 100126 | **Mouse Paciente Neurologico** | 4 | 2 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.21_B | 100127 | **Pantalla Tactil** | 2 | 3 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.21B | 100128 | **Puntero Cefalico** | 2 | 2 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.21_B | 100129 | **Software Comunicacion Alternativa** | 4 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.21_B | 100130 | **Software Convertidor Texto-Voz** | 1 | 5 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | C.1.6.2.16 | 100132 | **Pistola Aire Caliente** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.7 | 100133 | **Videograbadora** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.15.2.11 | 100134 | **Sistema para Rehabilitacion Cardiologica con monitoreo y telemetria** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.15 | 100138 | **Elevador para piscina** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | H.2.44.5.3 | 100139 | **Set de Arte** | 1 | 3 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | H.1.43.4.7 | 100142 | **Set Juego de Mesa** | 3 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | H.2.44.5.3 | 100142 | **Set Juego de Mesa** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.15.2.12 | 110001 | **Almohadilla De Equilibrio** | 2 | 2 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.4.5 | 110002 | **Alza Ropa** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.2.39.3.5 | 110002 | **Alza Ropa** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.3.40.3.5 | 110002 | **Alza Ropa** | 8 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.1.31.3.5 | 110002 | **Alza Ropa** | 8 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.2.32.3.5 | 110002 | **Alza Ropa** | 8 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.3.33.3.5 | 110002 | **Alza Ropa** | 8 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.4.34.3.5 | 110002 | **Alza Ropa** | 8 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.5.35.3.5 | 110002 | **Alza Ropa** | 8 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.6.36.3.5 | 110002 | **Alza Ropa** | 8 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | G.42.3.5 | 110002 | **Alza Ropa** | 8 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.3.5.4.5 | 110002 | **Alza Ropa** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y | 3 dias | Edificio N°2 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 20:00 Hrs. | | |
| Critica | B.1.3.3.5 | 110002 | **Alza Ropa** | 14 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Muy Critica | F.4.41.3.5 | 110002 | **Alza Ropa** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.4.1 | 110003 | **Archivador De Laminas Histologicas** | 10 | 20 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.5.2 | 110003 | **Archivador De Laminas Histologicas** | 1 | 20 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.5.4 | 110003 | **Archivador De Laminas Histologicas** | 5 | 20 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.4.1 | 110004 | **Armario Bloques De Parafina** | 10 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | C.1.6.2.15 | 110005 | **Banca Transferencia** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | I.2.46.3.1 | 110006 | **Bandeja Porta-Objetos (Laminas Histologicas)** | 50 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.5.2 | 110007 | **Baño Portatil** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.2.39.4.2 | 110007 | **Baño Portatil** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.3.40.4.2 | 110007 | **Baño Portatil** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | C.1.6.2.15 | 110007 | **Baño Portatil** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Muy Critica | F.4.41.4.2 | 110007 | **Baño Portatil** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.19.2.18 | 110009 | **Biombo Clinico** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.2.7 | 110009 | **Biombo Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.1.2.3 | 110009 | **Biombo Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.3.3 | 110009 | **Biombo Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.9.5 | 110009 | **Biombo Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | I.3.47.5.1 | 110010 | **Biombo Plomado** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.3.47.7.1 | 110010 | **Biombo Plomado** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.2.8 | 110011 | **Caja Seguridad Para Alcoholemias** | 1 | 15 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.6.5 | 110013 | **Camilla Cadaveres** | 2 | 15 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.7.5 | 110013 | **Camilla Cadaveres** | 6 | 15 | 95% | Lunes a Domingo entre | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 00:00 y las 24:00 Hrs. | | |
| Menos Critica | A.09.2.6 | 110014 | **Camilla De Examen EEG** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.11.2.6 | 110014 | **Camilla De Examen EEG** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.11.2.7 | 110014 | **Camilla De Examen EEG** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.11.2.8 | 110014 | **Camilla De Examen EEG** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.4.4_B | 110015 | **Camilla Examen** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.3.47.4.2 | 110015 | **Camilla Examen** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.09.2.8 | 110015 | **Camilla Examen** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.03.2.1 | 110015 | **Camilla Examen** | 11 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.03.2.2 | 110015 | **Camilla Examen** | 3 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.03.2.3 | 110015 | **Camilla Examen** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.03.2.4 | 110015 | **Camilla Examen** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.04.2.1 | 110015 | **Camilla Examen** | 11 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.04.2.2 | 110015 | **Camilla Examen** | 2 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.04.2.3 | 110015 | **Camilla Examen** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.05.2.1 | 110015 | **Camilla Examen** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.06.2.1 | 110015 | **Camilla Examen** | 3 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.06.2.2 | 110015 | **Camilla Examen** | 11 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.06.2.3 | 110015 | **Camilla Examen** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.06.2.4 | 110015 | **Camilla Examen** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.07.2.1 | 110015 | **Camilla Examen** | 3 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.07.2.2 | 110015 | **Camilla Examen** | 4 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.07.2.3 | 110015 | **Camilla Examen** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.07.2.4 | 110015 | **Camilla Examen** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.09.2.12 | 110015 | **Camilla Examen** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.09.2.13 | 110015 | **Camilla Examen** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | A.10.2.13 | 110015 | **Camilla Examen** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.11.2.1 | 110015 | **Camilla Examen** | 8 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.11.2.4 | 110015 | **Camilla Examen** | 2 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.3 | 110015 | **Camilla Examen** | 2 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.7 | 110015 | **Camilla Examen** | 4 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.9 | 110015 | **Camilla Examen** | 2 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.5.2 | 110015 | **Camilla Examen** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.5.3 | 110015 | **Camilla Examen** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.14.2.6 | 110015 | **Camilla Examen** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.3 | 110015 | **Camilla Examen** | 4 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.7 | 110015 | **Camilla Examen** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.16.2.7 | 110015 | **Camilla Examen** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.2.5 | 110015 | **Camilla Examen** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.17.2.6 | 110015 | **Camilla Examen** | 7 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.18.2.10 | 110015 | **Camilla Examen** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.18.2.5 | 110015 | **Camilla Examen** | 3 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.18.2.6 | 110015 | **Camilla Examen** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.18.2.7 | 110015 | **Camilla Examen** | 5 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.18.2.8 | 110015 | **Camilla Examen** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.19.2.3 | 110015 | **Camilla Examen** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.21.1.3 | 110015 | **Camilla Examen** | 5 | 12 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.22.2.1 | 110015 | **Camilla Examen** | 2 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.22.2.2 | 110015 | **Camilla Examen** | 3 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.22.2.5 | 110015 | **Camilla Examen** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.24.1.8 | 110015 | **Camilla Examen** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.3.29.1.2 | 110015 | **Camilla Examen** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 20:00 Hrs. | | |
| Critica | I.3.47.6.1 | 110015 | **Camilla Examen** | 4 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | H.1.43.4.3 | 110015 | **Camilla Examen** | 2 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.19.2.16 | 110015 | **Camilla Examen** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.19.2.17 | 110015 | **Camilla Examen** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.19.2.18 | 110015 | **Camilla Examen** | 2 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | H.2.44.5.2 | 110015 | **Camilla Examen** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.3.47.10.1 | 110015 | **Camilla Examen** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.21 | 110015 | **Camilla Examen** | 2 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.22 | 110015 | **Camilla Examen** | 3 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.5 | 110015 | **Camilla Examen** | 2 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.09.2.1 | 110015 | **Camilla Examen** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.09.2.11 | 110015 | **Camilla Examen** | 3 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.09.2.9 | 110015 | **Camilla Examen** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.10 | 110015 | **Camilla Examen** | 2 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.11.2.3 | 110015 | **Camilla Examen** | 3 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.8 | 110015 | **Camilla Examen** | 2 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.4.4 | 110015 | **Camilla Examen** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.4.5 | 110015 | **Camilla Examen** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.14.2.11 | 110015 | **Camilla Examen** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.14.2.8 | 110015 | **Camilla Examen** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.14.2.8_A | 110015 | **Camilla Examen** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.21.1.11 | 110015 | **Camilla Examen** | 2 | 12 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.21.1.4 | 110015 | **Camilla Examen** | 3 | 12 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.21.1.6 | 110015 | **Camilla Examen** | 2 | 12 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Critica | A.22.2.4 | 110015 | **Camilla Examen** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.1.2.1 | 110016 | **Camilla Examen Geriatrica** | 7 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.1.2.2 | 110016 | **Camilla Examen Geriatrica** | 7 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.1.2.3 | 110016 | **Camilla Examen Geriatrica** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.1.2.4 | 110016 | **Camilla Examen Geriatrica** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.1.2.5 | 110016 | **Camilla Examen Geriatrica** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.1.2.6 | 110016 | **Camilla Examen Geriatrica** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.10.2 | 110016 | **Camilla Examen Geriatrica** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.10.7 | 110016 | **Camilla Examen Geriatrica** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.2.2 | 110016 | **Camilla Examen Geriatrica** | 5 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.2.3 | 110016 | **Camilla Examen Geriatrica** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.3.2 | 110016 | **Camilla Examen Geriatrica** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.3.3 | 110016 | **Camilla Examen Geriatrica** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | A.2.5.2 | 110016 | **Camilla Examen Geriatrica** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.5.3 | 110016 | **Camilla Examen Geriatrica** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.5.4 | 110016 | **Camilla Examen Geriatrica** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.6.2 | 110016 | **Camilla Examen Geriatrica** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.8.2 | 110016 | **Camilla Examen Geriatrica** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.8.4 | 110016 | **Camilla Examen Geriatrica** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.9.3 | 110016 | **Camilla Examen Geriatrica** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.9.5 | 110016 | **Camilla Examen Geriatrica** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.1.3.3.8 | 110016 | **Camilla Examen Geriatrica** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.7 | 110016 | **Camilla Examen Geriatrica** | 3 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.4.2 | 110016 | **Camilla Examen Geriatrica** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.4.3 | 110016 | **Camilla Examen Geriatrica** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.4.6 | 110016 | **Camilla Examen Geriatrica** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y | 3 dias | Edificio N°2 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 20:00 Hrs. | | |
| Critica | B.26.2.7 | 110019 | **Camilla Ginecologica** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.24.1.8 | 110019 | **Camilla Ginecologica** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.3 | 110021 | **Camilla Quirurgica Oftalmologica** | 5 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.3 | 110021 | **Camilla Quirurgica Oftalmologica** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.2.5 | 110022 | **Camilla Reanimacion** | 3 | 10 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.08.2.5 | 110023 | **Camilla Traslado** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.08.2.6 | 110023 | **Camilla Traslado** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.08.2.7 | 110023 | **Camilla Traslado** | 3 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.08.2.8 | 110023 | **Camilla Traslado** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.11 | 110023 | **Camilla Traslado** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.14 | 110023 | **Camilla Traslado** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.11 | 110023 | **Camilla Traslado** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 20:00 Hrs. | | |
| Menos Critica | A.15.2.4 | 110023 | **Camilla Traslado** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.3.3 | 110023 | **Camilla Traslado** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.18.2.11 | 110023 | **Camilla Traslado** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.18.2.12 | 110023 | **Camilla Traslado** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.22.2.6 | 110023 | **Camilla Traslado** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.2.2 | 110023 | **Camilla Traslado** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.3.1 | 110023 | **Camilla Traslado** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.3.2 | 110023 | **Camilla Traslado** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.3.3 | 110023 | **Camilla Traslado** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.4.1 | 110023 | **Camilla Traslado** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.4.2 | 110023 | **Camilla Traslado** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 00:00 y las 24:00 Hrs. | | |
| Critica | B.26.4.3 | 110023 | **Camilla Traslado** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.8 | 110023 | **Camilla Traslado** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.9.1 | 110023 | **Camilla Traslado** | 16 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.1.31.3.8 | 110023 | **Camilla Traslado** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.1.31.4.2 | 110023 | **Camilla Traslado** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.2.32.3.8 | 110023 | **Camilla Traslado** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.2.32.4.2 | 110023 | **Camilla Traslado** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.3.33.3.8 | 110023 | **Camilla Traslado** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.3.33.4.2 | 110023 | **Camilla Traslado** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | D.4.34.3.8 | 110023 | **Camilla Traslado** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.4.34.4.2 | 110023 | **Camilla Traslado** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.5.35.3.8 | 110023 | **Camilla Traslado** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.5.35.4.2 | 110023 | **Camilla Traslado** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.6.36.3.8 | 110023 | **Camilla Traslado** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.6.36.4.2 | 110023 | **Camilla Traslado** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.1.3.8 | 110023 | **Camilla Traslado** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.1.4.2 | 110023 | **Camilla Traslado** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.2.5.1 | 110023 | **Camilla Traslado** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | G.42.3.8 | 110023 | **Camilla Traslado** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24:00 Hrs. | | |
| Critica | G.42.4.2 | 110023 | **Camilla Traslado** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | H.1.43.4.2 | 110023 | **Camilla Traslado** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.3.47.4.3 | 110023 | **Camilla Traslado** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | I.4.48.5.2.a | 110023 | **Camilla Traslado** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | I.4.48.5.2 | 110023 | **Camilla Traslado** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | H.1.43.2.7 | 110023 | **Camilla Traslado** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.19.2.19 | 110023 | **Camilla Traslado** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | H.2.44.3.6 | 110023 | **Camilla Traslado** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.1.2 | 110023 | **Camilla Traslado** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.03.2.5 | 110023 | **Camilla Traslado** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.08.2.10 | 110023 | **Camilla Traslado** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.09.2.7 | 110023 | **Camilla Traslado** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 20:00 Hrs. | | |
| Critica | A.10.2.15 | 110023 | **Camilla Traslado** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.8 | 110023 | **Camilla Traslado** | 3 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.9 | 110023 | **Camilla Traslado** | 3 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.4.3 | 110023 | **Camilla Traslado** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.5.1 | 110023 | **Camilla Traslado** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.5.2 | 110023 | **Camilla Traslado** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.5.2 | 110023 | **Camilla Traslado** | 12 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.7.9/C.1.30.1.5 | 110023 | **Camilla Traslado** | 24 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.9.2/C.2.30.1.5 | 110023 | **Camilla Traslado** | 10 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.3.29.3.1/28.11.8 /28.11.9 | 110023 | **Camilla Traslado** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.21.1.5 | 110023 | **Camilla Traslado** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24:00 Hrs. | | |
| Muy Critica | A.23.2.7/A.23.2.8/A.23.2.9 | 110023 | **Camilla Traslado** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.5.49.3.6 | 110023 | **Camilla Traslado** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.2.39.3.5 | 110023 | **Camilla Traslado** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.4.5 | 110023 | **Camilla Traslado** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.12.2.3 | 110023 | **Camilla Traslado** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.12.2.9 | 110023 | **Camilla Traslado** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.3.40.3.5 | 110023 | **Camilla Traslado** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | I.4.48.5.5 | 110023 | **Camilla Traslado** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.1.3.4.2 | 110023 | **Camilla Traslado** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.3.5.4.2 | 110023 | **Camilla Traslado** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | C.1.6.1.3 | 110023 | **Camilla Traslado** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.26.12.2.2 | 110023 | **Camilla Traslado** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.12.2.4 | 110023 | **Camilla Traslado** | 2 | 12 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.12.2.6 | 110023 | **Camilla Traslado** | 2 | 12 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.2.3 | 110023 | **Camilla Traslado** | 2 | 12 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.7 | 110023 | **Camilla Traslado** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.4.4 | 110023 | **Camilla Traslado** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.4.4 | 110023 | **Camilla Traslado** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.2.1 | 110023 | **Camilla Traslado** | 8 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.4.41.3.1 | 110023 | **Camilla Traslado** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.6 | 110025 | **Camilla Urologica** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | A.10.2.7 | 110025 | **Camilla Urologica** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.5 | 110025 | **Camilla Urologica** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | D.2.9.3.4 | 110026 | **Carro 2 Bandejas** | 5 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Muy Critica | J.1.50.4.1 | 110026 | **Carro 2 Bandejas** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | J.1.50.4.3 | 110026 | **Carro 2 Bandejas** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | J.1.50.5.2 | 110026 | **Carro 2 Bandejas** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | J.1.50.6.1 | 110026 | **Carro 2 Bandejas** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | J.1.50.6.3 | 110026 | **Carro 2 Bandejas** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | J.1.50.6.4 | 110026 | **Carro 2 Bandejas** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | J.1.50.7.1 | 110026 | **Carro 2 Bandejas** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | J.1.50.7.3 | 110026 | **Carro 2 Bandejas** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | J.1.50.8.1 | 110026 | **Carro 2 Bandejas** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Critica | J.1.50.8.3 | 110026 | **Carro 2 Bandejas** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | J.1.50.9.1/J.1.50.9.2/J.1.50.9.3 | 110026 | **Carro 2 Bandejas** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.1.3.2.3 | 110026 | **Carro 2 Bandejas** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.17.2.4 | 110026 | **Carro 2 Bandejas** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.2.5 | 110026 | **Carro 2 Bandejas** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.2.7 | 110026 | **Carro 2 Bandejas** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.2.8 | 110026 | **Carro 2 Bandejas** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.2.9 | 110026 | **Carro 2 Bandejas** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.3.1 | 110026 | **Carro 2 Bandejas** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.3.3 | 110026 | **Carro 2 Bandejas** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | K.3.55.2.2 | 110026 | **Carro 2 Bandejas** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | K.3.55.2.4 | 110026 | **Carro 2 Bandejas** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | K.3.55.3.2 | 110026 | **Carro 2 Bandejas** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | I.1.45.1.7 | 110026 | **Carro 2 Bandejas** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.24.1.6 | 110026 | **Carro 2 Bandejas** | 20 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.08.2.2 | 110026 | **Carro 2 Bandejas** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.08.2.5 | 110026 | **Carro 2 Bandejas** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.08.2.6 | 110026 | **Carro 2 Bandejas** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.08.2.7 | 110026 | **Carro 2 Bandejas** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.08.2.8 | 110026 | **Carro 2 Bandejas** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.5 | 110026 | **Carro 2 Bandejas** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.6 | 110026 | **Carro 2 Bandejas** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.14.2.11 | 110026 | **Carro 2 Bandejas** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.1.3.3.4 | 110026 | **Carro 2 Bandejas** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.3.5.3.4 | 110026 | **Carro 2 Bandejas** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | B.3.5.3.5 | 110026 | **Carro 2 Bandejas** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Muy Critica | E.37.1.3.1 | 110026 | **Carro 2 Bandejas** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.8 | 110026 | **Carro 2 Bandejas** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.2.4.2 | 110026 | **Carro 2 Bandejas** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.4.4 | 110026 | **Carro 2 Bandejas** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.2.39.3.4 | 110026 | **Carro 2 Bandejas** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.3.40.3.4 | 110026 | **Carro 2 Bandejas** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.1.31.3.1 | 110026 | **Carro 2 Bandejas** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.2.32.3.1 | 110026 | **Carro 2 Bandejas** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.3.33.3.1 | 110026 | **Carro 2 Bandejas** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | D.4.34.3.1 | 110026 | **Carro 2 Bandejas** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.5.35.3.1 | 110026 | **Carro 2 Bandejas** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.6.36.3.1 | 110026 | **Carro 2 Bandejas** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.18.2.10 | 110026 | **Carro 2 Bandejas** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.25.3.6 | 110026 | **Carro 2 Bandejas** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.1.3.4 | 110026 | **Carro 2 Bandejas** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.2.4.1 | 110026 | **Carro 2 Bandejas** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.4.41.3.4 | 110026 | **Carro 2 Bandejas** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| No Critica | 85.1.0.3 | 110026 | **Carro 2 bandejas** | 5 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| No Critica | K.2.53.2.1 | 110026 | **Carro 2 bandejas** | 3 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Critica | 51.7 / 51.8 | 110026 | **Carro 2 bandejas** | 5 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| No Critica | D.1.8.2.6 | 110026 | **Carro 2 bandejas** | 10 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.27.4.1/C.2.28.5.1 | 110026 | **Carro 2 bandejas** | 8 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | D.2.9.3.1 | 110027 | **Carro Almacenamiento Insumos Y Medicamentos** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2 | 110028 | **Carro Anestesia** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.TM | 110028 | **Carro Anestesia** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.TP | 110028 | **Carro Anestesia** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.U | 110028 | **Carro Anestesia** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.3 | 110028 | **Carro Anestesia** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.2 | 110028 | **Carro Anestesia** | 3 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Critica | C.2.28.10.3 | 110028 | **Carro Anestesia** | 5 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.4 | 110028 | **Carro Anestesia** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.5 | 110028 | **Carro Anestesia** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.4.30.2 | 110028 | **Carro Anestesia** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.4.30.3 | 110028 | **Carro Anestesia** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.TM | 110028 | **Carro Anestesia** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.3 | 110028 | **Carro Anestesia** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.3 | 110028 | **Carro Anestesia** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.4 | 110028 | **Carro Anestesia** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.1.3.1 | 110029 | **Carro Aseo Paciente** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.2.4.3 | 110029 | **Carro Aseo Paciente** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | G.42.3.2 | 110029 | **Carro Aseo Paciente** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.1.31.3.1 | 110029 | **Carro Aseo Paciente** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.2.32.3.1 | 110029 | **Carro Aseo Paciente** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.3.33.3.1 | 110029 | **Carro Aseo Paciente** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.4.34.3.1 | 110029 | **Carro Aseo Paciente** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.5.35.3.1 | 110029 | **Carro Aseo Paciente** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.6.36.3.1 | 110029 | **Carro Aseo Paciente** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.5 | 110030 | **Carro compresero** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.6 | 110030 | **Carro Compresero** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2 | 110030 | **Carro Compresero** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Critica | C.1.27.6.2.TM | 110030 | **Carro Compresero** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.TP | 110030 | **Carro Compresero** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.U | 110030 | **Carro Compresero** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.3 | 110030 | **Carro Compresero** | 5 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.2 | 110030 | **Carro Compresero** | 3 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.3 | 110030 | **Carro Compresero** | 5 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.4 | 110030 | **Carro Compresero** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.5 | 110030 | **Carro Compresero** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.4.30.2 | 110030 | **Carro Compresero** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.4.30.3 | 110030 | **Carro Compresero** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.8 | 110030 | **Carro Compresero** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24:00 Hrs. | | |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.TM | 110030 | **Carro Compresero** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.3 | 110030 | **Carro Compresero** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | H.1.43.3.1 | 110031 | **Carro Curaciones** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.2.2 | 110031 | **Carro Curaciones** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.2.5 | 110031 | **Carro Curaciones** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.2.8 | 110031 | **Carro Curaciones** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.3.3 | 110031 | **Carro Curaciones** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.19.2.18 | 110031 | **Carro Curaciones** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.19.2.5 | 110031 | **Carro Curaciones** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.3.47.4.2 | 110031 | **Carro Curaciones** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.3.47.7.1 | 110031 | **Carro Curaciones** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.05.2.2 | 110031 | **Carro Curaciones** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | A.05.2.3 | 110031 | **Carro Curaciones** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.06.2.3 | 110031 | **Carro Curaciones** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.08.2.10 | 110031 | **Carro curaciones** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.2.2 | 110031 | **Carro Curaciones** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.8 | 110031 | **Carro Curaciones** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.5.3 | 110031 | **Carro Curaciones** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.14.2.12 | 110031 | **Carro Curaciones** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.14.2.9 | 110031 | **Carro Curaciones** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.7.2 | 110031 | **Carro Curaciones** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.9.2/C.2.30.1.5 | 110031 | **Carro curaciones** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.3.29.3.3 | 110031 | **Carro Curaciones** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.1.3.3.1 | 110031 | **Carro Curaciones** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | B.1.3.3.2 | 110031 | **Carro curaciones** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.1.3.3.8 | 110031 | **Carro curaciones** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.3.5.3.5 | 110031 | **Carro curaciones** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.16.2.2 | 110031 | **Carro Curaciones** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.1.3.1 | 110031 | **Carro Curaciones** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.23.2.7/A.23.2.8/A.23.2.9 | 110031 | **Carro Curaciones** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.3.1 | 110031 | **Carro Curaciones** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.3.2 | 110031 | **Carro Curaciones** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.3.3 | 110031 | **Carro Curaciones** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.4.1 | 110031 | **Carro Curaciones** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | B.26.4.2 | 110031 | **Carro Curaciones** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.4.3 | 110031 | **Carro Curaciones** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.22.2.6 | 110031 | **Carro Curaciones** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.22.3.1 | 110031 | **Carro Curaciones** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.22.4.1 | 110031 | **Carro Curaciones** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | G.42.3.1 | 110031 | **Carro Curaciones** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.1.31.3.1 | 110031 | **Carro Curaciones** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.2.32.3.1 | 110031 | **Carro Curaciones** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.3.33.3.1 | 110031 | **Carro Curaciones** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.4.34.3.1 | 110031 | **Carro Curaciones** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.5.35.3.1 | 110031 | **Carro Curaciones** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 00:00 y las 24:00 Hrs. | | |
| Critica | D.6.36.3.1 | 110031 | **Carro Curaciones** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.12.2.1 | 110031 | **Carro Curaciones** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.12.2.5 | 110031 | **Carro Curaciones** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.2.10.7 | 110031 | **Carro Curaciones** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.26.4.4 | 110031 | **Carro Curaciones** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.4.4 | 110031 | **Carro Curaciones** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | I.4.48.5.2 | 110031 | **Carro Curaciones** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | I.4.48.5.2.a | 110031 | **Carro Curaciones** | 3 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | I.4.48.5.5 | 110031 | **Carro Curaciones** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.11.2.4 | 110031 | **Carro Curaciones** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Critica | H.1.43.3.1 | 110032 | **Carro De Paro** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.1.2.6 | 110032 | **Carro De Paro** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.17.2.1 | 110032 | **Carro De Paro** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.19.2.12 | 110032 | **Carro De Paro** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.19.2.13 | 110032 | **Carro De Paro** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | H.2.44.4.1 | 110032 | **Carro De Paro** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | A.2.2.3 | 110032 | **Carro De Paro** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | I.3.47.8.2 | 110032 | **Carro De Paro** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.31 | 110032 | **Carro De Paro** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | A.05.2.4 | 110032 | **Carro De Paro** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.08.2.1 | 110032 | **Carro De Paro** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.09.2.10 | 110032 | **Carro De Paro** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.09.2.2 | 110032 | **Carro De Paro** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.09.2.7 | 110032 | **Carro De Paro** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.1 | 110032 | **Carro De Paro** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.2.1 | 110032 | **Carro De Paro** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.14.2.1 | 110032 | **Carro De Paro** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.5.2 | 110032 | **Carro De Paro** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.7.1 | 110032 | **Carro De Paro** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.9.2/C.2.30.1.5 | 110032 | **Carro De Paro** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.3.29.3.3 | 110032 | **Carro De Paro** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.1.3.3.1 | 110032 | **Carro De Paro** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | B.3.5.3.1 | 110032 | **Carro De Paro** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Critica | C.4.30.2 | 110032 | **Carro De Paro** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.4.30.3 | 110032 | **Carro De Paro** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.1.3.1 | 110032 | **Carro De Paro** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.23.2.1 | 110032 | **Carro De Paro** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.2.5 | 110032 | **Carro De Paro** | 3 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.6 | 110032 | **Carro De Paro** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.9.1 | 110032 | **Carro De Paro** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.2.4.1 | 110032 | **Carro De Paro** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.22.3.1 | 110032 | **Carro De Paro** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | G.42.3.1 | 110032 | **Carro De Paro** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.4.1 | 110032 | **Carro De Paro** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24:00 Hrs. | | |
| Muy Critica | F.2.39.3.1 | 110032 | **Carro De Paro** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.3.40.3.1 | 110032 | **Carro De Paro** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.1.31.3.1 | 110032 | **Carro De Paro** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.2.32.3.1 | 110032 | **Carro De Paro** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.3.33.3.1 | 110032 | **Carro De Paro** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.4.34.3.1 | 110032 | **Carro De Paro** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.5.35.3.1 | 110032 | **Carro De Paro** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.6.36.3.1 | 110032 | **Carro De Paro** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.4.5 | 110032 | **Carro De Paro** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Critica | I.4.48.5.2.a | 110032 | **Carro De Paro** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.4.41.3.1 | 110032 | **Carro De Paro** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | H.1.43.3.1 | 110033 | **Carro Fichas Y Rx** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.4.1 | 110033 | **Carro Fichas Y Rx** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.2.39.3.1 | 110033 | **Carro Fichas Y Rx** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.3.40.3.1 | 110033 | **Carro Fichas Y Rx** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.1.31.3.1 | 110033 | **Carro Fichas Y Rx** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.2.32.3.1 | 110033 | **Carro Fichas Y Rx** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.3.33.3.1 | 110033 | **Carro Fichas Y Rx** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.4.34.3.1 | 110033 | **Carro Fichas Y Rx** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | D.5.35.3.1 | 110033 | **Carro Fichas Y Rx** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.6.36.3.1 | 110033 | **Carro Fichas Y Rx** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.1.3.3.1 | 110033 | **Carro Fichas Y Rx** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.3.5.3.1 | 110033 | **Carro Fichas Y Rx** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Muy Critica | E.37.1.3.1 | 110033 | **Carro Fichas Y Rx** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.2.4.1 | 110033 | **Carro Fichas Y Rx** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | G.42.3.1 | 110033 | **Carro Fichas Y Rx** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.4.41.3.1 | 110033 | **Carro Fichas Y Rx** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.10 | 110034 | **Carro Instrumental Yeso** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.7 | 110034 | **Carro Instrumental Yeso** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Critica | J.1.50.6.4 | 110035 | **Carro Porta Rollos** | 3 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | H.1.43.3.4 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.2.7 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.19.2.11 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.19.2.12 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.19.2.13 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | H.2.44.3.6 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.2.2.3 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.3.3 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.5.4 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.8.2 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.9.2 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.9.3 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y | 3 dias | Edificio N°2 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 20:00 Hrs. | | |
| Critica | A.2.9.4 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.9.5 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | I.3.47.4.3 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.3.47.8.1 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.3.47.8.1 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.4 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | I.4.48.6.1 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.03.2.5 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.08.2.5 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.08.2.6 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.08.2.7 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 3 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.08.2.8 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | A.10.2.15 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.5 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.6 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.7 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.8 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 3 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.9 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 3 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.5.2 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.7.2 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.7.1 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.3.29.3.1/C.3.28.11.8 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.3.5.3.5 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.16.2.7 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.21.1.5 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.1.3.8 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.2.5 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 3 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.8 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.9.1 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.2.4.2 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 3 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.5.49.3.6 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.22.2.6 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.22.3.1 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 3 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.22.4.1 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 3 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | G.42.3.1 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 00:00 y las 24:00 Hrs. | | |
| Critica | G.42.3.8 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | G.42.3.2 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.4.2 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.2.39.3.2 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.3.40.3.2 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.1.31.3.8 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.2.32.3.1 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.2.32.3.8 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.3.33.3.1 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.3.33.3.8 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 00:00 y las 24:00 Hrs. | | |
| Critica | D.4.34.3.1 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.4.34.3.8 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.5.35.3.1 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.5.35.3.8 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.6.36.3.1 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.6.36.3.8 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.12.2.4 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.18.2.11 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.18.2.12 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | I.4.48.6.1.a | 110036 | **Carro Procedimientos** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Critica | C.2.28.10.3 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.4.41.3.2 | 110036 | **Carro Procedimientos** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2 | 110037 | **Carro Quirurgico** | 3 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.TM | 110037 | **Carro Quirurgico** | 6 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.TP | 110037 | **Carro Quirurgico** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.U | 110037 | **Carro Quirurgico** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.3 | 110037 | **Carro Quirurgico** | 10 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.2 | 110037 | **Carro Quirurgico** | 6 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.3 | 110037 | **Carro Quirurgico** | 12 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.4 | 110037 | **Carro Quirurgico** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.5 | 110037 | **Carro Quirurgico** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | I.2.46.7.4 | 110038 | **Carro Transporte Cadaver** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.7.4 | 110039 | **Carro Transporte Cadaver Paciente Bariatrico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | J.1.50.4.1 | 110040 | **Carro Transporte Material Contaminado** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.08.2.3 | 110040 | **Carro Transporte Material Contaminado** | 3 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.1.3.3 | 110040 | **Carro Transporte Material Contaminado** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.2.4.3 | 110040 | **Carro Transporte Material Contaminado** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | G.42.3.3 | 110040 | **Carro Transporte Material Contaminado** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.4.3 | 110040 | **Carro Transporte Material Contaminado** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.2.39.3.3 | 110040 | **Carro Transporte Material Contaminado** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.3.40.3.3 | 110040 | **Carro Transporte Material Contaminado** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | D.1.31.3.3 | 110040 | **Carro Transporte Material Contaminado** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.2.32.3.3 | 110040 | **Carro Transporte Material Contaminado** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.3.33.3.3 | 110040 | **Carro Transporte Material Contaminado** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.4.34.3.3 | 110040 | **Carro Transporte Material Contaminado** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.5.35.3.3 | 110040 | **Carro Transporte Material Contaminado** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.6.36.3.3 | 110040 | **Carro Transporte Material Contaminado** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.4.41.3.3 | 110040 | **Carro Transporte Material Contaminado** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| No Critica | D.1.8.2.6 | 110041 | **Carro Transporte Material Esteril** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Muy Critica | J.1.50.7.1 | 110041 | **Carro Transporte Material Esteril** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | J.1.50.7.3 | 110041 | **Carro Transporte Material Esteril** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Critica | J.1.50.8.1 | 110041 | **Carro Transporte Material Esteril** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | J.1.50.8.3 | 110041 | **Carro Transporte Material Esteril** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.19.2.5 | 110041 | **Carro Transporte Material Esteril** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | K.3.54.3.6 | 110041 | **Carro Transporte Material Esteril** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.24.1.9 | 110041 | **Carro Transporte Material Esteril** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.3.3 | 110041 | **Carro Transporte Material Esteril** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.1.3.2 | 110041 | **Carro Transporte Material Esteril** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.2.4.2 | 110041 | **Carro Transporte Material Esteril** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | G.42.3.2 | 110041 | **Carro Transporte Material Esteril** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.4.2 | 110041 | **Carro Transporte Material Esteril** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.2.39.3.2 | 110041 | **Carro Transporte Material Esteril** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 00:00 y las 24:00 Hrs. | | |
| Muy Critica | F.3.40.3.2 | 110041 | **Carro Transporte Material Esteril** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.1.31.3.2 | 110041 | **Carro Transporte Material Esteril** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.2.32.3.2 | 110041 | **Carro Transporte Material Esteril** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.3.33.3.2 | 110041 | **Carro Transporte Material Esteril** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.4.34.3.2 | 110041 | **Carro Transporte Material Esteril** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.5.35.3.2 | 110041 | **Carro Transporte Material Esteril** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.6.36.3.2 | 110041 | **Carro Transporte Material Esteril** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.4.41.3.2 | 110041 | **Carro Transporte Material Esteril** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | D.2.9.3.4 | 110042 | **Carro Transporte Y Distribucion Dosis Unitaria** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Critica | I.4.48.5.1 | 110043 | **Contenedor De Desechos Plomado** | 2 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.1.2.1 | 110045 | **Disco De Transferencia** | 7 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.1.2.2 | 110045 | **Disco De Transferencia** | 7 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.1.2.4 | 110045 | **Disco De Transferencia** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.8.2 | 110045 | **Disco De Transferencia** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.10.7 | 110045 | **Disco De Transferencia** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.1.11 | 110045 | **Disco De Transferencia** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.13 | 110045 | **Disco De Transferencia** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.3.5.3.1 | 110045 | **Disco De Transferencia** | 3 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.1.3.4.5 | 110045 | **Disco De Transferencia** | 10 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.1.3.4.7 | 110045 | **Disco De Transferencia** | 4 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Muy Critica | A.23.2.6 | 110046 | **Divan Examen** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.12 | 110047 | **Elevador De Paciente** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | B.3.5.3.5 | 110047 | **Elevador De Paciente** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | G.42.3.5 | 110047 | **Elevador De Paciente** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.1.3.5 | 110047 | **Elevador De Paciente** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.1.31.4.3 | 110047 | **Elevador De Paciente** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.1.3.3.5 | 110047 | **Elevador De Paciente** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | D.2.32.3.5 | 110047 | **Elevador De Paciente** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.2.32.4.3 | 110047 | **Elevador De Paciente** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.3.33.3.5 | 110047 | **Elevador De Paciente** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.4.34.3.5 | 110047 | **Elevador De Paciente** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.5.35.3.5 | 110047 | **Elevador De Paciente** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24:00 Hrs. | | |
| Critica | D.6.36.3.5 | 110047 | **Elevador De Paciente** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.3.40.3.1 | 110047 | **Elevador De Paciente** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.09.2.10 | 110048 | **Escabel** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.12 | 110048 | **Escabel** | 2 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.4.1 | 110048 | **Escabel** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.09.2.1 | 110048 | **Escabel** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.09.2.6 | 110048 | **Escabel** | 2 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.11.2.6 | 110048 | **Escabel** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.11.2.7 | 110048 | **Escabel** | 2 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.11.2.8 | 110048 | **Escabel** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.2.5 | 110048 | **Escabel** | 3 | 12 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Critica | C.1.27.6.3 | 110048 | **Escabel** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.22.3.4 | 110051 | **Mesa Alimentacion** | 12 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.22.4.4 | 110051 | **Mesa Alimentacion** | 12 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.TP | 110052 | **Mesa Arsenalera** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2 | 110052 | **Mesa Arsenalera** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.2 | 110052 | **Mesa Arsenalera** | 3 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.4 | 110052 | **Mesa Arsenalera** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.5 | 110052 | **Mesa Arsenalera** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.4.30.2 | 110052 | **Mesa Arsenalera** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.4.30.3 | 110052 | **Mesa Arsenalera** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.2.9 | 110052 | **Mesa Arsenalera** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Critica | C.1.27.6.2.TM | 110052 | **Mesa Arsenalera** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.U | 110052 | **Mesa Arsenalera** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.3 | 110052 | **Mesa Arsenalera** | 6 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.3 | 110052 | **Mesa Arsenalera** | 10 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.TM | 110052 | **Mesa Arsenalera** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.3 | 110052 | **Mesa Arsenalera** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.3 | 110052 | **Mesa Arsenalera** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.4 | 110052 | **Mesa Arsenalera** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.2.5.5 | 110053 | **Mesa Con Escotadura** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.10 | 110053 | **Mesa Con Escotadura** | 2 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.12 | 110053 | **Mesa Con Escotadura** | 6 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | C.1.6.2.14 | 110053 | **Mesa Con Escotadura** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.15 | 110053 | **Mesa Con Escotadura** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.2 | 110053 | **Mesa Con Escotadura** | 2 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.3 | 110053 | **Mesa Con Escotadura** | 3 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.7 | 110053 | **Mesa Con Escotadura** | 3 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.15.2.12 | 110054 | **Mesa De Bipedestacion** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.24 | 110054 | **Mesa De Bipedestacion** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.2.7 | 110056 | **Mesa Ginecologica** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.2.8 | 110056 | **Mesa Ginecologica** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.2.9.2 | 110056 | **Mesa Ginecologica** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.9.4 | 110056 | **Mesa Ginecologica** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.03.2.5 | 110058 | **Mesa Mayo** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.9 | 110058 | **Mesa Mayo** | 3 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.14.2.12 | 110058 | **Mesa Mayo** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.14.2.9 | 110058 | **Mesa Mayo** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.18.2.11 | 110058 | **Mesa Mayo** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.19.2.18 | 110058 | **Mesa Mayo** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.21.1.5 | 110058 | **Mesa Mayo** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.22.2.6 | 110058 | **Mesa Mayo** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.2.5 | 110058 | **Mesa Mayo** | 3 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.6 | 110058 | **Mesa Mayo** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.8 | 110058 | **Mesa Mayo** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2 | 110058 | **Mesa Mayo** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.2 | 110058 | **Mesa Mayo** | 3 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Critica | C.4.30.2 | 110058 | **Mesa Mayo** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.4.30.3 | 110058 | **Mesa Mayo** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.1.31.3.8 | 110058 | **Mesa Mayo** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.2.32.3.8 | 110058 | **Mesa Mayo** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.3.33.3.8 | 110058 | **Mesa Mayo** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.4.34.3.8 | 110058 | **Mesa Mayo** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.5.35.3.8 | 110058 | **Mesa Mayo** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.6.36.3.8 | 110058 | **Mesa Mayo** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.1.3.8 | 110058 | **Mesa Mayo** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | G.42.3.8 | 110058 | **Mesa Mayo** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24:00 Hrs. | | |
| Critica | I.3.47.8.1 | 110058 | **Mesa Mayo** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.3.47.8.1 | 110058 | **Mesa Mayo** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | I.4.48.6.1.a | 110058 | **Mesa Mayo** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | I.4.48.6.1 | 110058 | **Mesa Mayo** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | H.1.43.2.7 | 110058 | **Mesa mayo** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.2.5 | 110058 | **Mesa mayo** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.19.2.19 | 110058 | **Mesa mayo** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.3.47.7.1 | 110058 | **Mesa Mayo** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.05.2.4 | 110058 | **Mesa mayo** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.09.2.13 | 110058 | **Mesa Mayo** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.10 | 110058 | **Mesa Mayo** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.8 | 110058 | **Mesa Mayo** | 3 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 20:00 Hrs. | | |
| Menos Critica | A.11.2.4 | 110058 | **Mesa Mayo** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.11.2.8 | 110058 | **Mesa mayo** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.13.5 | 110058 | **Mesa Mayo** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.13.6 | 110058 | **Mesa Mayo** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.5.2 | 110058 | **Mesa Mayo** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.5.3 | 110058 | **Mesa Mayo** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.5.4 | 110058 | **Mesa Mayo** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.14.2.10 | 110058 | **Mesa Mayo** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.14.2.6 | 110058 | **Mesa Mayo** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.14.2.8_A | 110058 | **Mesa Mayo** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.5.2 | 110058 | **Mesa Mayo** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.TM | 110058 | **Mesa mayo** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24:00 Hrs. | | |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.TP | 110058 | **Mesa mayo** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.U | 110058 | **Mesa mayo** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.3 | 110058 | **Mesa mayo** | 6 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.7.2 | 110058 | **Mesa mayo** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.4 | 110058 | **Mesa mayo** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.5 | 110058 | **Mesa Mayo** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.9.2/C.2.30.1.5 | 110058 | **Mesa Mayo** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.23.2.7/A.23.2.8/A.23.2.9 | 110058 | **Mesa mayo** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.5.2 | 110058 | **Mesa Mayo** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.7 | 110058 | **Mesa Mayo** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.18.2.12 | 110058 | **Mesa mayo** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.1.3.3.8 | 110058 | **Mesa Mayo** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.1.2.5 | 110058 | **Mesa Mayo** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.1.2.6 | 110058 | **Mesa Mayo** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.2.3 | 110058 | **Mesa Mayo** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.3.3 | 110058 | **Mesa Mayo** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.5.4 | 110058 | **Mesa Mayo** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.8.2 | 110058 | **Mesa Mayo** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.26.4.5 | 110058 | **Mesa Mayo** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.9.1 | 110058 | **Mesa Mayo** | 16 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.TM | 110058 | **Mesa Mayo** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.3 | 110058 | **Mesa Mayo** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 20:00 Hrs. | | |
| Menos Critica | A.17.2.8 | 110059 | **Mesa Para Toma De Muestras** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.18.2.10 | 110059 | **Mesa Para Toma De Muestras** | 2 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.24.1.6 | 110059 | **Mesa Para Toma De Muestras** | 20 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.24.1.8 | 110059 | **Mesa Para Toma De Muestras** | 2 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.12.2.3 | 110059 | **Mesa Para Toma De Muestras** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.2.8 | 110059 | **Mesa Para Toma De Muestras** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.1.2.5 | 110059 | **Mesa Para Toma De Muestras** | 2 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | D.1.31.4.3 | 110060 | **Mobiliario Clinico Paciente Hospitalizado Electrico** | 28 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.1.31.4.5 | 110060 | **Mobiliario Clinico Paciente Hospitalizado Electrico** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.2.32.4.3 | 110060 | **Mobiliario Clinico Paciente Hospitalizado Electrico** | 28 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | D.2.32.4.5 | 110060 | **Mobiliario Clinico Paciente Hospitalizado Electrico** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.3.33.4.3 | 110060 | **Mobiliario Clinico Paciente Hospitalizado Electrico** | 28 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.3.33.4.5 | 110060 | **Mobiliario Clinico Paciente Hospitalizado Electrico** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.4.34.4.3 | 110060 | **Mobiliario Clinico Paciente Hospitalizado Electrico** | 28 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.4.34.4.5 | 110060 | **Mobiliario Clinico Paciente Hospitalizado Electrico** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.5.35.4.3 | 110060 | **Mobiliario Clinico Paciente Hospitalizado Electrico** | 28 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.5.35.4.5 | 110060 | **Mobiliario Clinico Paciente Hospitalizado Electrico** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.6.36.4.3 | 110060 | **Mobiliario Clinico Paciente Hospitalizado Electrico** | 28 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.6.36.4.5 | 110060 | **Mobiliario Clinico Paciente Hospitalizado Electrico** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.1.31.4.3 | 110060 | **Mobiliario Clinico Paciente Hospitalizado Electrico** | 28 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24:00 Hrs. | | |
| Critica | D.1.31.4.5 | 110060 | **Mobiliario Clinico Paciente Hospitalizado Electrico** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.2.32.4.3 | 110060 | **Mobiliario Clinico Paciente Hospitalizado Electrico** | 28 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.2.32.4.5 | 110060 | **Mobiliario Clinico Paciente Hospitalizado Electrico** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.3.33.4.3 | 110060 | **Mobiliario Clinico Paciente Hospitalizado Electrico** | 28 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.3.33.4.5 | 110060 | **Mobiliario Clinico Paciente Hospitalizado Electrico** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.4.34.4.3 | 110060 | **Mobiliario Clinico Paciente Hospitalizado Electrico** | 28 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.4.34.4.5 | 110060 | **Mobiliario Clinico Paciente Hospitalizado Electrico** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.5.35.4.3 | 110060 | **Mobiliario Clinico Paciente Hospitalizado Electrico** | 28 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.5.35.4.5 | 110060 | **Mobiliario Clinico Paciente Hospitalizado Electrico** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | D.6.36.4.3 | 110060 | **Mobiliario Clinico Paciente Hospitalizado Electrico** | 28 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.6.36.4.5 | 110060 | **Mobiliario Clinico Paciente Hospitalizado Electrico** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.6.36.4.5 | 110060 | **Mobiliario Clinico Paciente Hospitalizado Electrico** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | G.42.4.3 | 110060 | **Mobiliario Clinico Paciente Hospitalizado Electrico** | 44 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.1.4.3 | 110061 | **Mobiliario Clinico Paciente Hospitalizado Electrico Radiolucido** | 18 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.2.5.2 | 110061 | **Mobiliario Clinico Paciente Hospitalizado Electrico Radiolucido** | 12 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.1.3.4.5 | 110062 | **Mobiliario Clinico Paciente Hospitalizado Geriatrico** | 42 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.1.3.4.7 | 110062 | **Mobiliario Clinico Paciente Hospitalizado Geriatrico** | 8 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.3.5.4.5 | 110062 | **Mobiliario Clinico Paciente Hospitalizado Geriatrico** | 12 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Muy Critica | H.1.43.4.3 | 110064 | **Mobiliario Paciente Psiquiatrico** | 20 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Critica | H.1.43.4.4b | 110064 | **Mobiliario Paciente Psiquiatrico** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.5.1 | 110065 | **Mobiliario Paciente UCI** | 6 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.2.39.4.1 | 110065 | **Mobiliario Paciente UCI** | 6 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.3.40.4.1 | 110065 | **Mobiliario Paciente UCI** | 5 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.4.41.4.1 | 110065 | **Mobiliario Paciente UCI** | 6 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.5.2 | 110066 | **Mobiliario Paciente UTI** | 12 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.2.39.4.2 | 110066 | **Mobiliario Paciente UTI** | 11 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.3.40.4.2 | 110066 | **Mobiliario Paciente UTI** | 11 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.4.41.4.2 | 110066 | **Mobiliario Paciente UTI** | 12 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.25.3.5 | 110067 | **Mueble Con Gavetas Y Cajetines Transparentes** | 1 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Critica | K.3.55.2.2 | 110067 | **Mueble Con Gavetas Y Cajetines Transparentes** | 2 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | K.3.55.3.2 | 110067 | **Mueble Con Gavetas Y Cajetines Transparentes** | 2 | 15 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | J.1.50.4.3 | 110068 | **Mueble Organizador De Endoscopios** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.08.2.9 | 110068 | **Mueble Organizador De Endoscopios** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.03.2.5 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.06.2.4 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.08.2.5 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.08.2.6 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.08.2.7 | 110069 | **Piso Clinico** | 3 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.08.2.8 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.09.2.11 | 110069 | **Piso Clinico** | 3 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.10 | 110069 | **Piso Clinico** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.13 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 20:00 Hrs. | | |
| Critica | A.10.2.5 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.6 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.7 | 110069 | **Piso Clinico** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.8 | 110069 | **Piso Clinico** | 3 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.9 | 110069 | **Piso Clinico** | 3 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.11.2.6 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.11.2.7 | 110069 | **Piso Clinico** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.11.2.8 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.7 | 110069 | **Piso Clinico** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.4.1 | 110069 | **Piso Clinico** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.4.2 | 110069 | **Piso Clinico** | 6 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.4.3 | 110069 | **Piso Clinico** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.13.4.4 | 110069 | **Piso Clinico** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.4.5 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.4.6 | 110069 | **Piso Clinico** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.5.2 | 110069 | **Piso Clinico** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.5.3 | 110069 | **Piso Clinico** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.5.4 | 110069 | **Piso Clinico** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.14.2.10 | 110069 | **Piso Clinico** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.14.2.11 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.14.2.12 | 110069 | **Piso Clinico** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.14.2.5 | 110069 | **Piso Clinico** | 6 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.14.2.9 | 110069 | **Piso Clinico** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.11 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.4 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.17.2.6 | 110069 | **Piso Clinico** | 7 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.2.7 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.2.8 | 110069 | **Piso Clinico** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.3.1 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.3.3 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.3.4 | 110069 | **Piso Clinico** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.18.2.10 | 110069 | **Piso Clinico** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.18.2.11 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.19.2.18 | 110069 | **Piso Clinico** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.21.1.5 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.22.2.6 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.22.3.1 | 110069 | **Piso Clinico** | 3 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.22.4.1 | 110069 | **Piso Clinico** | 3 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 20:00 Hrs. | | |
| Muy Critica | A.22.4.2 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.23.2.2 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.23.2.5 | 110069 | **Piso Clinico** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.24.1.6 | 110069 | **Piso Clinico** | 20 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.24.1.8 | 110069 | **Piso Clinico** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.24.1.9 | 110069 | **Piso Clinico** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.12.2.2 | 110069 | **Piso Clinico** | 8 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.12.2.3 | 110069 | **Piso Clinico** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.12.2.5 | 110069 | **Piso Clinico** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.12.2.6 | 110069 | **Piso Clinico** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.2.5 | 110069 | **Piso Clinico** | 3 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24:00 Hrs. | | |
| Critica | B.26.3.1 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.3.2 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.3.3 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.4.1 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.4.2 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.4.3 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.7 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.8 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2 | 110069 | **Piso Clinico** | 6 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Critica | C.2.28.10.2 | 110069 | **Piso Clinico** | 6 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.4 | 110069 | **Piso Clinico** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.5 | 110069 | **Piso Clinico** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | I.2.46.3.1 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.3.29.1.2 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.4.30.2 | 110069 | **Piso Clinico** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.4.30.3 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.1.31.3.8 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.2.32.3.8 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.3.33.3.8 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.4.34.3.8 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24:00 Hrs. | | |
| Critica | D.5.35.3.8 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.6.36.3.8 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.1.3.8 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | G.42.3.8 | 110069 | **Piso Clinico** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.3.47.6.1 | 110069 | **Piso Clinico** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.3.47.7.1 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | I.4.48.5.2.a | 110069 | **Piso Clinico** | 3 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | I.4.48.5.2 | 110069 | **Piso Clinico** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | I.4.48.6.1 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | H.1.43.2.7 | 110069 | **Piso Clinico** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.2.9 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 20:00 Hrs. | | |
| Muy Critica | A.19.2.19 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.3.47.10.1 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.15 | 110069 | **Piso Clinico** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.7 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.05.2.3 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.14 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.15 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.4 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.4.4_B | 110069 | **Piso Clinico** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.14.2.13 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.TM | 110069 | **Piso Clinico** | 7 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.TP | 110069 | **Piso Clinico** | 3 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24:00 Hrs. | | |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.U | 110069 | **Piso Clinico** | 3 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.3 | 110069 | **Piso Clinico** | 9 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.23.2.7/A.23.2.8/A.23.2.9 | 110069 | **Piso Clinico** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.12.2.4 | 110069 | **Piso Clinico** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | I.4.48.6.1.a | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | I.4.48.5.5 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.1.2.5 | 110069 | **Piso Clinico** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.10.5 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.3.3 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.5.4 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.5.5 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | A.2.9.2 | 110069 | **Piso Clinico** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.9.3 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.9.4 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.9.5 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.12 | 110069 | **Piso Clinico** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Muy Critica | D.2.9.3.2 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.2.3 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.8.2 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.1.3.3.8 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.1 | 110069 | **Piso Clinico** | 5 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.16 | 110069 | **Piso Clinico** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.26.4.4 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | B.26.4.4 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.9.1 | 110069 | **Piso Clinico** | 16 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.TM | 110069 | **Piso Clinico** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.3 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.3 | 110069 | **Piso Clinico** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.4 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.4 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.4.41.3.3 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.2.4.3.8 | 110069 | **Piso Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.26.6.1 | 110070 | **Piso Taburete Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.4.2 | 110070 | **Piso Taburete Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24:00 Hrs. | | |
| Muy Critica | F.2.39.3.2 | 110070 | **Piso Taburete Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.3.40.3.2 | 110070 | **Piso Taburete Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.3.40.3.3 | 110070 | **Piso Taburete Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.3.4 | 110070 | **Piso Taburete Clinico** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.3.5 | 110070 | **Piso Taburete Clinico** | 3 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.4.2 | 110070 | **Piso Taburete Clinico** | 8 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.4.3 | 110070 | **Piso Taburete Clinico** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.4.4 | 110070 | **Piso Taburete Clinico** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.4.6 | 110070 | **Piso Taburete Clinico** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.4.7 | 110070 | **Piso Taburete Clinico** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.5.2 | 110070 | **Piso Taburete Clinico** | 9 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | I.1.45.5.3 | 110070 | **Piso Taburete Clinico** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.5.4 | 110070 | **Piso Taburete Clinico** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.6.2 | 110070 | **Piso Taburete Clinico** | 5 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.6.3 | 110070 | **Piso Taburete Clinico** | 5 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.7.3 | 110070 | **Piso Taburete Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.8.2 | 110070 | **Piso Taburete Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.3.1 | 110070 | **Piso Taburete Clinico** | 6 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.3.5 | 110070 | **Piso Taburete Clinico** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.3.47.4.2 | 110070 | **Piso Taburete Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.5.49.3.1 | 110070 | **Piso Taburete Clinico** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.5.49.3.3 | 110070 | **Piso Taburete Clinico** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.5.49.4.1 | 110070 | **Piso Taburete Clinico** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Critica | J.1.50.5.1 | 110070 | **Piso Taburete Clinico** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | J.1.50.6.1 | 110070 | **Piso Taburete Clinico** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | J.1.50.6.2 | 110070 | **Piso Taburete Clinico** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | J.1.50.6.3 | 110070 | **Piso Taburete Clinico** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | J.1.50.6.4 | 110070 | **Piso Taburete Clinico** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.3.3 | 110070 | **Piso Taburete Clinico** | 3 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.3.3_C | 110070 | **Piso Taburete Clinico** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.3.4 | 110070 | **Piso Taburete Clinico** | 3 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | J.1.50.5.2 | 110070 | **Piso Taburete Clinico** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | K.3.55.2.4 | 110070 | **Piso Taburete Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.1.45.X/45.3.2/45.3.3 | 110070 | **Piso Taburete Clinico** | 8 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Critica | F.4.41.3.2 | 110070 | **Piso Taburete Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.4.41.3.3 | 110070 | **Piso Taburete Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | H.1.43.4.2 | 110073 | **Silla De Ruedas** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.19.4.6 | 110073 | **Silla de ruedas** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.1.2 | 110073 | **Silla De Ruedas** | 6 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.3.8 | 110073 | **Silla De Ruedas** | 4 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | C.1.6.1.3 | 110073 | **Silla De Ruedas** | 3 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Muy Critica | A.08.2.10 | 110073 | **Silla De Ruedas** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.1.4 | 110073 | **Silla De Ruedas** | 6 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.1.3.3.5 | 110073 | **Silla De Ruedas** | 12 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.3.5.3.5 | 110073 | **Silla De Ruedas** | 6 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Muy Critica | E.37.1.4.2 | 110073 | **Silla De Ruedas** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 00:00 y las 24:00 Hrs. | | |
| Muy Critica | A.23.1.2 | 110073 | **Silla De Ruedas** | 4 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.2.2 | 110073 | **Silla De Ruedas** | 5 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | G.42.4.2 | 110073 | **Silla De Ruedas** | 6 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.2.2 | 110073 | **Silla De Ruedas** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.2.39.1.2 | 110073 | **Silla De Ruedas** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.1.31.4.2 | 110073 | **Silla De Ruedas** | 6 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.2.32.4.2 | 110073 | **Silla De Ruedas** | 6 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.3.33.4.2 | 110073 | **Silla De Ruedas** | 6 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.4.34.4.2 | 110073 | **Silla De Ruedas** | 6 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.5.35.4.2 | 110073 | **Silla De Ruedas** | 6 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 00:00 y las 24:00 Hrs. | | |
| Critica | D.6.36.4.2 | 110073 | **Silla De Ruedas** | 6 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.21.1.6 | 110073 | **Silla de ruedas** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.2.5.1 | 110073 | **Silla De Ruedas** | 3 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.22.1.3 | 110073 | **Silla De Ruedas** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | H.2.44.5.1 | 110073 | **Silla De Ruedas** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.05.2.2 | 110073 | **Silla De Ruedas** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.1.5 | 110073 | **Silla De Ruedas** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.2.4.1 | 110073 | **Silla De Ruedas** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.06.1.2 | 110073 | **Silla De Ruedas** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.11 | 110073 | **Silla De Ruedas** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.2.3.1 | 110073 | **Silla De Ruedas** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.12.1.2 | 110073 | **Silla De Ruedas** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.11.1.2 | 110073 | **Silla De Ruedas** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.1.2 | 110073 | **Silla De Ruedas** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.14.1.2 | 110073 | **Silla De Ruedas** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.3.47.4.3 | 110073 | **Silla De Ruedas** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.1.3.3.5 | 110074 | **Silla De Ruedas Neurologica** | 3 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.15.1.2 | 110075 | **Silla De Ruedas Paciente Bariatrico** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.2.2 | 110075 | **Silla De Ruedas Paciente Bariatrico** | 4 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.2.7 | 110076 | **Silla Ducha** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | C.1.6.2.15 | 110076 | **Silla Ducha** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.15 | 110077 | **Silla Para Tina** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | I.5.49.3.6 | 110078 | **Sillon Banco De Sangre** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | A.2.10.3 | 110079 | **Sillon Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.4.2_P | 110079 | **Sillon Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.4.4 | 110079 | **Sillon Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.4.5 | 110079 | **Sillon Clinico** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.05.2.2 | 110079 | **Sillon Clinico** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.05.2.3 | 110079 | **Sillon Clinico** | 3 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.08.2.10 | 110079 | **Sillon Clinico** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.11.2.2 | 110079 | **Sillon Clinico** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.3.29.3.1/C.3.28.11.8 | 110079 | **Sillon Clinico** | 20 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.5.2 | 110079 | **Sillon Clinico** | 5 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.22.3.4 | 110079 | **Sillon Clinico** | 12 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.22.4.4 | 110079 | **Sillon Clinico** | 12 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.5.2 | 110079 | **Sillon Clinico** | 6 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 00:00 y las 24:00 Hrs. | | |
| Muy Critica | F.2.39.4.2 | 110079 | **Sillon Clinico** | 6 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.3.40.4.2 | 110079 | **Sillon Clinico** | 6 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.23.2.4 | 110079 | **Sillon Clinico** | 3 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.23.2.5 | 110079 | **Sillon Clinico** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.2.8.3 | 110079 | **Sillon Clinico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.26.2.7 | 110079 | **Sillon Clinico** | 6 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.4.41.4.1 | 110079 | **Sillon Clinico** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.4.41.4.2 | 110079 | **Sillon Clinico** | 6 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.3.4 | 110080 | **Sillon Dermatologia** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.3.1 | 110080 | **Sillon Dermatologia** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.19.2.11 | 110081 | **Sillon Dialisis** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Critica | A.19.2.12 | 110081 | **Sillon Dialisis** | 12 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.19.2.13 | 110081 | **Sillon Dialisis** | 3 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.2.5.5 | 110082 | **Sillon Geriatrico** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.1.3.4.5 | 110082 | **Sillon Geriatrico** | 42 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.1.3.4.7 | 110082 | **Sillon Geriatrico** | 8 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.3.5.4.5 | 110082 | **Sillon Geriatrico** | 12 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.14.2.9 | 110083 | **Sillon Otorrinolaringologia** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.14.2.10 | 110083 | **Sillon Otorrinolaringologia** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.14.2.12 | 110083 | **Sillon Otorrinolaringologia** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.7 | 110084 | **Sistema Traccion** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | C.1.6.2.13 | 110085 | **Sistema Transferencia Paciente** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2 | 110085 | **Sistema Transferencia Paciente** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Critica | C.2.28.10.2 | 110085 | **Sistema Transferencia Paciente** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.3 | 110085 | **Sistema Transferencia Paciente** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.4.30.2 | 110085 | **Sistema Transferencia Paciente** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.7 | 110085 | **Sistema Transferencia Paciente** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.1.31.3.1 | 110085 | **Sistema Transferencia Paciente** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.2.32.3.1 | 110085 | **Sistema Transferencia Paciente** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.3.33.3.1 | 110085 | **Sistema Transferencia Paciente** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.4.34.3.1 | 110085 | **Sistema Transferencia Paciente** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.5.35.3.1 | 110085 | **Sistema Transferencia Paciente** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.6.36.3.1 | 110085 | **Sistema Transferencia Paciente** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Critica | F.2.39.3.1 | 110085 | **Sistema Transferencia Paciente** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.05.2.3 | 110086 | **Soporte Universal** | 3 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.09.2.10 | 110086 | **Soporte Universal** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.10 | 110086 | **Soporte Universal** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.13 | 110086 | **Soporte Universal** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.6 | 110086 | **Soporte Universal** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.7 | 110086 | **Soporte Universal** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.19.2.12 | 110086 | **Soporte Universal** | 12 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.19.2.13 | 110086 | **Soporte Universal** | 8 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.19.2.18 | 110086 | **Soporte Universal** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.22.3.4 | 110086 | **Soporte Universal** | 12 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.22.4.4 | 110086 | **Soporte Universal** | 12 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.2.7 | 110086 | **Soporte Universal** | 6 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 00:00 y las 24:00 Hrs. | | |
| Critica | B.26.8 | 110086 | **Soporte Universal** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.5.2 | 110086 | **Soporte Universal** | 12 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.2 | 110086 | **Soporte Universal** | 6 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.4 | 110086 | **Soporte Universal** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.5 | 110086 | **Soporte Universal** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.1.31.4.3 | 110086 | **Soporte Universal** | 56 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.1.31.4.5 | 110086 | **Soporte Universal** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.2.32.4.3 | 110086 | **Soporte Universal** | 56 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.2.32.4.5 | 110086 | **Soporte Universal** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.3.33.4.3 | 110086 | **Soporte Universal** | 56 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | D.3.33.4.5 | 110086 | **Soporte Universal** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.4.34.4.3 | 110086 | **Soporte Universal** | 56 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.4.34.4.5 | 110086 | **Soporte Universal** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.5.35.4.3 | 110086 | **Soporte Universal** | 56 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.5.35.4.5 | 110086 | **Soporte Universal** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.6.36.4.3 | 110086 | **Soporte Universal** | 56 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.6.36.4.5 | 110086 | **Soporte Universal** | 3 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.2.5.2 | 110086 | **Soporte Universal** | 12 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | G.42.4.3 | 110086 | **Soporte Universal** | 44 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.5.49.3.6 | 110086 | **Soporte Universal** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24:00 Hrs. | | |
| Muy Critica | A.19.2.11 | 110086 | **Soporte Universal** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.19.2.19 | 110086 | **Soporte Universal** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.5 | 110086 | **Soporte Universal** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.11.2.8 | 110086 | **Soporte Universal** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.TM | 110086 | **Soporte Universal** | 6 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.TP | 110086 | **Soporte Universal** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.U | 110086 | **Soporte Universal** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.3 | 110086 | **Soporte Universal** | 3 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.4.30.2 | 110086 | **Soporte Universal** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.4.30.3 | 110086 | **Soporte Universal** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | B.26.7 | 110086 | **Soporte Universal** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.5.49.3.1 | 110086 | **Soporte Universal** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.3.40.3.5 | 110086 | **Soporte Universal** | 9 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.1.2.6 | 110086 | **Soporte Universal** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.2.3 | 110086 | **Soporte Universal** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.8.2 | 110086 | **Soporte Universal** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.9.3 | 110086 | **Soporte Universal** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.9.4 | 110086 | **Soporte Universal** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.1.3.3.8 | 110086 | **Soporte Universal** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.1.3.4.5 | 110086 | **Soporte Universal** | 21 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.1.3.4.7 | 110086 | **Soporte Universal** | 8 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.3.5.4.5 | 110086 | **Soporte Universal** | 12 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre | 3 dias | Edificio N°2 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 00:00 y las 24:00 Hrs. | | |
| Muy Critica | C.2.28.10.3 | 110086 | **Soporte Universal** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.4.41.3.1 | 110086 | **Soporte Universal** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.4.41.4.1 | 110086 | **Soporte Universal** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | C.1.6.2.13 | 110088 | **Tabla Seguridad Para Tina** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.26.2.5 | 110089 | **Tarima** | 3 | 12 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2 | 110089 | **Tarima** | 2 | 12 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.2 | 110089 | **Tarima** | 3 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.4 | 110089 | **Tarima** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.5 | 110089 | **Tarima** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.TM | 110089 | **Tarima** | 2 | 12 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.TP | 110089 | **Tarima** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Domingo entre | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 00:00 y las 24:00 Hrs. | | |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.U | 110089 | **Tarima** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.3 | 110089 | **Tarima** | 3 | 12 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.3 | 110089 | **Tarima** | 3 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2.TM | 110089 | **Tarima** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.3 | 110089 | **Tarima** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.3 | 110089 | **Tarima** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.4 | 110089 | **Tarima** | 1 | 12 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.14.2.5 | 110091 | **Unidad Otorrinolaringologica Completa** | 6 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.1.3.4.9 | 110093 | **Carro con silla de baño paciente** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Muy Critica | C.2.28.10.3 | 110094 | **Sillon oftalmologia (cirujano)** | 5 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Critica | C.2.28.10.3 | 110094 | **Sillon Oftalmologia (Cirujano)** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.25.3.5 | 110095 | **Armario Estupefaciente** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.25.3.6 | 110095 | **Armario Estupefaciente** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| ANATOMÍA PATOLÓGICA | I.2.46.7.3 | 110097 | **Gabinete Almacenaje De Líquidos Inflamables (Mueble de seguridad)** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.4.6 | 110098 | **Gabinete Almacenaje Sustancias Peligrosas** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.4.6 | 110098 | **Gabinete Almacenaje Sustancias Peligrosas** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.4.30.2 | 110099 | **Armario almacenamiento cateteres** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.4.30.3 | 110099 | **Armario almacenamiento cateteres** | 2 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | I.2.46.3.1 | 110099 | **Gabinete Almacenaje para Formaldehído** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | H.1.43.3.4 | 110102 | **Carro Transporte Material** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.2.4.4 | 110102 | **Carro Transporte Material** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | J.1.50.6.1 | 110103 | **Meson De Revision Material** | 2 | 15 | 95% | Lunes a Domingo entre las 08:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Critica | J.1.50.6.2 | 110104 | **Meson doble preparacion** | 2 | 15 | 95% | Lunes a Domingo entre las 08:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | J.1.50.6.4 | 110104 | **Meson doble preparacion** | 2 | 15 | 95% | Lunes a Domingo entre las 08:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.3.40.4.1 | 110106 | **Mobiliario Paciente UPC Bariatrico** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.2.39.4.2 | 110106 | **Mobiliario Paciente UPC Bariatrico** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.4.41.4.2 | 110106 | **Mobiliario Paciente UPC Bariatrico** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.5 | 110107 | **Nefroscopio** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.4.30.3 | 110108 | **Poligrafo Electrofisiologia** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | K.3.54.3.4 | 110110 | **Carro 3 bandejas** | 7 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | D.2.9.3.4 | 110111 | **Carro Transporte Cerrado** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Muy Critica | K.3.54.3.4 | 110111 | **Carro Transporte Cerrado** | 5 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Critica | 85.1.0.3 | 110112 | **Carro Jaula** | 5 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| No Critica | 85.1.0.3 | 110113 | **Carro Yegua Plegable** | 2 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | K.3.54.3.1 | 110114 | **Carro traslado estéril 4 bandejas** | 10 | 10 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.3.29.3.2 | 130002 | **Central Monitoreo Recuperacion** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.9.2/C.2.30.1.5 | 130002 | **Central Monitoreo Recuperacion** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| N/A | C.2.27.7.9/C.2.30.1.5 | 130002 | **Central Monitoreo Recuperacion** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.4.1 | 130003 | **Central Monitoreo UPC** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.2.39.3.1 | 130003 | **Central Monitoreo UPC** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.3.40.3.1 | 130003 | **Central Monitoreo UPC** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| N/A | F.4.41.3.1 | 130003 | **Central Monitoreo UPC** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24:00 Hrs. | | |
| Menos Critica | A.03.2.3 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.03.2.5 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.04.2.3 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.05.2.3 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.07.2.4 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.08.2.5 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.08.2.6 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.08.2.8 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.09.2.10 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.09.2.11 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 3 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.09.2.13 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | A.10.2.11 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.14 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.7 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.9 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 3 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.13.4 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.3 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.3.4 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.5.1 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.14.2.9 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.11 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.12 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.15.2.5 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.6 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.9 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.16.2.7 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.18.2.11 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.18.2.12 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.19.2.12 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 12 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.22.2.5 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.22.3.4 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 3 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.22.4.4 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 3 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.23.2.5 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | B.26.12.2.3 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.2.3 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.2.7 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 6 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.5.2 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 3 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.9.1 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 16 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.5.2 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 4 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.3.29.1.2 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.4.30.2 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.4.30.3 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.1.31.4.3 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 14 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | D.1.31.3.8 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.1.31.4.5 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 4 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.2.32.3.1 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 14 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.2.32.3.8 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.2.32.4.5 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 4 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.3.33.3.1 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 4 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.3.33.3.8 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.3.33.4.5 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 4 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.4.34.4.3 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 14 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.4.34.3.8 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24:00 Hrs. | | |
| Critica | D.4.34.4.5 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 4 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.5.35.4.3 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 14 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.5.35.3.8 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.5.35.4.5 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 4 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.6.36.4.3 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 14 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.6.36.3.8 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.6.36.4.5 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 3 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.1.4.3 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 6 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | G.42.3.1 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 8 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | G.42.3.8 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.3.47.4.2 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.3.47.4.3 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.08.2.10 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.08.2.7 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 3 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.13 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.11.2.8 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.2.9 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.3.3 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.19.2.11 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 4 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.19.2.14 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Critica | A.19.2.17 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.19.2.18 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.19.2.19 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.7 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | H.1.43.2.7 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | H.1.43.3.1 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 2 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.1.2.2 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 7 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.1.2.6 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.10.7 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.5.2 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.8.2 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | B.1.3.4.5 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 6 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.1.3.4.7 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 8 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.3.5.4.5 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.3.3 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.5.4 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.8.4 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.9.3 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.2.4.4.7 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 4 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.2.4.4.7 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 4 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.26.4.4 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.4.4 | 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | A.05.2.4 | 130007 | **Monitor Desfibrilador** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.22.3.1 | 130007 | **Monitor Desfibrilador** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.9.1 | 130007 | **Monitor Desfibrilador** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.1.31.3.1 | 130007 | **Monitor Desfibrilador** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.2.32.3.1 | 130007 | **Monitor Desfibrilador** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.3.33.3.1 | 130007 | **Monitor Desfibrilador** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.4.34.3.1 | 130007 | **Monitor Desfibrilador** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.5.35.3.1 | 130007 | **Monitor Desfibrilador** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.6.36.3.1 | 130007 | **Monitor Desfibrilador** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | G.42.3.1 | 130007 | **Monitor Desfibrilador** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critica | H.2.44.4.1 | 130007 | **Monitor Desfibrilador** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | I.3.47.8.2 | 130007 | **Monitor Desfibrilador** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.2.1 | 130007 | **Monitor Desfibrilador** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.14.2.1 | 130007 | **Monitor Desfibrilador** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.2.31 | 130007 | **Monitor Desfibrilador** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.2.1 | 130007 | **Monitor Desfibrilador** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.19.2.12 | 130007 | **Monitor Desfibrilador** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.19.2.13 | 130007 | **Monitor Desfibrilador** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.23.2.1 | 130007 | **Monitor Desfibrilador** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.13.5.1 | 130007 | **Monitor Desfibrilador** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.2 | 130007 | **Monitor Desfibrilador** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.6.3 | 130007 | **Monitor Desfibrilador** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Critica | C.2.28.10.2 | 130007 | **Monitor Desfibrilador** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.3 | 130007 | **Monitor Desfibrilador** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.2.28.10.4 | 130007 | **Monitor Desfibrilador** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.4.41.3.1 | 130007 | **Monitor Desfibrilador** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | H.1.43.3.1 | 130007 | **Monitor Desfibrilador** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.08.2.1 | 130007 | **Monitor Desfibrilador** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.09.2.10 | 130007 | **Monitor Desfibrilador** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.09.2.2 | 130007 | **Monitor Desfibrilador** | 2 | 4 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.1 | 130007 | **Monitor Desfibrilador** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.2.5 | 130007 | **Monitor Desfibrilador** | 3 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.6 | 130007 | **Monitor Desfibrilador** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.5.2 | 130007 | **Monitor Desfibrilador** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24:00 Hrs. | | |
| Muy Critica | C.1.27.7.1 | 130007 | **Monitor Desfibrilador** | 1 | 4 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| N/A | C.2.27.7.9/C.2.30.1.5 | 130007 | **Monitor Desfibrilador** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.3.29.3.3 | 130007 | **Monitor Desfibrilador** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.4.30.2 | 130007 | **Monitor Desfibrilador** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.4.30.3 | 130007 | **Monitor Desfibrilador** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.1.3.1 | 130007 | **Monitor Desfibrilador** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.2.4.1 | 130007 | **Monitor Desfibrilador** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.1.38.4.1 | 130007 | **Monitor Desfibrilador** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.2.39.3.1 | 130007 | **Monitor Desfibrilador** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Critica | F.3.40.3.1 | 130007 | **Monitor Desfibrilador** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.1.2.6 | 130007 | **Monitor Desfibrilador** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.2.3 | 130007 | **Monitor Desfibrilador** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | B.1.3.3.1 | 130007 | **Monitor Desfibrilador** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | B.3.5.3.1 | 130007 | **Monitor Desfibrilador** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°2 |
| Critica | I.3.47.4.3 | 130007 | **Monitor Desfibrilador** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.4.5 | 130007 | **Monitor Desfibrilador** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | I.4.48.5.2.a | 130007 | **Monitor Desfibrilador** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.4.41.3.5 | 130007 | **Monitor Desfibrilador** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.4.41.3.1 | 130008 | **Monitor Desfibrilador C/Mpe** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.19.2.13 | 130010 | **Monitor ECG Signos Vitales Baja Complejidad** | 8 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.21.1.5 | 130010 | **Monitor ECG Signos Vitales Baja Complejidad** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.22.2.6 | 130010 | **Monitor ECG Signos Vitales Baja Complejidad** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.22.3.4 | 130010 | **Monitor ECG Signos Vitales Baja Complejidad** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.22.4.4 | 130010 | **Monitor ECG Signos Vitales Baja Complejidad** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.2.5 | 130010 | **Monitor ECG Signos Vitales Baja Complejidad** | 3 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.4.2 | 130010 | **Monitor ECG Signos Vitales Baja Complejidad** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.4.3 | 130010 | **Monitor ECG Signos Vitales Baja Complejidad** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.5.2 | 130010 | **Monitor ECG Signos Vitales Baja Complejidad** | 4 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.1.3.8 | 130010 | **Monitor ECG Signos Vitales Baja Complejidad** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.1.4.3 | 130010 | **Monitor ECG Signos Vitales Baja Complejidad** | 4 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.2.5.2 | 130010 | **Monitor ECG Signos Vitales Baja Complejidad** | 12 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24:00 Hrs. | | |
| Muy Critica | A.08.2.10 | 130010 | **Monitor ECG Signos Vitales Baja Complejidad** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.09.2.7 | 130010 | **Monitor ECG Signos Vitales Baja Complejidad** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.15 | 130010 | **Monitor ECG Signos Vitales Baja Complejidad** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | A.10.2.8 | 130010 | **Monitor ECG Signos Vitales Baja Complejidad** | 3 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.13.5 | 130010 | **Monitor ECG Signos Vitales Baja Complejidad** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.13.6 | 130010 | **Monitor ECG Signos Vitales Baja Complejidad** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.23.2.7/A.23.2.8/A.23.2.9 | 130010 | **Monitor ECG Signos Vitales Baja Complejidad** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | E.37.2.4.5 | 130010 | **Monitor ECG Signos Vitales Baja Complejidad** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.1.3.4.5 | 130010 | **Monitor ECG Signos Vitales Baja Complejidad** | 3 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.3.5.4.5 | 130010 | **Monitor ECG Signos Vitales Baja Complejidad** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.2.3 | 130010 | **Monitor ECG Signos Vitales Baja Complejidad** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.1.3.3.8 | 130010 | **Monitor ECG Signos Vitales Baja Complejidad** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre | 3 dias | Edificio N°2 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 00:00 y las 24:00 Hrs. | | |
| Critica | B.26.2.1 | 130010 | **Monitor ECG Signos Vitales Baja Complejidad** | 8 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.3.1 | 130010 | **Monitor ECG Signos Vitales Baja Complejidad** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.3.2 | 130010 | **Monitor ECG Signos Vitales Baja Complejidad** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.3.3 | 130010 | **Monitor ECG Signos Vitales Baja Complejidad** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.4.1 | 130010 | **Monitor ECG Signos Vitales Baja Complejidad** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.8 | 130011 | **Monitor ECG Signos Vitales Mediana Complejidad** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | I.4.48.6.1 | 130011 | **Monitor ECG Signos Vitales Mediana Complejidad** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | I.4.48.6.1.a | 130011 | **Monitor ECG Signos Vitales Mediana Complejidad** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.4.41.3.1 | 130013 | **Oximetro Ambiental** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.5.2 | 130014 | **Oximetro De Pulso** | 4 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.6 | 130014 | **Oximetro De Pulso** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las | 1 dia | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24:00 Hrs. | | |
| Muy Critica | C.1.27.5.2 | 130014 | **Oximetro De Pulso** | 4 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.1.27.7.1 | 130014 | **Oximetro De Pulso** | 4 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Muy Critica | C.3.29.3.1/28.11.8 /28.11.9 | 130014 | **Oximetro De Pulso** | 12 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 1 dia | Edificio N°1 |
| Critica | D.1.31.3.1 | 130014 | **Oximetro De Pulso** | 4 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.2.32.3.1 | 130014 | **Oximetro De Pulso** | 4 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.3.33.3.1 | 130014 | **Oximetro De Pulso** | 4 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.4.34.3.1 | 130014 | **Oximetro De Pulso** | 4 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.5.35.3.1 | 130014 | **Oximetro De Pulso** | 4 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | D.6.36.3.1 | 130014 | **Oximetro De Pulso** | 4 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | G.42.3.1 | 130014 | **Oximetro De Pulso** | 4 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.1.2.3 | 130014 | **Oximetro De Pulso** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.5.3 | 130014 | **Oximetro De Pulso** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y | 3 dias | Edificio N°2 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las 20:00 Hrs. | | |
| Critica | A.2.5.5 | 130014 | **Oximetro De Pulso** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.10.5 | 130014 | **Oximetro De Pulso** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.1.3.3.2 | 130014 | **Oximetro De Pulso** | 4 | 8 | 97% | Lunes a Domingo entre las 00:00 y las 24:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | B.3.5.3.2 | 130014 | **Oximetro De Pulso** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.10 | 130014 | **Oximetro De Pulso** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.2 | 130014 | **Oximetro De Pulso** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.3 | 130014 | **Oximetro De Pulso** | 2 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.4 | 130014 | **Oximetro De Pulso** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | C.1.6.2.7 | 130014 | **Oximetro De Pulso** | 3 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.15.2.11 | 130015 | **Desfibrilador tipo DEA** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| N/A | I.2.46.6.3 | 130015 | **Desfibrilador tipo DEA** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| N/A | A.7.1.1 | 130015 | **Desfibrilador tipo DEA** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA DE CAPACITACIÓN | 81.2.3 | 130015 | **Desfibrilador tipo DEA** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| N/A | P.2.68.2.2_S1 | 130015 | **Desfibrilador tipo DEA** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| N/A | P.2.68.2.2_P1 | 130015 | **Desfibrilador tipo DEA** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.17.1.1 | 130015 | **Desfibrilador tipo DEA** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.19.1.1 | 130015 | **Desfibrilador tipo DEA** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.25.1.1 | 130015 | **Desfibrilador tipo DEA** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | I.3.47.1.1 | 130015 | **Desfibrilador tipo DEA** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.24.1.1 | 130015 | **Desfibrilador tipo DEA** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.15.1.2 | 130015 | **Desfibrilador tipo DEA** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | C.1.6.1.1 | 130015 | **Desfibrilador tipo DEA** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.03.1.1 | 130015 | **Desfibrilador tipo DEA** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.04.1.1 | 130015 | **Desfibrilador tipo DEA** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| N/A | A.5.5.1.1 | 130015 | **Desfibrilador tipo DEA** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | A.6.6.1.1 | 130015 | **Desfibrilador tipo DEA** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.1.1 | 130015 | **Desfibrilador tipo DEA** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| N/A | 16.1.1/16.1.2 | 130015 | **Desfibrilador tipo DEA** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| N/A | 43.1.1/44.2.1 | 130015 | **Desfibrilador tipo DEA** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| N/A | A.7.1.1/10.1 | 130015 | **Desfibrilador tipo DEA** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| N/A | 8.1.1/27.1.1 | 130015 | **Desfibrilador tipo DEA** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| N/A | 13.1.1/13.1.2/13.1.3 | 130015 | **Desfibrilador tipo DEA** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| N/A | 58.1.1 | 130015 | **Desfibrilador tipo DEA** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.02.1.3 | 130015 | **Desfibrilador tipo DEA** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.02.2.1 | 130015 | **Desfibrilador tipo DEA** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.21.1.1 | 130015 | **Desfibrilador tipo DEA** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.1.3 | 130015 | **Desfibrilador tipo DEA** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | A.22.1.1 | 130015 | **Desfibrilador tipo DEA** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy Critica | F.1.38.2.2 | 130015 | **Desfibrilador tipo DEA** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | F.3.40.1.2 | 130015 | **Desfibrilador tipo DEA** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| N/A | D.1.31.1.1 | 130015 | **Desfibrilador tipo DEA** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| N/A | D.5.35.1.1 | 130015 | **Desfibrilador tipo DEA** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| N/A | D.6.36.1.1 | 130015 | **Desfibrilador tipo DEA** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Critica | B.26.12.1.1 | 130015 | **Desfibrilador tipo DEA** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| N/A | A.18.1.1 | 130015 | **Desfibrilador tipo DEA** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Muy Critica | I.4.48.1.1 | 130015 | **Desfibrilador tipo DEA** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| N/A | 12.1.1/12.3.1 | 130015 | **Desfibrilador tipo DEA** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Menos Critica | A.1.1.1 | 130015 | **Desfibrilador tipo DEA** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.4.1/A.2.8.1/A.2.10.1 | 130015 | **Desfibrilador tipo DEA** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| Critica | A.2.2.1/A.2.3.1/A.2.5.1/A.2.6.1/A.2.7.1/A.2.9.1 | 130015 | **Desfibrilador tipo DEA** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |
| N/A | B.2.4.1.1/5.1.1 | 130015 | **Desfibrilador tipo DEA** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°2 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.12.2.4 | 140001 | **Amalgamador Dental** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.13.6 | 140002 | **Articulador Semiajustable** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.1 | 140003 | **Destartrador Ultrasonico** | 4 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.6 | 140003 | **Destartrador Ultrasonico** | 3 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.13.4 | 140004 | **Hemoaspirador** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.13.5 | 140004 | **Hemoaspirador** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.13.6 | 140004 | **Hemoaspirador** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.1 | 140006 | **Lampara De Fotocurado** | 4 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.3 | 140006 | **Lampara De Fotocurado** | 6 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.4 | 140006 | **Lampara De Fotocurado** | 1 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.5 | 140006 | **Lampara De Fotocurado** | 3 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.6 | 140006 | **Lampara De Fotocurado** | 3 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.1 | 140008 | **Motor Colgante** | 4 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.12.2.13.4 | 140008 | **Motor Colgante** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.2 | 140008 | **Motor Colgante** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.3 | 140008 | **Motor Colgante** | 6 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.5 | 140008 | **Motor Colgante** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.13.5 | 140009 | **Motor Con Irrigacion Para Implantes** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.13.6 | 140009 | **Motor Con Irrigacion Para Implantes** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.3 | 140010 | **Paralelometro** | 6 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.13.6 | 140012 | **Motor cirugia Maxilofacial** | 1 | 8 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.1 | 140013 | **Unidad Dental Completa** | 4 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.13.4 | 140013 | **Unidad Dental Completa** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.2 | 140013 | **Unidad Dental Completa** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.3 | 140013 | **Unidad Dental Completa** | 6 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.4 | 140013 | **Unidad Dental Completa** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

| Zonificación (Anexo H) | Código de recinto referencial Actualizado | Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Cantidad | Vida Útil | Disponibilidad mínima | Disponibilidad programada semestral | Tiempo máximo de parada continua | Edificio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menos Critica | A.12.2.5 | 140013 | **Unidad Dental Completa** | 3 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.6 | 140013 | **Unidad Dental Completa** | 3 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.13.5 | 140014 | **Sillon dental** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.13.6 | 140014 | **Sillon dental** | 1 | 10 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.6 | 140015 | **Localizador apical** | 3 | 10 | 95% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |
| Menos Critica | A.12.2.5 | 140016 | **Articulador Profesional** | 1 | 8 | 97% | Lunes a Viernes entre las 8:00 y las 20:00 Hrs. | 3 dias | Edificio N°1 |

## Anexo 2. Propuesta Tag

| Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Unidades | Equipo a considerar para Tag |
|---|---|---|---|
| 10034 | Electrocardiografo | 43 | SI |
| 20010 | Torre De Video Laparoscopica | 17 | SI |
| 40003 | Bomba Aspiracion Quirurgica | 27 | SI |
| 40004 | Bomba Aspiracion Universal | 30 | SI |
| 40013 | Electrobisturi Baja Potencia | 5 | SI |
| 40014 | Electrobisturi Disector Ultrasonico | 4 | SI |
| 40028 | Lampara Quirurgica Rodable | 2 | SI |
| 40035 | Mango Isquemia Automatico | 10 | SI |
| 40036 | Maquina Anestesia Alta Complejidad | 18 | SI |
| 40038 | Maquina Anestesia Mediana Complejidad | 8 | SI |
| 40039 | Mesa Quirurgica Traumatologia | 4 | SI |
| 40040 | Mesa Quirurgica Universal | 14 | SI |
| 40050 | Unidad Para Electrocirugia Con Fusion De Tejidos | 14 | SI |
| 40051 | Unidad Para Electrocirugia De Alta Potencia | 8 | SI |

| Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Unidades | Equipo a considerar para Tag |
|---|---|---|---|
| 40052 | Unidad Para Electrocirugia De Alta Potencia Con Modulo De Argon | 3 | SI |
| 40084 | Sistema para monitoreo de indica biespectral (BIS) | 2 | SI |
| 50014 | Equipo de Asistencia Respiratoria con Membrana Extracorporea | 1 | SI |
| 50016 | Equipo Regulacion Termica | 1 | SI |
| 50024 | Generador De Pulso Bicameral | 11 | SI |
| 50025 | Generador De Pulso Unicameral | 10 | SI |
| 50026 | Humidificador O2 C/ Calefactor | 65 | SI |
| 50029 | Maquina Hemodialisis | 30 | SI |
| 50031 | Nebulizador Ultrasonico | 4 | SI |
| 50035 | Ventilador De Transporte | 15 | SI |
| 50037 | Ventilador Mecanico No Invasivo | 51 | SI |
| 50038 | Ventilador Volumetrico | 24 | SI |
| 50043 | Maquina Hemodiafiltracion | 5 | SI |
| 50044 | Marcapasos | 1 | SI |
| 80006 | Ecocardiografo | 3 | SI |
| 80007 | Ecotomografo Doppler Color Multiproposito | 8 | SI |
| 80010 | Equipo Rx Arco C | 8 | SI |

| Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Unidades | Equipo a considerar para Tag |
|---|---|---|---|
| 80018 | Rx Portatil | 4 | SI |
| 80026 | Ecotomografo Doppler Tiroides | 1 | SI |
| 80032 | Ecografo doppler para pabellones | 6 | SI |
| 80033 | Ecotomografo doppler portátil | 6 | SI |
| 80034 | Equipo Ecografia intravascular | 1 | SI |
| 80035 | Ecografo Portatil Urologia | 1 | SI |
| 90084 | Sistema Refrigerado Para Almacenamiento Temporal Y Transporte De Sangre Y Hemoderivados | 8 | SI |
| 100041 | Electroestimulador | 5 | SI |
| 100044 | Electroestimulador De Analgesia | 19 | SI |
| 100115 | Ultrasonido | 8 | SI |
| 100116 | Ultratermia | 6 | SI |
| 110065 | Mobiliario Paciente UCI | 23 | SI |
| 110066 | Mobiliario Paciente UTI | 46 | SI |
| 110106 | Mobiliario Paciente UPC Bariatrico | 3 | SI |
| 130002 | Central Monitoreo Recuperacion | 3 | SI |
| 130003 | Central Monitoreo UPC | 8 | SI |

| Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Unidades | Equipo a considerar para Tag |
|---|---|---|---|
| 130006 | Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria | 277 | SI |
| 130007 | Monitor Desfibrilador | 67 | SI |
| 130008 | Monitor Desfibrilador C/Mpe | 2 | SI |
| 130010 | Monitor ECG Signos Vitales Baja Complejidad | 71 | SI |
| 130011 | Monitor ECG Signos Vitales Mediana Complejidad | 3 | SI |
| 130015 | Desfibrilador tipo DEA | 42 | SI |

## Anexo 3. Listado Equipos Backup

| Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Costo adquisición (Pesos) |
|---|---|---|
| 10002 | **Analizador Hidrogeno En Aire Espirado** | 31.349.536 |
| 10031 | **Doppler Vascular** | 48.270.095 |
| 10034 | **Electrocardiografo** | 4.138.531 |
| 10035 | **Electroencefalografo** | 83.428.953 |
| 10039 | **Equipo De Manometria E Impedanciometria Esofagica Y Rectal** | 98.620.585 |
| 10054 | **Lampara Hendidura C/Sistema de Video** | 19.912.442 |
| 10060 | **Localizador Estimulador De Nervio Periferico** | 2.662.242 |
| 10063 | **Medidor Cuff** | 133.706 |
| 10074 | **Oftalmoscopio Binocular indirecto** | 5.553.884 |
| 10104 | **Tonometro Aplanatico Perkins** | 2.612.396 |
| 10119 | **Equipo Doppler Transcraneal** | 46.947.380 |
| 10128 | **Monitor nervio facial** | 38.082.633 |
| 20002 | **Carro de intubacion dificil** | 19.980.235 |
| 20003 | **Torre De Artroscopia** | 163.300.987 |
| 20004 | **Torre De Video Endoscopia Digestiva** | 261.604.041 |
| 20008 | **Torre De Video Endoscopia Urologica** | 213.353.186 |

| Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Costo adquisición (Pesos) |
|---|---|---|
| 20009 | **Torre De Video Endosonografia/Endoscopica** | 394.220.415 |
| 20010 | **Torre De Video Laparoscopica** | 87.541.111 |
| 20011 | **Torre De Video Laparoscopica/Endoscopica** | 170.131.267 |
| 20015 | **Rinovideolaringoscopio** | 38.537.632 |
| 50004 | **Balon Contrapulsacion Aortico** | 132.237.790 |
| 50007 | **Calentador De Fluido** | 3.584.467 |
| 50008 | **Calentador De Paciente** | 1.332.708 |
| 50014 | **Equipo de Asistencia Respiratoria con Membrana Extracorporea** | 248.699.122 |
| 50020 | **Equipo Terapia Electroconvulsiva** | 55.789.948 |
| 50023 | **Gabinete Calentador De Suero** | 4.774.926 |
| 50024 | **Generador De Pulso Bicameral** | 5.240.428 |
| 50025 | **Generador De Pulso Unicameral** | 4.612.418 |
| 50029 | **Maquina Hemodialisis** | 10.653.043 |
| 50035 | **Ventilador De Transporte** | 14.859.719 |
| 50036 | **Ventilador Manual** | 861.329 |
| 50037 | **Ventilador Mecanico No Invasivo** | 17.232.722 |
| 50038 | **Ventilador Volumetrico** | 30.381.815 |
| 50039 | **Bomba Alto Flujo Y Calentador De Sueros** | 10.417.999 |
| 50043 | **Maquina Hemodiafiltracion** | 21.332.771 |

| Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Costo adquisición (Pesos) |
|---|---|---|
| 110108 | **Poligrafo Electrofisiologia** | 120.068.723 |
| 130002 | **Central Monitoreo Recuperacion** | 328.720.497 |
| 130003 | **Central Monitoreo UPC** | 256.861.404 |
| 130006 | **Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria** | 3.028.757 |
| 130007 | **Monitor Desfibrilador** | 7.729.581 |
| 130008 | **Monitor Desfibrilador C/Mpe** | 8.329.376 |
| 130010 | **Monitor ECG Signos Vitales Baja Complejidad** | 3.724.325 |
| 130011 | **Monitor ECG Signos Vitales Mediana Complejidad** | 4.640.515 |
| 130014 | **Oximetro De Pulso** | 371.492 |
| 130015 | **Desfibrilador tipo DEA** | 2.283.814 |
| | | 3.028.150.943 |

## Anexo 4. Estrategias Mantenimiento

Estrategia externa:

| Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Unidades | Frecuencia de mantención | Precio referencial mantenimiento externo unitario (Pesos) | Precio total mantenimiento (Pesos) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10004 | Angiografo Retinal | 2 | Semestral | 550.000 | 2.200.000 |
| 10024 | Campimetro Computarizado | 3 | Semestral | 400.000 | 2.400.000 |
| 10026 | Campimetro Goldman | 2 | Semestral | 450.000 | 1.800.000 |
| 10030 | Doppler Con Pletismografia Vascular | 1 | Anual | 543.000 | 543.000 |
| 10031 | Doppler Vascular | 2 | Anual | 776.000 | 1.552.000 |
| 10032 | Doppler Vascular Portatil | 2 | Anual | 160.000 | 320.000 |
| 10033 | Ecografo Ocular | 3 | Semestral | 388.000 | 2.328.000 |
| 10034 | Electrocardiografo | 43 | Semestral | 200.000 | 17.200.000 |
| 10035 | Electroencefalografo | 3 | Semestral | 480.000 | 2.880.000 |
| 10037 | Electromiografo Con Potenciales Evocados | 1 | Semestral | 800.000 | 1.600.000 |
| 10038 | Electroretinografo | 1 | Semestral | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 10039 | Equipo De Manometria E Impedanciometria Esofagica Y Rectal | 1 | Anual | 300.000 | 300.000 |
| 10040 | Equipo De Potenciales Evocados Con Vem | 1 | Anual | 500.000 | 500.000 |
| 10041 | Equipo Urodinamia | 1 | Semestral | 600.000 | 1.200.000 |
| 10052 | Lampara Hendidura | 14 | Semestral | 150.000 | 4.200.000 |

| Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Unidades | Frecuencia de mantención | Precio referencial mantenimiento externo unitario (Pesos) | Precio total mantenimiento (Pesos) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10054 | Lampara Hendidura C/Sistema De Video | 14 | Semestral | 150.000 | 4.200.000 |
| 10060 | Localizador Estimulador De Nervio Periferico | 18 | Anual | 60.000 | 1.080.000 |
| 10088 | Rinomanometro | 1 | Anual | 450.000 | 450.000 |
| 10092 | Sistema De Posturografia Dinamica | 2 | Anual | 550.000 | 1.100.000 |
| 10095 | Sistema Fotografia Polo Posterior | 1 | Semestral | 600.000 | 1.200.000 |
| 10096 | Sistema Holter ECG Y Presion Arterial | 2 | Anual | 600.000 | 1.200.000 |
| 10098 | Sistema Para Test De Esfuerzo | 2 | Semestral | 250.000 | 1.000.000 |
| 10102 | Tomografo De Coherencia optica | 3 | Semestral | 300.000 | 1.800.000 |
| 10109 | Unidad Diagnostico Y Terapia Alteraciones Del Habla | 1 | Anual | 350.000 | 350.000 |
| 10110 | Uroflujometro | 1 | Anual | 450.000 | 450.000 |
| 10113 | Videoencefalografo C/Somnografia C/ EEG 62 Canales | 1 | Semestral | 500.000 | 1.000.000 |
| 10114 | Videonistagmografo | 1 | Semestral | 500.000 | 1.000.000 |
| 10118 | Loop ECG | 1 | Anual | 250.000 | 250.000 |
| 10119 | Equipo Doppler Transcraneal | 1 | Semestral | 400.000 | 800.000 |
| 10128 | Monitor nervio facial | 1 | Anual | 150.000 | 150.000 |
| 10137 | Topografo Corneal | 2 | Semestral | 750.000 | 3.000.000 |
| 20003 | Torre De Artroscopia | 3 | Semestral | 600.000 | 3.600.000 |

| Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Unidades | Frecuencia de mantención | Precio referencial mantenimiento externo unitario (Pesos) | Precio total mantenimiento (Pesos) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20004 | Torre De Video Endoscopia Digestiva | 5 | Semestral | 600.000 | 6.000.000 |
| 20007 | Torre De Video Endoscopia Otorrino | 2 | Semestral | 600.000 | 2.400.000 |
| 20008 | Torre De Video Endoscopia Urologica | 1 | Semestral | 600.000 | 1.200.000 |
| 20009 | Torre De Video Endosonografia/Endoscopica | 1 | Semestral | 600.000 | 1.200.000 |
| 20010 | Torre De Video Laparoscopica | 17 | Semestral | 600.000 | 20.400.000 |
| 20011 | Torre De Video Laparoscopica/Endoscopica | 2 | Semestral | 600.000 | 2.400.000 |
| 20014 | Torre De VideoCistocopia | 2 | Semestral | 600.000 | 2.400.000 |
| 40001 | Aspirador Ultrasonico | 2 | Anual | 200.000 | 400.000 |
| 40003 | Bomba Aspiracion Quirurgica | 27 | Anual | 70.000 | 1.890.000 |
| 40004 | Bomba Aspiracion Universal | 30 | Anual | 70.000 | 2.100.000 |
| 40005 | Bomba irrigacion de pulsos | 2 | Anual | 200.000 | 400.000 |
| 40006 | Ciclodiodo transescleral con sondas | 2 | Anual | 400.000 | 800.000 |
| 40007 | Columna Pabellon I | 7 | Anual | 250.000 | 1.750.000 |
| 40008 | Columna De Reanimacion | 3 | Anual | 250.000 | 750.000 |
| 40009 | Columna Pabellon II | 17 | Anual | 250.000 | 4.250.000 |
| 40010 | Columna Porta Equipos Para UCI | 24 | Anual | 250.000 | 6.000.000 |
| 40013 | Electrobisturi Baja Potencia | 5 | Semestral | 250.000 | 2.500.000 |

| Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Unidades | Frecuencia de mantención | Precio referencial mantenimiento externo unitario (Pesos) | Precio total mantenimiento (Pesos) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40014 | Electrobisturi Disector Ultrasonico | 4 | Semestral | 250.000 | 2.000.000 |
| 40015 | Equipo De Electroterapia Por Radiofrecuencia | 2 | Semestral | 250.000 | 1.000.000 |
| 40018 | Esternotomo Electrico | 1 | Anual | 200.000 | 200.000 |
| 40019 | Facoemulsificador C/Vitrector Anterior | 4 | Semestral | 400.000 | 3.200.000 |
| 40021 | Fotocoagulador Laser (Verde) | 2 | Semestral | 450.000 | 1.800.000 |
| 40022 | Fotodisruptor Laser Nd-Yag | 1 | Semestral | 450.000 | 900.000 |
| 40023 | Laser Holmium 150 W | 1 | Semestral | 500.000 | 1.000.000 |
| 40025 | Morcelador | 1 | Anual | 100.000 | 100.000 |
| 40026 | Lampara Quirurgica I | 8 | Anual | 200.000 | 1.600.000 |
| 40027 | Lampara Quirurgica II | 16 | Anual | 200.000 | 3.200.000 |
| 40028 | Lampara Quirurgica Rodable | 2 | Anual | 140.000 | 280.000 |
| 40029 | Laser CO2 Dermatologia | 1 | Semestral | 500.000 | 1.000.000 |
| 40030 | Laser CO2 Otorrinolaringologia | 1 | Semestral | 500.000 | 1.000.000 |
| 40033 | Litotriptor Intracorporeo Neumatico | 1 | Semestral | 600.000 | 1.200.000 |
| 40035 | Mango Isquemia Automatico | 10 | Anual | 300.000 | 3.000.000 |
| 40036 | Maquina Anestesia Alta Complejidad | 18 | Semestral | 450.000 | 16.200.000 |
| 40037 | Laser con Resectoscopios | 1 | Semestral | 350.000 | 700.000 |

| Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Unidades | Frecuencia de mantención | Precio referencial mantenimiento externo unitario (Pesos) | Precio total mantenimiento (Pesos) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40038 | Maquina Anestesia Mediana Complejidad | 8 | Semestral | 450.000 | 7.200.000 |
| 40039 | Mesa Quirurgica Traumatologia | 4 | Anual | 120.000 | 480.000 |
| 40040 | Mesa Quirurgica Universal | 14 | Anual | 120.000 | 1.680.000 |
| 40042 | Microscopio Quirurgico | 1 | Anual | 700.000 | 700.000 |
| 40043 | Microscopio Quirurgico Oftalmológico | 6 | Anual | 700.000 | 4.200.000 |
| 40044 | Microscopio Quirurgico Otorrino | 2 | Anual | 150.000 | 300.000 |
| 40045 | Motor De Yeso | 3 | Anual | 120.000 | 360.000 |
| 40046 | Motor Quirurgico Grandes Fragmentos | 6 | Anual | 250.000 | 1.500.000 |
| 40047 | Motor Quirurgico Otorrino | 2 | Anual | 250.000 | 500.000 |
| 40048 | Motor Quirurgico Pequeños Fragmentos | 6 | Anual | 150.000 | 900.000 |
| 40049 | Unidad Criocirugia/Criocauterio | 5 | Semestral | 300.000 | 3.000.000 |
| 40050 | Unidad Para Electrocirugia Con Fusion De Tejidos | 14 | Semestral | 200.000 | 5.600.000 |
| 40051 | Unidad Para Electrocirugia De Alta Potencia | 8 | Semestral | 150.000 | 2.400.000 |
| 40052 | Unidad Para Electrocirugia De Alta Potencia Con Modulo De Argon | 3 | Semestral | 300.000 | 1.800.000 |
| 40053 | Unidad Para Electrocirugia De Argon Plasma Para Endoscopia Digestiva | 3 | Semestral | 300.000 | 1.800.000 |

| Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Unidades | Frecuencia de mantención | Precio referencial mantenimiento externo unitario (Pesos) | Precio total mantenimiento (Pesos) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40054 | Unidad Para Electrocirugia Para Endoscopia Digestiva | 2 | Semestral | 400.000 | 1.600.000 |
| 40055 | Unidad Para Electrocirugia Urologica Endoscopica | 1 | Semestral | 400.000 | 800.000 |
| 40056 | Vitrector posterior | 3 | Semestral | 350.000 | 2.100.000 |
| 40057 | sistema integrado de pabellones | 2 | Semestral | 450.000 | 1.800.000 |
| 40084 | Sistema para monitoreo de indica biespectral (BIS) | 2 | Anual | 150.000 | 300.000 |
| 50004 | Balon contrapulsacion aortico | 3 | Semestral | 650.000 | 3.900.000 |
| 50006 | Cabina De Puvaterapia | 1 | Semestral | 200.000 | 400.000 |
| 50007 | Calentador De Fluido | 22 | Anual | 150.000 | 3.300.000 |
| 50014 | Equipo de Asistencia Respiratoria con Membrana Extracorporea | 1 | Semestral | 1.500.000 | 3.000.000 |
| 50016 | Equipo Regulacion Termica | 1 | Semestral | 550.000 | 1.100.000 |
| 50020 | Equipo Terapia Electroconvulsiva | 1 | Semestral | 900.000 | 1.800.000 |
| 50021 | Equipo Terapia Fotodinamica | 1 | Anual | 310.000 | 310.000 |
| 50023 | Gabinete Calentador De Suero | 7 | Anual | 150.000 | 1.050.000 |

| Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Unidades | Frecuencia de mantención | Precio referencial mantenimiento externo unitario (Pesos) | Precio total mantenimiento (Pesos) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50024 | Generador De Pulso Bicameral | 11 | Anual | 150.000 | 1.650.000 |
| 50025 | Generador De Pulso Unicameral | 10 | Anual | 150.000 | 1.500.000 |
| 50026 | Humidificador O2 C/ Calefactor | 65 | Anual | 120.000 | 7.800.000 |
| 50027 | Lampara De Fototerapia Uva | 2 | Semestral | 220.000 | 880.000 |
| 50029 | Maquina Hemodialisis | 30 | Semestral | 440.000 | 26.400.000 |
| 50031 | Nebulizador Ultrasonico | 4 | Anual | 60.000 | 240.000 |
| 50035 | Ventilador De Transporte | 15 | Semestral | 350.000 | 10.500.000 |
| 50037 | Ventilador Mecanico No Invasivo | 51 | Semestral | 350.000 | 35.700.000 |
| 50038 | Ventilador Volumetrico | 24 | Semestral | 500.000 | 24.000.000 |
| 50039 | Bomba Alto Flujo Y Calentador De Sueros | 3 | Anual | 100.000 | 300.000 |
| 50043 | Maquina Hemodiafiltracion | 5 | Semestral | 450.000 | 4.500.000 |
| 50044 | Marcapasos | 1 | Anual | 150.000 | 150.000 |
| 70001 | Autoclave 650 lt. | 3 | Trimestral | 900.000 | 10.800.000 |
| 70002 | Autoclave Laboratorio | 1 | Trimestral | 400.000 | 1.600.000 |
| 70003 | Esterilizador Oxido de Etileno | 1 | Semestral | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 70004 | Esterilizador Plasma | 2 | Semestral | 2.000.000 | 8.000.000 |
| 70006 | Lavadora A Vapor Para Instumental De Laparoscopia | 1 | Semestral | 300.000 | 600.000 |

| Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Unidades | Frecuencia de mantención | Precio referencial mantenimiento externo unitario (Pesos) | Precio total mantenimiento (Pesos) |
|---|---|---|---|---|---|
| 70007 | Lavadora Descontaminadora Material De Vidrio | 1 | Semestral | 300.000 | 600.000 |
| 70008 | Lavadora Instrumental Ultrasonica | 3 | Semestral | 500.000 | 3.000.000 |
| 70009 | Lavadora Descontaminadora | 4 | Semestral | 300.000 | 2.400.000 |
| 70012 | Reprocesador Automatico De Endoscopios | 4 | Semestral | 300.000 | 2.400.000 |
| 70014 | Autoclave 300lt. | 2 | Trimestral | 900.000 | 7.200.000 |
| 80001 | Angiografo Multiproposito I | 1 | Semestral | 3.000.000 | 6.000.000 |
| 80002 | Calibrador De Dosis | 2 | Anual | 1.160.000 | 2.320.000 |
| 80005 | Densitometro oseo | 1 | Semestral | 600.000 | 1.200.000 |
| 80006 | Ecocardiografo | 3 | Semestral | 300.000 | 1.800.000 |
| 80007 | Ecotomografo Doppler Color Multiproposito | 8 | Semestral | 300.000 | 4.800.000 |
| 80010 | Equipo Rx Arco C | 8 | Semestral | 450.000 | 7.200.000 |
| 80011 | Medidor De Radiacion | 2 | Anual | 1.100.000 | 2.200.000 |
| 80012 | Rayos X Dental Intraoral | 2 | Semestral | 450.000 | 1.800.000 |
| 80013 | Rayos X Dental Panoramico | 1 | Semestral | 800.000 | 1.600.000 |
| 80014 | Rayos X Osteopulmonar | 4 | Semestral | 1.500.000 | 12.000.000 |
| 80015 | Resonador Nuclear Magnetico | 1 | Trimestral | 4.100.000 | 16.400.000 |
| 80018 | Rx Portatil | 4 | Semestral | 450.000 | 3.600.000 |

| Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Unidades | Frecuencia de mantención | Precio referencial mantenimiento externo unitario (Pesos) | Precio total mantenimiento (Pesos) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80019 | Rx Telecomadado | 1 | Semestral | 1.500.000 | 3.000.000 |
| 80020 | Tomografo Axial Computarizado | 1 | Semestral | 3.500.000 | 7.000.000 |
| 80021 | Tomografo Axial Computarizado Dental | 1 | Semestral | 2.500.000 | 5.000.000 |
| 80022 | Tomografo Por Emision De Fotones | 1 | Trimestral | 3.800.000 | 15.200.000 |
| 80023 | Angiografo Multiproposito II | 1 | Semestral | 3.000.000 | 6.000.000 |
| 80026 | Ecotomografo Doppler Tiroides | 1 | Semestral | 300.000 | 600.000 |
| 80032 | Ecografo doppler para pabellones | 6 | Semestral | 300.000 | 3.600.000 |
| 80033 | Ecotomografo doppler portátil | 6 | Semestral | 300.000 | 3.600.000 |
| 80033 | PET - CT | 1 | Trimestral | 4.500.000 | 18.000.000 |
| 80034 | Equipo Ecografia intravascular | 1 | Semestral | 750.000 | 1.500.000 |
| 80034 | Tomografo Axial Computarizado I | 1 | Semestral | 3.500.000 | 7.000.000 |
| 80035 | Ecografo Portatil Urologia | 1 | Semestral | 300.000 | 600.000 |
| 90008 | Balanza De Precision | 4 | Anual | 120.000 | 480.000 |
| 90013 | Campana De Flujo Laminar | 2 | Anual | 400.000 | 800.000 |
| 90017 | Camara Mortuoria | 2 | Anual | 650.000 | 1.300.000 |
| 90040 | Espectrofotometro | 2 | Anual | 600.000 | 1.200.000 |
| 90041 | Estacion De Trabajo Para Pcr | 4 | Anual | 200.000 | 800.000 |

| Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Unidades | Frecuencia de mantención | Precio referencial mantenimiento externo unitario (Pesos) | Precio total mantenimiento (Pesos) |
|---|---|---|---|---|---|
| 90042 | Estufa De Cultivo | 7 | Anual | 150.000 | 1.050.000 |
| 90044 | Extractor Automatizado De Adn/Arn | 1 | Anual | 450.000 | 450.000 |
| 90045 | Freezer -30° C | 15 | Anual | 200.000 | 3.000.000 |
| 90046 | Freezer -80°C 380L | 1 | Anual | 200.000 | 200.000 |
| 90047 | Freezer -80°C 500L | 3 | Anual | 200.000 | 600.000 |
| 90048 | Freezer | 7 | Anual | 200.000 | 1.400.000 |
| 90049 | Gabinete Bioseguridad Clase II B2 | 2 | Anual | 300.000 | 600.000 |
| 90051 | HPLC (Cromatografia Liquida De Alta Efieciencia) | 1 | Semestral | 800.000 | 1.600.000 |
| 90056 | Mesa Autopsia | 1 | Anual | 250.000 | 250.000 |
| 90068 | Procesador De Tejidos | 2 | Anual | 900.000 | 1.800.000 |
| 90070 | Refrigerador Banco De Sangre | 3 | Anual | 150.000 | 450.000 |
| 90071 | Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Doble Puerta | 14 | Anual | 150.000 | 2.100.000 |
| 90072 | Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta | 48 | Anual | 150.000 | 7.200.000 |
| 90073 | Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta Pequeño | 10 | Anual | 150.000 | 1.500.000 |
| 90075 | Secuenciador De Adn/Arn | 1 | Anual | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 90084 | Sistema Refrigerado Para Almacenamiento Temporal Y Transporte De Sangre Y Hemoderivados | 8 | Anual | 60.000 | 480.000 |
| 90088 | Termociclador | 2 | Anual | 120.000 | 240.000 |

| Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Unidades | Frecuencia de mantención | Precio referencial mantenimiento externo unitario (Pesos) | Precio total mantenimiento (Pesos) |
|---|---|---|---|---|---|
| 90089 | Termociclador Tiempo Real | 2 | Anual | 200.000 | 400.000 |
| 90102 | Estufa De Cultivo CO2 | 2 | Semestral | 180.000 | 720.000 |
| 90127 | Campana De Extraccion gases organicos II | 2 | Anual | 200.000 | 400.000 |
| 90126 | Campana De extraccion gases organicos I | 3 | Anual | 200.000 | 600.000 |
| 90137 | Escaner de Metafases | 1 | Anual | 250.000 | 250.000 |
| 90139 | Gabinete Bioseguridad Clase II A2 | 9 | Anual | 200.000 | 1.800.000 |
| 90145 | Estacion Trabajo Anatomia Patologica | 2 | Anual | 500.000 | 1.000.000 |
| 100041 | Electroestimulador | 5 | Anual | 100.000 | 500.000 |
| 100042 | Electroestimulador Biofeedback Miografia Para Incontinencia | 2 | Anual | 350.000 | 700.000 |
| 100044 | Electroestimulador De Analgesia | 19 | Anual | 100.000 | 1.900.000 |
| 100104 | Sistema Con Arnes Para Rehabilitacion De La Marcha | 2 | Anual | 195.000 | 390.000 |
| 100106 | Sistema Evaluacion Dinamica De La Marcha | 1 | Anual | 250.000 | 250.000 |
| 100107 | Sistema Suspension Antigravedad | 4 | Anual | 250.000 | 1.000.000 |
| 100114 | Turbion De Extremidades | 5 | Anual | 200.000 | 1.000.000 |
| 100115 | Ultrasonido | 8 | Anual | 120.000 | 960.000 |
| 100116 | Ultratermia | 6 | Anual | 90.000 | 540.000 |
| 100134 | Sistema para Rehabilitacion Cardiologica con monitoreo y telemetria | 1 | Anual | 550.000 | 550.000 |

| Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Unidades | Frecuencia de mantención | Precio referencial mantenimiento externo unitario (Pesos) | Precio total mantenimiento (Pesos) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100138 | Elevador para piscina | 1 | Anual | 200.000 | 200.000 |
| 110065 | Mobiliario Paciente UCI | 23 | Anual | 100.000 | 2.300.000 |
| 110066 | Mobiliario Paciente UTI | 46 | Anual | 100.000 | 4.600.000 |
| 110091 | Unidad Otorrinolaringologica Completa | 6 | Anual | 90.000 | 540.000 |
| 110094 | Sillon oftalmologia (cirujano) | 6 | Anual | 230.000 | 1.380.000 |
| 110106 | Mobiliario Paciente UPC Bariatrico | 3 | Anual | 100.000 | 300.000 |
| 110107 | Nefroscopio | 1 | Anual | 200.000 | 200.000 |
| 110108 | Poligrafo Electrofisiologia | 1 | Anual | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 130002 | Central Monitoreo Recuperacion | 3 | Semestral | 12.200.000 | 73.200.000 |
| 130003 | Central Monitoreo UPC | 8 | Semestral | 16.000.000 | 256.000.000 |
| 130006 | Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria | 277 | Semestral | 150.000 | 83.100.000 |
| 130007 | Monitor Desfibrilador | 67 | Semestral | 250.000 | 33.500.000 |
| 130008 | Monitor Desfibrilador C/Mpe | 2 | Semestral | 250.000 | 1.000.000 |
| 130010 | Monitor ECG Signos Vitales Baja Complejidad | 71 | Semestral | 180.000 | 25.560.000 |
| 130011 | Monitor ECG Signos Vitales Mediana Complejidad | 3 | Semestral | 200.000 | 1.200.000 |
| 130015 | Desfibrilador tipo DEA | 42 | Semestral | 80.000 | 6.720.000 |
| 140008 | Motor Colgante | 13 | Anual | 250.000 | 3.250.000 |

| Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Unidades | Frecuencia de mantención | Precio referencial mantenimiento externo unitario (Pesos) | Precio total mantenimiento (Pesos) |
|---|---|---|---|---|---|
| 140009 | Motor Con Irrigacion Para Implantes | 2 | Anual | 250.000 | 500.000 |
| 140012 | Motor cirugia Maxilofacial | 1 | Anual | 250.000 | 250.000 |
| 140013 | Unidad Dental Completa | 19 | Anual | 300.000 | 5.700.000 |
| 140014 | Sillon dental | 2 | Anual | 300.000 | 600.000 |
| | | | | | 1.040.053.000 |

Estrategia hibrida.

| Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Unidades | Frecuancia de mantención | Estrategia 2 | Precio referencial mantenimiento externo unitario | Precio total mantenimiento | Tiempo mantenimiento proyectado mantención unitaria (HH) | Tiempo total mantenimiento proyectado (HH) | Costo backup (Pesos) | Vida util Backup (Años) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10004 | Angiografo Retinal | 2 | Semestral | Externa | 550.000 | 2.200.000 | | | | |
| 10024 | Campimetro Computarizado | 3 | Semestral | Externa | 400.000 | 2.400.000 | | | | |
| 10026 | Campimetro Goldman | 2 | Semestral | Externa | 450.000 | 1.800.000 | | | | |
| 10030 | Doppler Con Pletismografia Vascular | 1 | Anual | Externa | 543.000 | 543.000 | | | | |
| 10031 | Doppler Vascular | 2 | Anual | Externa | 776.000 | 1.552.000 | | | | |

| Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Unidades | Frecuancia de mantención | Estrategia 2 | Precio referencial mantenimiento externo unitario | Precio total mantenimiento | Tiempo mantenimiento proyectado mantención unitaria (HH) | Tiempo total mantenimiento proyectado (HH) | Costo backup (Pesos) | Vida util Backup (Años) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10032 | Doppler Vascular Portatil | 2 | Anual | Externa | 160.000 | 320.000 | | | | |
| 10033 | Ecografo Ocular | 3 | Semestral | Externa | 388.000 | 2.328.000 | | | | |
| 10034 | Electrocardiografo | 43 | Semestral | Interna | 0 | 0 | 0,5 | 43 | 4.138.531 | 10 |
| 10035 | Electroencefalografo | 3 | Semestral | Externa | 480.000 | 2.880.000 | | | | |
| 10037 | Electromiografo Con Potenciales Evocados | 1 | Semestral | Externa | 800.000 | 1.600.000 | | | | |
| 10038 | Electroretinografo | 1 | Semestral | Externa | 1.000.000 | 2.000.000 | | | | |
| 10039 | Equipo De Manometria E Impedanciometria Esofagica Y Rectal | 1 | Anual | Externa | 300.000 | 300.000 | | | | |
| 10040 | Equipo De Potenciales Evocados Con Vem | 1 | Anual | Externa | 500.000 | 500.000 | | | | |

| Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Unidades | Frecuancia de mantención | Estrategia 2 | Precio referencial mantenimiento externo unitario | Precio total mantenimiento | Tiempo mantenimiento proyectado mantención unitaria (HH) | Tiempo total mantenimiento proyectado (HH) | Costo backup (Pesos) | Vida util Backup (Años) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10041 | Equipo Urodinamia | 1 | Semestral | Externa | 600.000 | 1.200.000 | | | | |
| 10052 | Lampara Hendidura | 14 | Semestral | Externa | 150.000 | 4.200.000 | | | | |
| 10054 | Lampara Hendidura C/Sistema De Video | 14 | Semestral | Externa | 150.000 | 4.200.000 | | | | |
| 10060 | Localizador Estimulador De Nervio Periferico | 18 | Anual | Externa | 60.000 | 1.080.000 | | | | |
| 10088 | Rinomanometro | 1 | Anual | Interna | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 10092 | Sistema De Posturografia Dinamica | 2 | Anual | Externa | 550.000 | 1.100.000 | | | | |
| 10095 | Sistema Fotografia Polo Posterior | 1 | Semestral | Externa | 600.000 | 1.200.000 | | | | |
| 10096 | Sistema Holter ECG Y Presion Arterial | 2 | Anual | Interna | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | |

| Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Unidades | Frecuancia de mantención | Estrategia 2 | Precio referencial mantenimiento externo unitario | Precio total mantenimiento | Tiempo mantenimiento proyectado mantención unitaria (HH) | Tiempo total mantenimiento proyectado (HH) | Costo backup (Pesos) | Vida util Backup (Años) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10098 | Sistema Para Test De Esfuerzo | 2 | Semestral | Interna | 0 | 0 | 1,5 | 6 | 0 | |
| 10102 | Tomografo De Coherencia optica | 3 | Semestral | Externa | 300.000 | 1.800.000 | | | | |
| 10109 | Unidad Diagnostico Y Terapia Alteraciones Del Habla | 1 | Anual | Externa | 350.000 | 350.000 | | | | |
| 10110 | Uroflujometro | 1 | Anual | Externa | 450.000 | 450.000 | | | | |
| 10113 | Videoencefalografo C/Somnografia C/ EEG 62 Canales | 1 | Semestral | Externa | 500.000 | 1.000.000 | | | | |
| 10114 | Videonistagmografo | 1 | Semestral | Externa | 500.000 | 1.000.000 | | | | |
| 10118 | Loop ECG | 1 | Anual | Interna | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 10119 | Equipo Doppler Transcraneal | 1 | Semestral | Externa | 400.000 | 800.000 | | | | |

| Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Unidades | Frecuancia de mantención | Estrategia 2 | Precio referencial mantenimiento externo unitario | Precio total mantenimiento | Tiempo mantenimiento proyectado mantención unitaria (HH) | Tiempo total mantenimiento proyectado (HH) | Costo backup (Pesos) | Vida util Backup (Años) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10128 | Monitor nervio facial | 1 | Anual | Externa | 150.000 | 150.000 | | | | |
| 10137 | Topografo Corneal | 2 | Semestral | Externa | 750.000 | 3.000.000 | | | | |
| 20003 | Torre De Artroscopia | 3 | Semestral | Externa | 600.000 | 3.600.000 | | | | |
| 20004 | Torre De Video Endoscopia Digestiva | 5 | Semestral | Externa | 600.000 | 6.000.000 | | | | |
| 20007 | Torre De Video Endoscopia Otorrino | 2 | Semestral | Externa | 600.000 | 2.400.000 | | | | |
| 20008 | Torre De Video Endoscopia Urologica | 1 | Semestral | Externa | 600.000 | 1.200.000 | | | | |
| 20009 | Torre De Video Endosonografia/Endoscopica | 1 | Semestral | Externa | 600.000 | 1.200.000 | | | | |

| Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Unidades | Frecuancia de mantención | Estrategia 2 | Precio referencial mantenimiento externo unitario | Precio total mantenimiento | Tiempo mantenimiento proyectado mantención unitaria (HH) | Tiempo total mantenimiento proyectado (HH) | Costo backup (Pesos) | Vida util Backup (Años) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20010 | Torre De Video Laparoscopica | 17 | Semestral | Externa | 600.000 | 20.400.000 | | | | |
| 20011 | Torre De Video Laparoscopica/Endoscopica | 2 | Semestral | Externa | 600.000 | 2.400.000 | | | | |
| 20014 | Torre De VideoCistocopia | 2 | Semestral | Externa | 600.000 | 2.400.000 | | | | |
| 40001 | Aspirador Ultrasonico | 2 | Anual | Interna | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | |
| 40003 | Bomba Aspiracion Quirurgica | 27 | Anual | Interna | 0 | 0 | 0,75 | 20,25 | 0 | |
| 40004 | Bomba Aspiracion Universal | 30 | Anual | Interna | 0 | 0 | 0,75 | 22,5 | 0 | |
| 40005 | Bomba irrigacion de pulsos | 2 | Anual | Externa | 200.000 | 400.000 | | | | |

| Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Unidades | Frecuancia de mantención | Estrategia 2 | Precio referencial mantenimiento externo unitario | Precio total mantenimiento | Tiempo mantenimiento proyectado mantención unitaria (HH) | Tiempo total mantenimiento proyectado (HH) | Costo backup (Pesos) | Vida util Backup (Años) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40006 | Ciclodiodo transescleral con sondas | 2 | Anual | Externa | 400.000 | 800.000 | | | | |
| 40007 | Columna Pabellon I | 7 | Anual | Interna | 0 | 0 | 1,5 | 10,5 | 0 | |
| 40008 | Columna De Reanimacion | 3 | Anual | Interna | 0 | 0 | 1,5 | 4,5 | 0 | |
| 40009 | Columna Pabellon II | 17 | Anual | Interna | 0 | 0 | 1,5 | 25,5 | 0 | |
| 40010 | Columna Porta Equipos Para UCI | 24 | Anual | Interna | 0 | 0 | 1,5 | 36 | 0 | |
| 40013 | Electrobisturi Baja Potencia | 5 | Semestral | Externa | 250.000 | 2.500.000 | | | | |
| 40014 | Electrobisturi Disector Ultrasonico | 4 | Semestral | Externa | 250.000 | 2.000.000 | | | | |
| 40015 | Equipo De Electroterapia Por Radiofrecuencia | 2 | Semestral | Externa | 250.000 | 1.000.000 | | | | |
| 40018 | Esternotomo Electrico | 1 | Anual | Interna | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |

| Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Unidades | Frecuancia de mantención | Estrategia 2 | Precio referencial mantenimiento externo unitario | Precio total mantenimiento | Tiempo mantenimiento proyectado mantención unitaria (HH) | Tiempo total mantenimiento proyectado (HH) | Costo backup (Pesos) | Vida util Backup (Años) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40019 | Facoemulsificador C/Vitrector Anterior | 4 | Semestral | Externa | 400.000 | 3.200.000 | | | | |
| 40021 | Fotocoagulador Laser (Verde) | 2 | Semestral | Externa | 450.000 | 1.800.000 | | | | |
| 40022 | Fotodisruptor Laser Nd-Yag | 1 | Semestral | Externa | 450.000 | 900.000 | | | | |
| 40023 | Laser Holmium 150 W | 1 | Semestral | Externa | 500.000 | 1.000.000 | | | | |
| 40025 | Morcelador | 1 | Anual | Externa | 100.000 | 100.000 | | | | |
| 40026 | Lampara Quirurgica I | 8 | Anual | Interna | 0 | 0 | 1,5 | 12 | 0 | |
| 40027 | Lampara Quirurgica II | 16 | Anual | Interna | 0 | 0 | 1,5 | 24 | 0 | |
| 40028 | Lampara Quirurgica Rodable | 2 | Anual | Interna | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 40029 | Laser CO2 Dermatologia | 1 | Semestral | Externa | 500.000 | 1.000.000 | | | | |

| Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Unidades | Frecuancia de mantención | Estrategia 2 | Precio referencial mantenimiento externo unitario | Precio total mantenimiento | Tiempo mantenimiento proyectado mantención unitaria (HH) | Tiempo total mantenimiento proyectado (HH) | Costo backup (Pesos) | Vida util Backup (Años) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40030 | Laser CO2 Otorrinolaringologia | 1 | Semestral | Externa | 500.000 | 1.000.000 | | | | |
| 40033 | Litotriptor Intracorporeo Neumatico | 1 | Semestral | Externa | 600.000 | 1.200.000 | | | | |
| 40035 | Mango Isquemia Automatico | 10 | Anual | Externa | 300.000 | 3.000.000 | | | | |
| 40036 | Maquina Anestesia Alta Complejidad | 18 | Semestral | Externa | 450.000 | 16.200.000 | | | | |
| 40037 | Laser con Resectoscopios | 1 | Semestral | Externa | 350.000 | 700.000 | | | | |
| 40038 | Maquina Anestesia Mediana Complejidad | 8 | Semestral | Externa | 450.000 | 7.200.000 | | | | |
| 40039 | Mesa Quirurgica Traumatologia | 4 | Anual | Interna | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |

| Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Unidades | Frecuancia de mantención | Estrategia 2 | Precio referencial mantenimiento externo unitario | Precio total mantenimiento | Tiempo mantenimiento proyectado mantención unitaria (HH) | Tiempo total mantenimiento proyectado (HH) | Costo backup (Pesos) | Vida util Backup (Años) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40040 | Mesa Quirurgica Universal | 14 | Anual | Interna | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | |
| 40042 | Microscopio Quirurgico | 1 | Anual | Externa | 700.000 | 700.000 | | | | |
| 40043 | Microscopio Quirurgico Oftalmológico | 6 | Anual | Externa | 700.000 | 4.200.000 | | | | |
| 40044 | Microscopio Quirurgico Otorrino | 2 | Anual | Externa | 150.000 | 300.000 | | | | |
| 40045 | Motor De Yeso | 3 | Anual | Interna | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 40046 | Motor Quirurgico Grandes Fragmentos | 6 | Anual | Interna | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
| 40047 | Motor Quirurgico Otorrino | 2 | Anual | Interna | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 40048 | Motor Quirurgico Pequeños Fragmentos | 6 | Anual | Interna | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | |

| Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Unidades | Frecuancia de mantención | Estrategia 2 | Precio referencial mantenimiento externo unitario | Precio total mantenimiento | Tiempo mantenimiento proyectado mantención unitaria (HH) | Tiempo total mantenimiento proyectado (HH) | Costo backup (Pesos) | Vida util Backup (Años) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40049 | Unidad Criocirugia/Criocauterio | 5 | Semestral | Externa | 300.000 | 3.000.000 | | | | |
| 40050 | Unidad Para Electrocirugia Con Fusion De Tejidos | 14 | Semestral | Externa | 200.000 | 5.600.000 | | | | |
| 40051 | Unidad Para Electrocirugia De Alta Potencia | 8 | Semestral | Externa | 150.000 | 2.400.000 | | | | |
| 40052 | Unidad Para Electrocirugia De Alta Potencia Con Modulo De Argon | 3 | Semestral | Externa | 300.000 | 1.800.000 | | | | |
| 40053 | Unidad Para Electrocirugia De Argon Plasma Para Endoscopia Digestiva | 3 | Semestral | Externa | 300.000 | 1.800.000 | | | | |

| Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Unidades | Frecuancia de mantención | Estrategia 2 | Precio referencial mantenimiento externo unitario | Precio total mantenimiento | Tiempo mantenimiento proyectado mantención unitaria (HH) | Tiempo total mantenimiento proyectado (HH) | Costo backup (Pesos) | Vida util Backup (Años) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40054 | Unidad Para Electrocirugia Para Endoscopia Digestiva | 2 | Semestral | Externa | 400.000 | 1.600.000 | | | | |
| 40055 | Unidad Para Electrocirugia Urologica Endoscopica | 1 | Semestral | Externa | 400.000 | 800.000 | | | | |
| 40056 | Vitrector posterior | 3 | Semestral | Externa | 350.000 | 2.100.000 | | | | |
| 40057 | sistema integrado de pabellones | 2 | Semestral | Externa | 450.000 | 1.800.000 | | | | |
| 40084 | Sistema para monitoreo de indica biespectral (BIS) | 2 | Anual | Externa | 150.000 | 300.000 | | | | |
| 50004 | Balon contrapulsacion aortico | 3 | Semestral | Externa | 650.000 | 3.900.000 | | | | |
| 50006 | Cabina De Puvaterapia | 1 | Semestral | Externa | 200.000 | 400.000 | | | | |

| Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Unidades | Frecuancia de mantención | Estrategia 2 | Precio referencial mantenimiento externo unitario | Precio total mantenimiento | Tiempo mantenimiento proyectado mantención unitaria (HH) | Tiempo total mantenimiento proyectado (HH) | Costo backup (Pesos) | Vida util Backup (Años) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50007 | Calentador De Fluido | 22 | Anual | Interna | 0 | 0 | 1,5 | 33 | 3.584.467 | 8 |
| 50014 | Equipo de Asistencia Respiratoria con Membrana Extracorporea | 1 | Semestral | Externa | 1.500.000 | 3.000.000 | | | | |
| 50016 | Equipo Regulacion Termica | 1 | Semestral | Externa | 550.000 | 1.100.000 | | | | |
| 50020 | Equipo Terapia Electroconvulsiva | 1 | Semestral | Externa | 900.000 | 1.800.000 | | | | |
| 50021 | Equipo Terapia Fotodinamica | 1 | Anual | Externa | 310.000 | 310.000 | | | | |
| 50023 | Gabinete Calentador De Suero | 7 | Anual | Interna | 0 | 0 | 1,5 | 10,5 | 4.774.926 | 8 |

| Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Unidades | Frecuancia de mantención | Estrategia 2 | Precio referencial mantenimiento externo unitario | Precio total mantenimiento | Tiempo mantenimiento proyectado mantención unitaria (HH) | Tiempo total mantenimiento proyectado (HH) | Costo backup (Pesos) | Vida util Backup (Años) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50024 | Generador De Pulso Bicameral | 11 | Anual | Externa | 150.000 | 1.650.000 | | | | |
| 50025 | Generador De Pulso Unicameral | 10 | Anual | Externa | 150.000 | 1.500.000 | | | | |
| 50026 | Humidificador O2 C/ Calefactor | 65 | Anual | Interna | 0 | 0 | 0,5 | 32,5 | 0 | |
| 50027 | Lampara De Fototerapia Uva | 2 | Semestral | Externa | 220.000 | 880.000 | | | | |
| 50029 | Maquina Hemodialisis | 30 | Semestral | Externa | 440.000 | 26.400.000 | | | | |
| 50031 | Nebulizador Ultrasonico | 4 | Anual | Interna | 0 | 0 | 0,5 | 2 | 0 | |
| 50035 | Ventilador De Transporte | 15 | Semestral | Externa | 350.000 | 10.500.000 | 1,5 | 45 | 14.859.719 | 8 |
| 50037 | Ventilador Mecanico No Invasivo | 51 | Semestral | Externa | 350.000 | 35.700.000 | 1,5 | 153 | 17.232.722 | 8 |
| 50038 | Ventilador Volumetrico | 24 | Semestral | Externa | 500.000 | 24.000.000 | 1,5 | 72 | 30.381.815 | 8 |

| Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Unidades | Frecuancia de mantención | Estrategia 2 | Precio referencial mantenimiento externo unitario | Precio total mantenimiento | Tiempo mantenimiento proyectado mantención unitaria (HH) | Tiempo total mantenimiento proyectado (HH) | Costo backup (Pesos) | Vida util Backup (Años) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50039 | Bomba Alto Flujo Y Calentador De Sueros | 3 | Anual | Interna | 0 | 0 | 0,75 | 2,25 | 10.417.999 | 8 |
| 50043 | Maquina Hemodiafiltracion | 5 | Semestral | Externa | 450.000 | 4.500.000 | | | | |
| 50044 | Marcapasos | 1 | Anual | Externa | 150.000 | 150.000 | | | | |
| 70001 | Autoclave 650 lt. | 3 | Trimestral | Externa | 900.000 | 10.800.000 | | | | |
| 70002 | Autoclave Laboratorio | 1 | Trimestral | Externa | 400.000 | 1.600.000 | | | | |
| 70003 | Esterilizador Oxido de Etileno | 1 | Semestral | Externa | 1.000.000 | 2.000.000 | | | | |
| 70004 | Esterilizador Plasma | 2 | Semestral | Externa | 2.000.000 | 8.000.000 | | | | |
| 70006 | Lavadora A Vapor Para Instumental De Laparoscopia | 1 | Semestral | Externa | 300.000 | 600.000 | | | | |
| 70007 | Lavadora Descontaminadora Material De Vidrio | 1 | Semestral | Externa | 300.000 | 600.000 | | | | |

| Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Unidades | Frecuancia de mantención | Estrategia 2 | Precio referencial mantenimiento externo unitario | Precio total mantenimiento | Tiempo mantenimiento proyectado mantención unitaria (HH) | Tiempo total mantenimiento proyectado (HH) | Costo backup (Pesos) | Vida util Backup (Años) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70008 | Lavadora Instrumental Ultrasonica | 3 | Semestral | Externa | 500.000 | 3.000.000 | | | | |
| 70009 | Lavadora Descontaminadora | 4 | Semestral | Externa | 300.000 | 2.400.000 | | | | |
| 70012 | Reprocesador Automatico De Endoscopios | 4 | Semestral | Externa | 300.000 | 2.400.000 | | | | |
| 70014 | Autoclave 300lt. | 2 | Trimestral | Externa | 900.000 | 7.200.000 | | | | |
| 80001 | Angiografo Multiproposito I | 1 | Semestral | Externa | 3.000.000 | 6.000.000 | | | | |
| 80002 | Calibrador De Dosis | 2 | Anual | Externa | 1.160.000 | 2.320.000 | | | | |
| 80005 | Densitometro oseo | 1 | Semestral | Externa | 600.000 | 1.200.000 | | | | |
| 80006 | Ecocardiografo | 3 | Semestral | Externa | 300.000 | 1.800.000 | | | | |
| 80007 | Ecotomografo Doppler Color Multiproposito | 8 | Semestral | Externa | 300.000 | 4.800.000 | | | | |

| Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Unidades | Frecuancia de mantención | Estrategia 2 | Precio referencial mantenimiento externo unitario | Precio total mantenimiento | Tiempo mantenimiento proyectado mantención unitaria (HH) | Tiempo total mantenimiento proyectado (HH) | Costo backup (Pesos) | Vida util Backup (Años) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80010 | Equipo Rx Arco C | 8 | Semestral | Externa | 450.000 | 7.200.000 | | | | |
| 80011 | Medidor De Radiacion | 2 | Anual | Externa | 1.100.000 | 2.200.000 | | | | |
| 80012 | Rayos X Dental Intraoral | 2 | Semestral | Externa | 450.000 | 1.800.000 | | | | |
| 80013 | Rayos X Dental Panoramico | 1 | Semestral | Externa | 800.000 | 1.600.000 | | | | |
| 80014 | Rayos X Osteopulmonar | 4 | Semestral | Externa | 1.500.000 | 12.000.000 | | | | |
| 80015 | Resonador Nuclear Magnetico | 1 | Trimestral | Externa | 4.100.000 | 16.400.000 | | | | |
| 80018 | Rx Portatil | 4 | Semestral | Externa | 450.000 | 3.600.000 | | | | |
| 80019 | Rx Telecomadado | 1 | Semestral | Externa | 1.500.000 | 3.000.000 | | | | |
| 80020 | Tomografo Axial Computarizado | 1 | Semestral | Externa | 3.500.000 | 7.000.000 | | | | |

| Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Unidades | Frecuancia de mantención | Estrategia 2 | Precio referencial mantenimiento externo unitario | Precio total mantenimiento | Tiempo mantenimiento proyectado mantención unitaria (HH) | Tiempo total mantenimiento proyectado (HH) | Costo backup (Pesos) | Vida util Backup (Años) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80021 | Tomografo Axial Computarizado Dental | 1 | Semestral | Externa | 2.500.000 | 5.000.000 | | | | |
| 80022 | Tomografo Por Emision De Fotones | 1 | Trimestral | Externa | 3.800.000 | 15.200.000 | | | | |
| 80023 | Angiografo Multiproposito II | 1 | Semestral | Externa | 3.000.000 | 6.000.000 | | | | |
| 80026 | Ecotomografo Doppler Tiroides | 1 | Semestral | Externa | 300.000 | 600.000 | | | | |
| 80032 | Ecografo doppler para pabellones | 6 | Semestral | Externa | 300.000 | 3.600.000 | | | | |
| 80033 | Ecotomografo doppler portátil | 6 | Semestral | Externa | 300.000 | 3.600.000 | | | | |
| 80033 | PET - CT | 1 | Trimestral | Externa | 4.500.000 | 18.000.000 | | | | |
| 80034 | Equipo Ecografia intravascular | 1 | Semestral | Externa | 750.000 | 1.500.000 | | | | |

| Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Unidades | Frecuancia de mantención | Estrategia 2 | Precio referencial mantenimiento externo unitario | Precio total mantenimiento | Tiempo mantenimiento proyectado mantención unitaria (HH) | Tiempo total mantenimiento proyectado (HH) | Costo backup (Pesos) | Vida util Backup (Años) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80034 | Tomografo Axial Computarizado I | 1 | Semestral | Externa | 3.500.000 | 7.000.000 | | | | |
| 80035 | Ecografo Portatil Urologia | 1 | Semestral | Externa | 300.000 | 600.000 | | | | |
| 90008 | Balanza De Precision | 4 | Anual | Interna | 0 | 0 | 0,5 | 2 | 0 | |
| 90013 | Campana De Flujo Laminar | 2 | Anual | Externa | 400.000 | 800.000 | | | | |
| 90017 | Camara Mortuoria | 2 | Anual | Externa | 650.000 | 1.300.000 | | | | |
| 90040 | Espectrofotometro | 2 | Anual | Externa | 600.000 | 1.200.000 | | | | |
| 90041 | Estacion De Trabajo Para Pcr | 4 | Anual | Externa | 200.000 | 800.000 | | | | |
| 90042 | Estufa De Cultivo | 7 | Anual | Externa | 150.000 | 1.050.000 | | | | |
| 90044 | Extractor Automatizado De Adn/Arn | 1 | Anual | Externa | 450.000 | 450.000 | | | | |

| Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Unidades | Frecuancia de mantención | Estrategia 2 | Precio referencial mantenimiento externo unitario | Precio total mantenimiento | Tiempo mantenimiento proyectado mantención unitaria (HH) | Tiempo total mantenimiento proyectado (HH) | Costo backup (Pesos) | Vida util Backup (Años) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90045 | Freezer -30° C | 15 | Anual | Interna | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | |
| 90046 | Freezer -80°C 380L | 1 | Anual | Interna | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 90047 | Freezer -80°C 500L | 3 | Anual | Interna | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 90048 | Freezer | 7 | Anual | Interna | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
| 90049 | Gabinete Bioseguridad Clase II B2 | 2 | Anual | Externa | 300.000 | 600.000 | | | | |
| 90051 | HPLC (Cromatografia Liquida De Alta Efieciencia) | 1 | Semestral | Externa | 800.000 | 1.600.000 | | | | |
| 90056 | Mesa Autopsia | 1 | Anual | Interna | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | |
| 90068 | Procesador De Tejidos | 2 | Anual | Externa | 900.000 | 1.800.000 | | | | |
| 90070 | Refrigerador Banco De Sangre | 3 | Anual | Interna | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |

| Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Unidades | Frecuancia de mantención | Estrategia 2 | Precio referencial mantenimiento externo unitario | Precio total mantenimiento | Tiempo mantenimiento proyectado mantención unitaria (HH) | Tiempo total mantenimiento proyectado (HH) | Costo backup (Pesos) | Vida util Backup (Años) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90071 | Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Doble Puerta | 14 | Anual | Interna | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | |
| 90072 | Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta | 48 | Anual | Interna | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | |
| 90073 | Refrigerador De Laboratorio/Farmacia Una Puerta Pequeño | 10 | Anual | Interna | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | |
| 90075 | Secuenciador De Adn/Arn | 1 | Anual | Externa | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | |

| Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Unidades | Frecuancia de mantención | Estrategia 2 | Precio referencial mantenimiento externo unitario | Precio total mantenimiento | Tiempo mantenimiento proyectado mantención unitaria (HH) | Tiempo total mantenimiento proyectado (HH) | Costo backup (Pesos) | Vida util Backup (Años) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90084 | Sistema Refrigerado Para Almacenamiento Temporal Y Transporte De Sangre Y Hemoderivados | 8 | Anual | Interna | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | |
| 90088 | Termociclador | 2 | Anual | Externa | 120.000 | 240.000 | | | | |
| 90089 | Termociclador Tiempo Real | 2 | Anual | Externa | 200.000 | 400.000 | | | | |
| 90102 | Estufa De Cultivo CO2 | 2 | Semestral | Externa | 180.000 | 720.000 | | | | |
| 90127 | Campana De Extraccion gases organicos II | 2 | Anual | Externa | 200.000 | 400.000 | | | | |

| Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Unidades | Frecuancia de mantención | Estrategia 2 | Precio referencial mantenimiento externo unitario | Precio total mantenimiento | Tiempo mantenimiento proyectado mantención unitaria (HH) | Tiempo total mantenimiento proyectado (HH) | Costo backup (Pesos) | Vida util Backup (Años) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90126 | Campana De extraccion gases organicos I | 3 | Anual | Externa | 200.000 | 600.000 | | | | |
| 90137 | Escaner de Metafases | 1 | Anual | Externa | 250.000 | 250.000 | | | | |
| 90139 | Gabinete Bioseguridad Clase II A2 | 9 | Anual | Externa | 200.000 | 1.800.000 | | | | |
| 90145 | Estacion Trabajo Anatomia Patologica | 2 | Anual | Externa | 500.000 | 1.000.000 | | | | |
| 100041 | Electroestimulador | 5 | Anual | Externa | 100.000 | 500.000 | | | | |
| 100042 | Electroestimulador Biofeedback Miografia Para Incontinencia | 2 | Anual | Externa | 350.000 | 700.000 | | | | |
| 100044 | Electroestimulador De Analgesia | 19 | Anual | Externa | 100.000 | 1.900.000 | | | | |

| Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Unidades | Frecuancia de mantención | Estrategia 2 | Precio referencial mantenimiento externo unitario | Precio total mantenimiento | Tiempo mantenimiento proyectado mantención unitaria (HH) | Tiempo total mantenimiento proyectado (HH) | Costo backup (Pesos) | Vida util Backup (Años) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100104 | Sistema Con Arnes Para Rehabilitacion De La Marcha | 2 | Anual | Externa | 195.000 | 390.000 | | | | |
| 100106 | Sistema Evaluacion Dinamica De La Marcha | 1 | Anual | Externa | 250.000 | 250.000 | | | | |
| 100107 | Sistema Suspension Antigravedad | 4 | Anual | Externa | 250.000 | 1.000.000 | | | | |
| 100114 | Turbion De Extremidades | 5 | Anual | Externa | 200.000 | 1.000.000 | | | | |
| 100115 | Ultrasonido | 8 | Anual | Externa | 120.000 | 960.000 | | | | |
| 100116 | Ultratermia | 6 | Anual | Externa | 90.000 | 540.000 | | | | |
| 100134 | Sistema para Rehabilitacion Cardiologica con monitoreo y telemetria | 1 | Anual | Externa | 550.000 | 550.000 | | | | |
| 100138 | Elevador para piscina | 1 | Anual | Externa | 200.000 | 200.000 | | | | |
| 110065 | Mobiliario Paciente UCI | 23 | Anual | Interna | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | |

| Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Unidades | Frecuancia de mantención | Estrategia 2 | Precio referencial mantenimiento externo unitario | Precio total mantenimiento | Tiempo mantenimiento proyectado mantención unitaria (HH) | Tiempo total mantenimiento proyectado (HH) | Costo backup (Pesos) | Vida util Backup (Años) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110066 | Mobiliario Paciente UTI | 46 | Anual | Interna | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | |
| 110091 | Unidad Otorrinolaringologica Completa | 6 | Anual | Externa | 90.000 | 540.000 | | | | |
| 110094 | Sillon oftalmologia (cirujano) | 6 | Anual | Externa | 230.000 | 1.380.000 | | | | |
| 110106 | Mobiliario Paciente UPC Bariatrico | 3 | Anual | Interna | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 110107 | Nefroscopio | 1 | Anual | Externa | 200.000 | 200.000 | | | | |
| 110108 | Poligrafo Electrofisiologia | 1 | Anual | Externa | 1.500.000 | 1.500.000 | | | | |
| 130002 | Central Monitoreo Recuperacion | 3 | Semestral | Interna | 0 | 0 | 25 | 150 | 328.720.497 | 8 |
| 130003 | Central Monitoreo UPC | 8 | Semestral | Interna | 0 | 0 | 43 | 688 | 256.861.404 | 8 |

| Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Unidades | Frecuancia de mantención | Estrategia 2 | Precio referencial mantenimiento externo unitario | Precio total mantenimiento | Tiempo mantenimiento proyectado mantención unitaria (HH) | Tiempo total mantenimiento proyectado (HH) | Costo backup (Pesos) | Vida util Backup (Años) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130006 | Monitor De Presion Arterial No Invasiva Con Oximetria | 277 | Semestral | Interna | 0 | 0 | 1 | 554 | 3.028.757 | 8 |
| 130007 | Monitor Desfibrilador | 67 | Semestral | Interna | 0 | 0 | 1 | 134 | 7.729.581 | 8 |
| 130008 | Monitor Desfibrilador C/Mpe | 2 | Semestral | Interna | 0 | 0 | 1 | 4 | 8.329.376 | 8 |
| 130010 | Monitor ECG Signos Vitales Baja Complejidad | 71 | Semestral | Interna | 0 | 0 | 0,75 | 106,5 | 3.724.325 | 8 |
| 130011 | Monitor ECG Signos Vitales Mediana Complejidad | 3 | Semestral | Interna | 0 | 0 | 1 | 6 | 4.640.515 | 8 |
| 130015 | Desfibrilador tipo DEA | 42 | Semestral | Interna | 0 | 0 | 0,75 | 63 | 2.283.814 | 8 |
| 140008 | Motor Colgante | 13 | Anual | Interna | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | |
| 140009 | Motor Con Irrigacion Para Implantes | 2 | Anual | Interna | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |

| Tipo equipo / mobiliario | Nombre | Unidades | Frecuancia de mantención | Estrategia 2 | Precio referencial mantenimiento externo unitario | Precio total mantenimiento | Tiempo mantenimiento proyectado mantención unitaria (HH) | Tiempo total mantenimiento proyectado (HH) | Costo backup (Pesos) | Vida util Backup (Años) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140012 | Motor cirugia Maxilofacial | 1 | Anual | Interna | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 140013 | Unidad Dental Completa | 19 | Anual | Externa | 300.000 | 5.700.000 | | | | |
| 140014 | Sillon dental | 2 | Anual | Interna | 0 | 0 | 1,5 | 3 | 0 | |
| | | | | | | 469.683.000 | | 2514,5 | 700.708.449 | |

## Anexo 5. Análisis Financiero

Estrategia externa:

| | Estrategia 1 externalización mantenimiento | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12 | Año 13 | Año 14 | Año 15 |
| RRHH | -270.666.000 | -282.845.970 | -295.574.039 | -308.874.870 | -322.774.240 | -337.299.080 | -352.477.539 | -368.339.028 | -384.914.284 | -402.235.427 | -420.336.022 | -439.251.142 | -459.017.444 | -479.673.229 | -501.258.524 |
| Equipos oficina | -16.240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.237.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.220.223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipos para mantenimiento | -23.498.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.601.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.850.644 | 0 | 0 |
| Dispositivo Tag | -126.720.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.208.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Batería Tag | 0 | 0 | 0 | -84.355.000 | 0 | 0 | -96.263.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | -119.961.297 | 0 | 0 | -136.895.769 |
| Costos directo mantenimiento externo | -1.040.053.000 | -1.086.855.385 | -1.135.763.877 | -1.186.873.252 | -1.240.282.548 | -1.296.095.263 | -1.354.419.550 | -1.415.368.429 | -1.479.060.009 | -1.545.617.709 | -1.615.170.506 | -1.687.853.179 | -1.763.806.572 | -1.843.177.868 | -1.926.120.872 |
| Costo agencias | -260.013.250 | -271.713.846 | -283.940.969 | -296.718.313 | -310.070.637 | -324.023.816 | -338.604.887 | -353.842.107 | -369.765.002 | -386.404.427 | -403.792.626 | -421.963.295 | -440.951.643 | -460.794.467 | -481.530.218 |
| Costo total | -1.737.190.735 | -1.641.415.201 | -1.715.278.885 | -1.876.821.435 | -1.873.127.425 | -1.977.656.154 | -2.172.366.184 | -2.137.549.565 | -2.413.947.885 | -2.334.257.564 | -2.464.519.377 | -2.669.028.913 | -2.703.626.303 | -2.783.645.563 | -3.045.805.382 |

| r | 8% | |
|---|---|---|
| Metrica financiera | Monto | Unidad |
| VAN | -19.448.746.035 | Pesos |
| VAC | 19.448.746.035 | Pesos |

Estrategia hibrida:

| | Estrategia 2 mantenimiento híbrido | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12 | Año 13 | Año 14 | Año 15 |
| RRHH | -379.080.000 | -396.138.600 | -413.964.837 | -432.593.255 | -452.059.951 | -472.402.649 | -493.660.768 | -515.875.503 | -539.089.900 | -563.348.946 | -588.699.648 | -615.191.133 | -642.874.734 | -671.804.097 | -702.035.281 |
| Capacitación personal especializado | -20.000.000 | -20.900.000 | -21.840.500 | -22.823.323 | -23.850.372 | -24.923.639 | -26.045.202 | -27.217.237 | -28.442.012 | -29.721.903 | -31.059.388 | -32.457.061 | -33.917.629 | -35.443.922 | -37.038.898 |
| Equipos oficina | -21.590.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.905.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.528.610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipos para mantenimiento | -190.435.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -247.996.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -322.956.198 | 0 | 0 |
| Calibraciones equipos mantenimiento | -12.900.000 | -13.480.500 | -14.087.123 | -14.721.043 | -15.383.490 | -16.075.747 | -16.799.156 | -17.555.118 | -18.345.098 | -19.170.627 | -20.033.306 | -20.934.804 | -21.876.870 | -22.861.330 | -23.890.089 |
| Dispositivo Tag | -126.720.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.208.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Batería Tag | 0 | 0 | 0 | -84.355.000 | 0 | 0 | -96.263.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | -119.961.297 | 0 | 0 | -136.895.769 |
| Backups | -638.234.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -901.747.828 | 0 | -6.427.012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costos directo mantenimiento externo | -469.683.000 | -490.818.735 | -512.905.578 | -535.986.329 | -560.105.714 | -585.310.471 | -611.649.442 | -639.173.667 | -667.936.482 | -697.993.624 | -729.403.337 | -762.226.487 | -796.526.679 | -832.370.380 | -869.827.047 |
| Costo agencias | -117.420.750 | -122.704.684 | -128.226.395 | -133.996.582 | -140.026.428 | -146.327.618 | -152.912.361 | -159.793.417 | -166.984.121 | -174.498.406 | -182.350.834 | -190.556.622 | -199.131.670 | -208.092.595 | -217.456.762 |
| Costo total | -1.976.063.542 | -1.044.042.519 | -1.091.024.432 | -1.224.475.531 | -1.191.425.955 | -1.271.945.191 | -1.645.326.686 | -1.359.614.941 | -2.502.754.031 | -1.484.733.506 | -1.591.502.135 | -1.741.327.404 | -2.017.283.780 | -1.770.572.323 | -1.987.143.846 |

| Metrica financiera | Monto | Unidad |
|---|---|---|
| VAN | -14.129.298.073 | Pesos |
| VAC | 14.129.298.073 | Pesos |